

<b>Nom LIU</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom QIYING</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 07/04/1971</b>	<b>Profession MACON</b>
<b>Age 53 Ans</b>	<b>Entreprise CR18</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 4906</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 168 cm</b>	<b>Groupe ethnique Chinois de Hong Kong</b>
<b>Poids 71 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites NHANES III</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 30,9 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 93,5 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 53 %

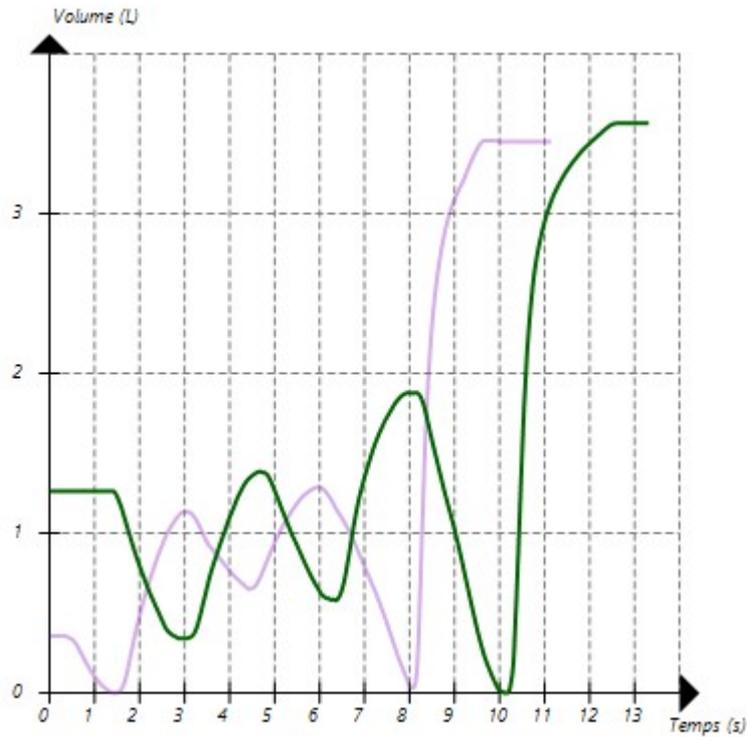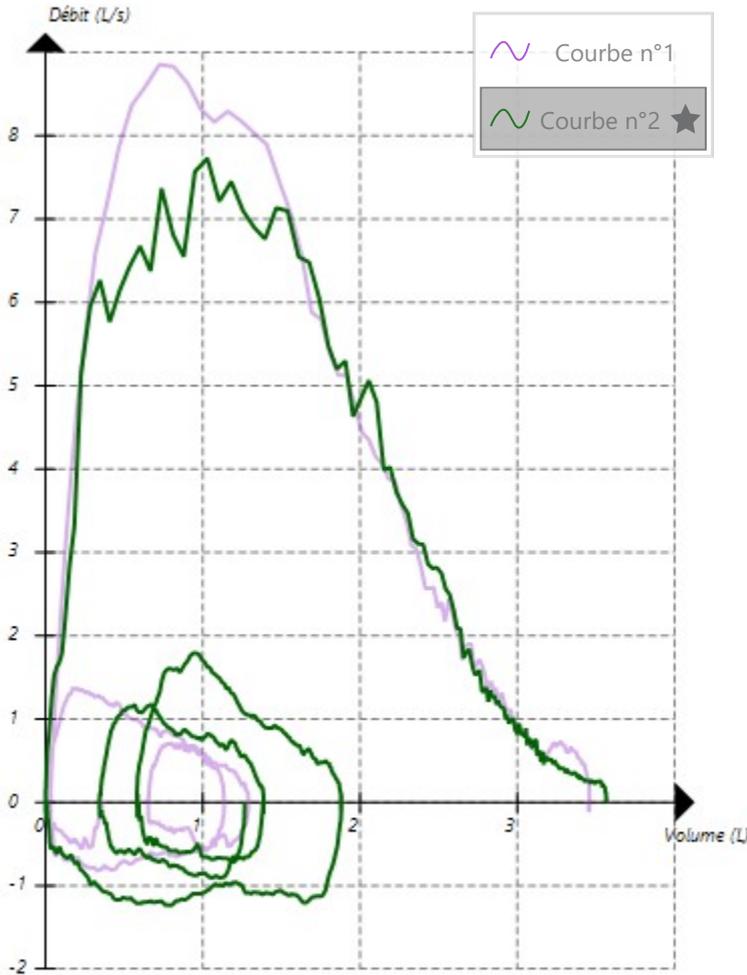

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,43 L	3,57 L	4,35 L	82,07 %
VEMS	3,16 L	3,17 L	3,36 L	94,35 %
DEP	8,99 L/s	8,02 L/s	8,83 L/s	90,83 %
VEMS/CVF	92,13 %	88,80 %	77,12 %	115,15 %
Durée d'expiration	1,60 s	2,47 s	-	
DEMM	4,92 L/s	4,72 L/s	2,97 L/s	158,92 %
DEMM/CVF	1,43 s-1	1,32 s-1	0,68 s-1	194,12 %
DE75	8,77 L/s	6,46 L/s	-	
DE50	5,84 L/s	5,71 L/s	-	
DE25	2,36 L/s	1,82 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: