

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Nom</b> BARRY                | <b>Adresse</b>                   |
| <b>Prénom</b> ABDOULAYE         | <b>Exposition</b>                |
| <b>Né le</b> 01/01/2000         | <b>Profession</b> MANOEUVRE      |
| <b>Age</b> 24 Ans               | <b>Entreprise</b> CR18           |
| <b>Genre</b> Masculin           | <b>Service</b>                   |
| <b>ID</b> 1448                  | <b>Fumeur</b> Non fumeur         |
| <b>Taille</b> 158 cm            | <b>Groupe ethnique</b> Caucasien |
| <b>Poids</b> 53 kg              | <b>Prescripteur:</b>             |
| <b>Valeurs prédites</b> Knudson | <b>Smoking Pack Years</b> : 0    |
| <b>Opérateur</b> admin admin    |                                  |



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,4 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,3 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 55 %

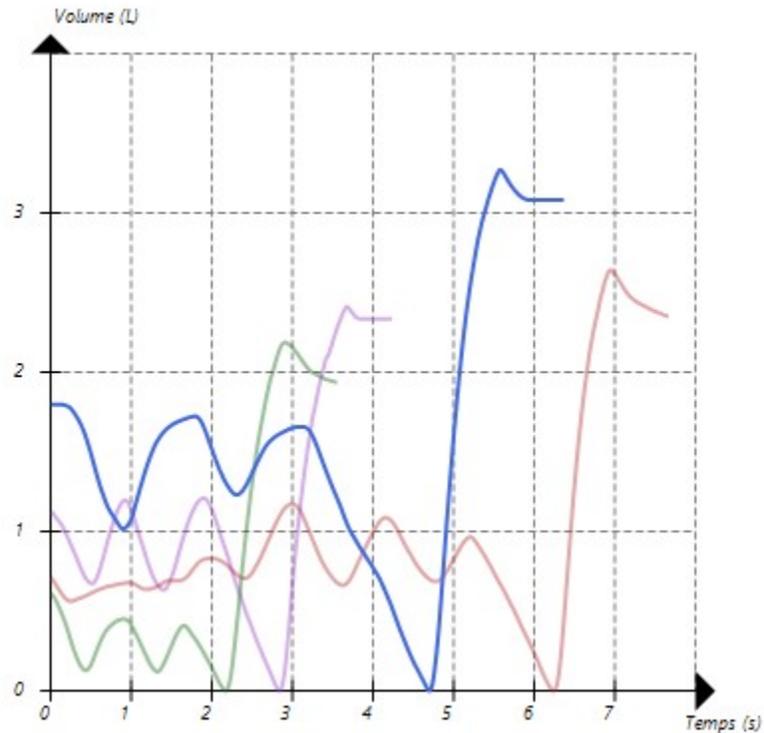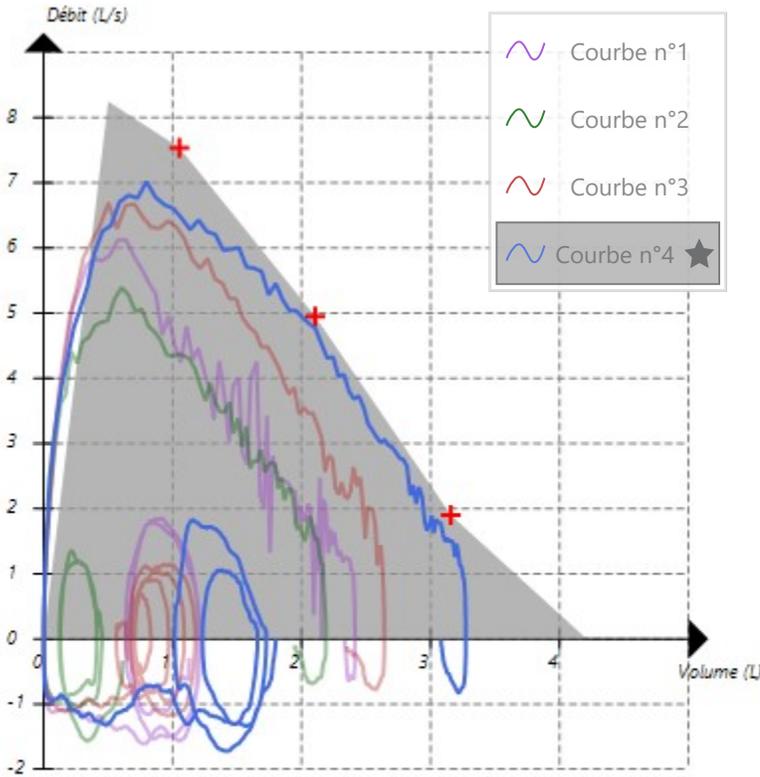

| Nom                | Courbe n°1 | Courbe n°2 | Courbe n°3 | Courbe n°4 (Validée) | Prédits  | % Prédits |
|--------------------|------------|------------|------------|----------------------|----------|-----------|
| CVF                | 2,41 L     | 2,19 L     | 2,64 L     | 3,27 L               | 4,21 L   | 77,67 %   |
| VEMS               | 2,41 L     | 2,19 L     | 2,64 L     | 3,27 L               | 3,61 L   | 90,58 %   |
| DEP                | 6,17 L/s   | 5,52 L/s   | 6,82 L/s   | 7,12 L/s             | 8,25 L/s | 86,30 %   |
| VEMS/ CVF          | 100,00 %   | 100,00 %   | 100,00 %   | 100,00 %             | 84,18 %  | 118,79 %  |
| Durée d'expiration | 0,84 s     | 0,73 s     | 0,70 s     | 0,88 s               | -        |           |
| DEMM               | 4,05 L/s   | 4,13 L/s   | 5,35 L/s   | 5,45 L/s             | 4,11 L/s | 132,60 %  |
| DEMM/ CVF          | 1,68 s-1   | 1,89 s-1   | 2,03 s-1   | 1,67 s-1             | 0,98 s-1 | 170,41 %  |
| DE75               | 6,15 L/s   | 5,16 L/s   | 6,66 L/s   | 6,95 L/s             | 7,54 L/s | 92,18 %   |
| DE50               | 4,64 L/s   | 4,60 L/s   | 5,58 L/s   | 5,59 L/s             | 4,95 L/s | 112,93 %  |
| DE25               | 3,37 L/s   | 2,73 L/s   | 3,21 L/s   | 3,75 L/s             | 1,90 L/s | 197,37 %  |

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: