

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOHAMED	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 02/04/1992	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 32 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 539	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 183 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 69 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 27,1 °C  
 Pression atmosphérique : 94,3 kPa  
 Humidité : 51 %

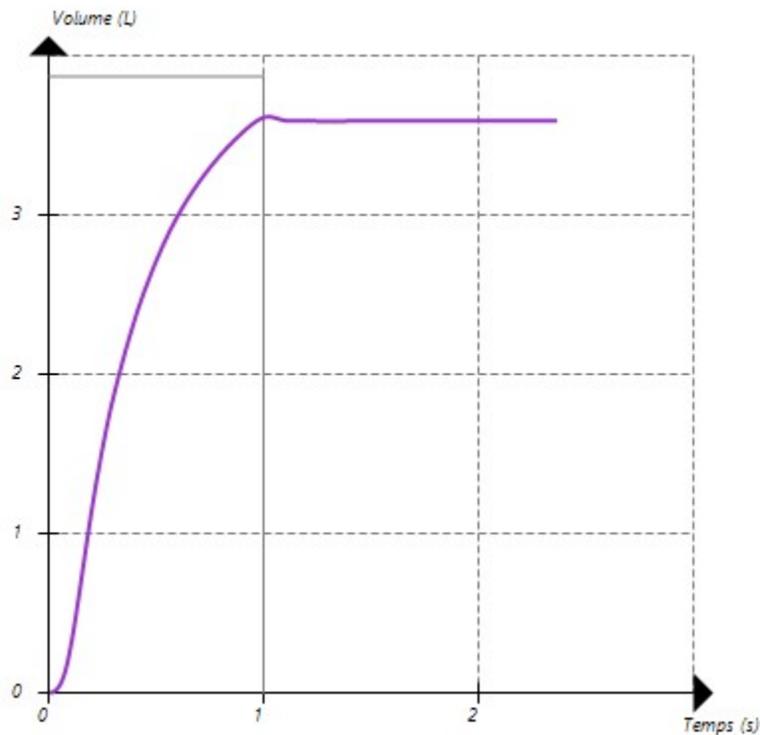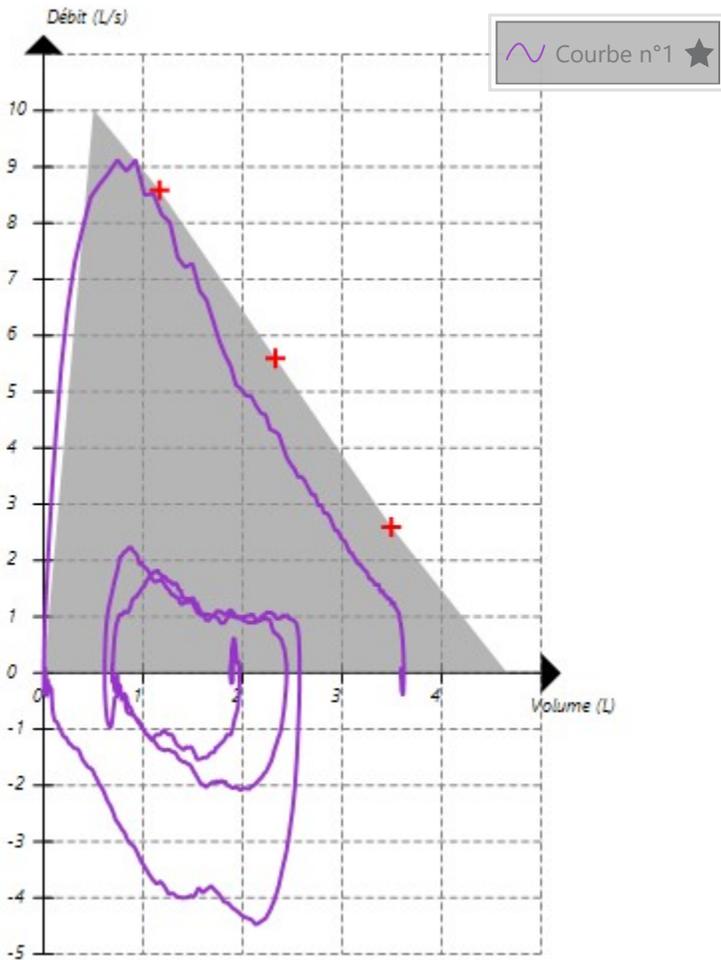

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,62 L	4,66 L	77,68 %
VEMS	3,62 L	3,87 L	93,54 %
DEP	9,24 L/s	10,03 L/s	92,12 %
VEMS/ CVF	100,00 %	81,48 %	122,73 %
Durée d'expiration	1,06 s	-	
DEMM	5,52 L/s	4,88 L/s	113,11 %
DEMM/ CVF	1,52 s-1	0,91 s-1	167,03 %
DE75	9,24 L/s	8,59 L/s	107,57 %
DE50	5,73 L/s	5,60 L/s	102,32 %
DE25	3,07 L/s	2,60 L/s	118,08 %