


<b>Nom</b> MAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOUSSA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1999	<b>Profession</b> OPERATOR EXCAVATOR
<b>Age</b> 26 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 3856	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 181 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 76 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	




**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 31,2 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,3 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 30 %

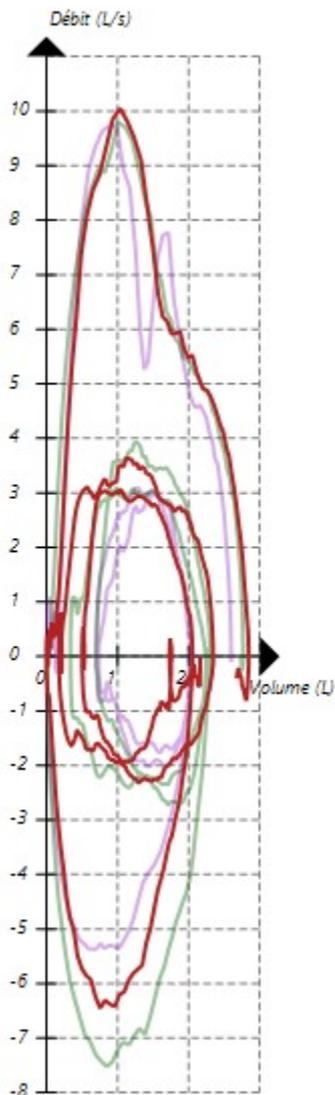

~ Courbe n°1  
~ Courbe n°2  
~ Courbe n°3 ★

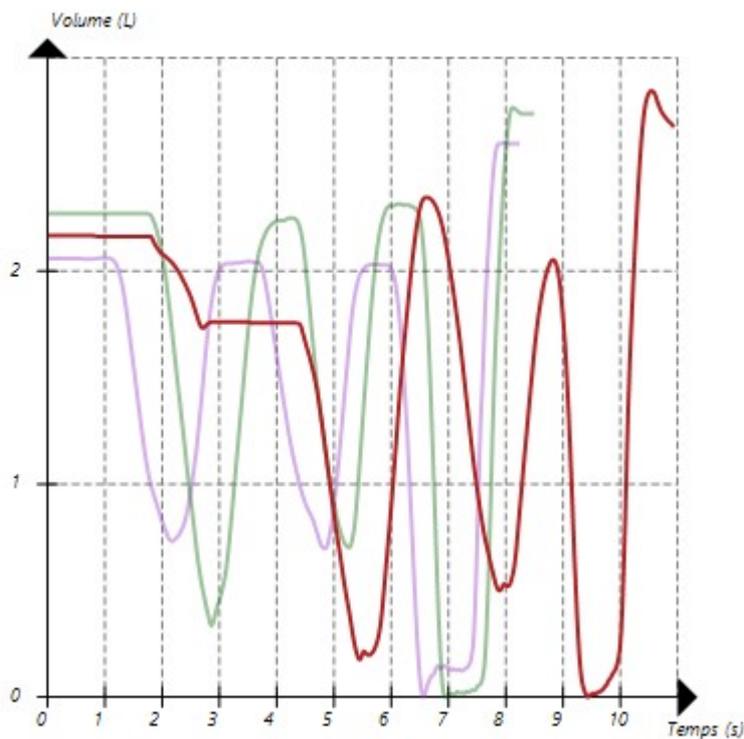

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,48 L	2,74 L	2,83 L	4,83 L	58,59 %
VEMS	2,48 L	2,74 L	2,83 L	4,06 L	69,70 %
DEP	10,25 L/s	10,20 L/s	10,19 L/s	10,12 L/s	100,69 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	84,49 %	118,36 %
Durée d'expiration	0,74 s	0,77 s	0,98 s	-	
DEMM	7,38 L/s	7,62 L/s	7,53 L/s	4,47 L/s	168,46 %
DEMM/ CVF	2,98 s-1	2,78 s-1	2,66 s-1	0,93 s-1	286,02 %
DE75	9,61 L/s	8,89 L/s	8,83 L/s	-	
DE50	5,51 L/s	8,19 L/s	8,17 L/s	-	
DE25	4,92 L/s	5,21 L/s	4,99 L/s	-	