

<b>Nom SYLLA</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom FODE</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 01/01/1989</b>	<b>Profession PICK UP DRIVER</b>
<b>Age 35 Ans</b>	<b>Entreprise CR18</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 1254</b>	<b>Fumeur Ancien fumeur</b>
<b>Taille 159 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids 67 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 1</b>
<b>Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 26,6 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 62 %

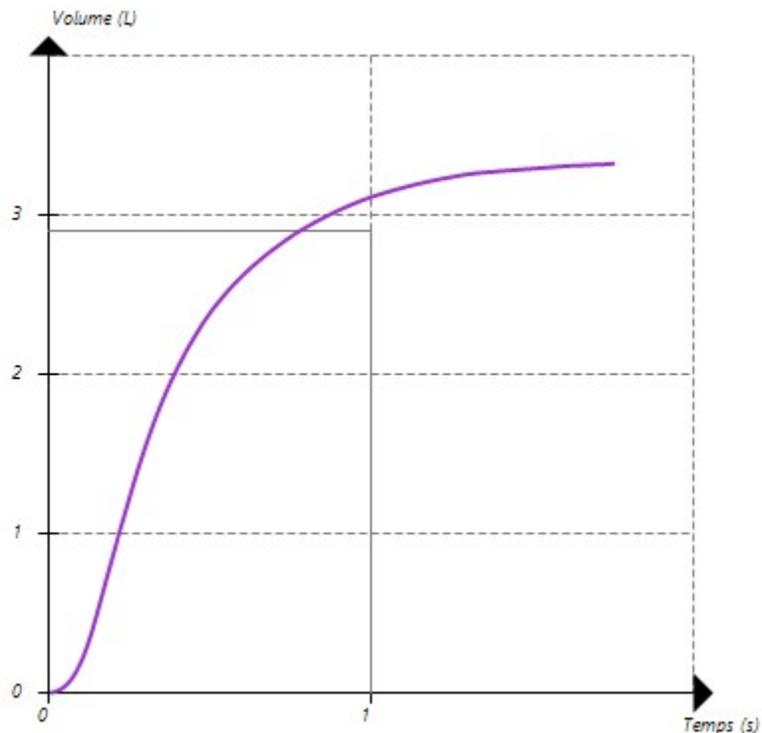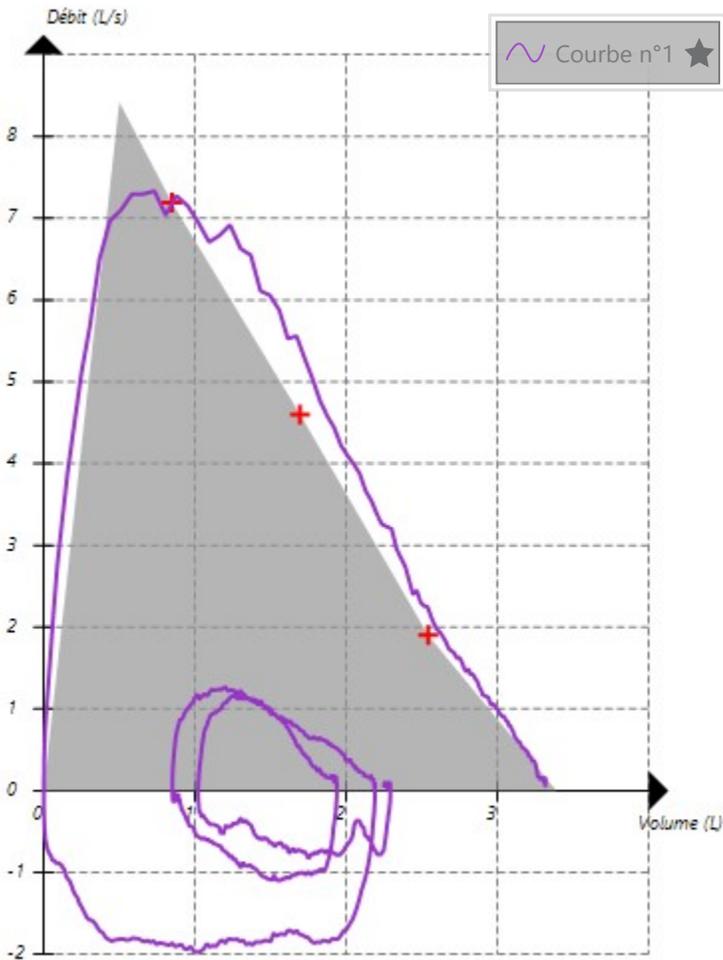

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,32 L	3,39 L	97,94 %
VEMS	3,16 L	2,90 L	108,97 %
DEP	7,61 L/s	8,42 L/s	90,38 %
VEMS/ CVF	95,18 %	80,94 %	117,59 %
Durée d'expiration	1,76 s	-	
DEMM	4,79 L/s	4,28 L/s	111,92 %
DEMM/ CVF	1,44 s-1	1,10 s-1	130,91 %
DE75	6,75 L/s	7,19 L/s	93,88 %
DE50	5,73 L/s	4,60 L/s	124,57 %
DE25	2,30 L/s	1,90 L/s	121,05 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: