



<b>Nom</b> DOUMBOUYA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> DAOUDA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1998	<b>Profession</b> DUMP TRUCK
<b>Age</b> 26 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 238	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 177 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 73 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,1 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,3 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 55 %

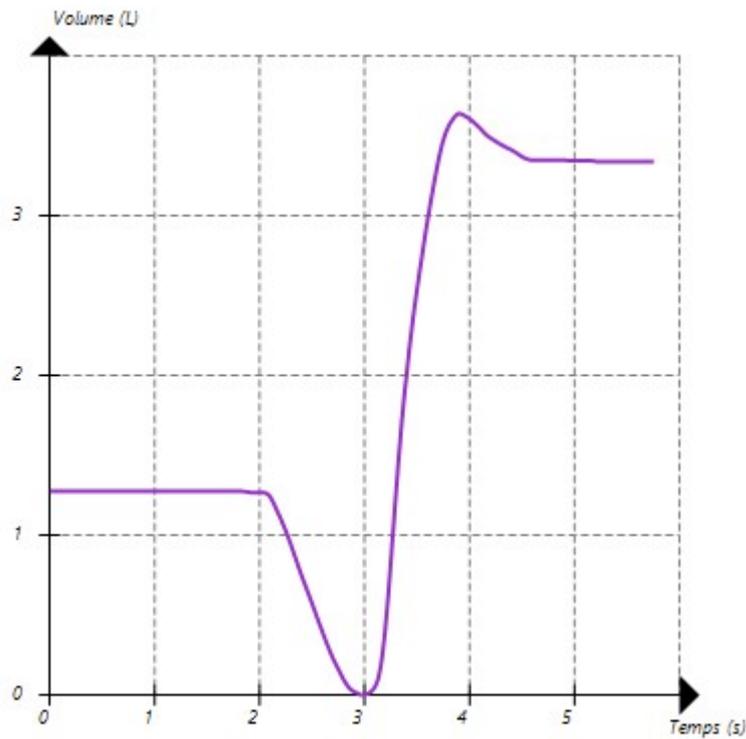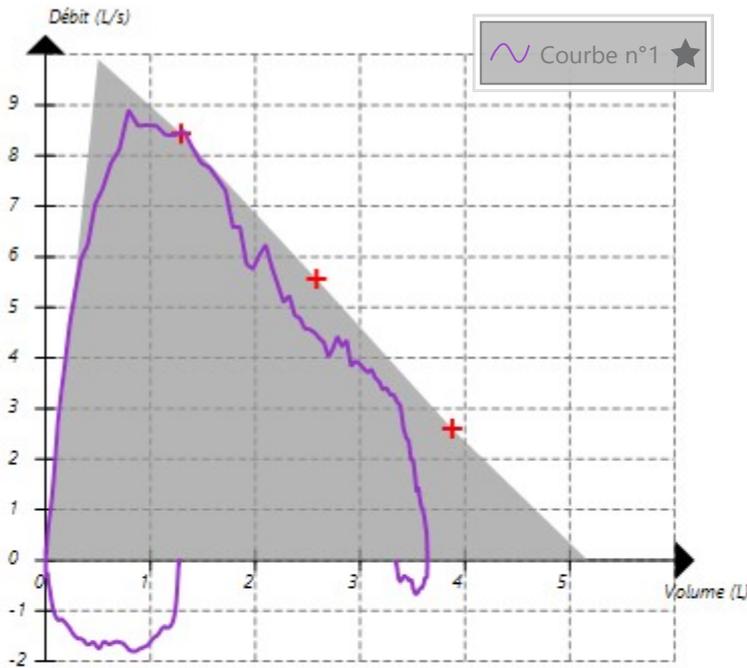

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,64 L	5,17 L	70,41 %
VEMS	3,64 L	4,37 L	83,30 %
DEP	9,28 L/s	9,91 L/s	93,64 %
VEMS/ CVF	100,00 %	82,56 %	121,12 %
Durée d'expiration	0,93 s	-	
DEMM	6,39 L/s	5,02 L/s	127,29 %
DEMM/ CVF	1,76 s-1	0,97 s-1	181,44 %
DE75	8,58 L/s	8,44 L/s	101,66 %
DE50	6,41 L/s	5,56 L/s	115,29 %
DE25	4,20 L/s	2,60 L/s	161,54 %