


<b>Nom</b> THIEORO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> PIOUSI	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 10/06/1996	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 28 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1603	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 162 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 58 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	




**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,3 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,5 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 57 %

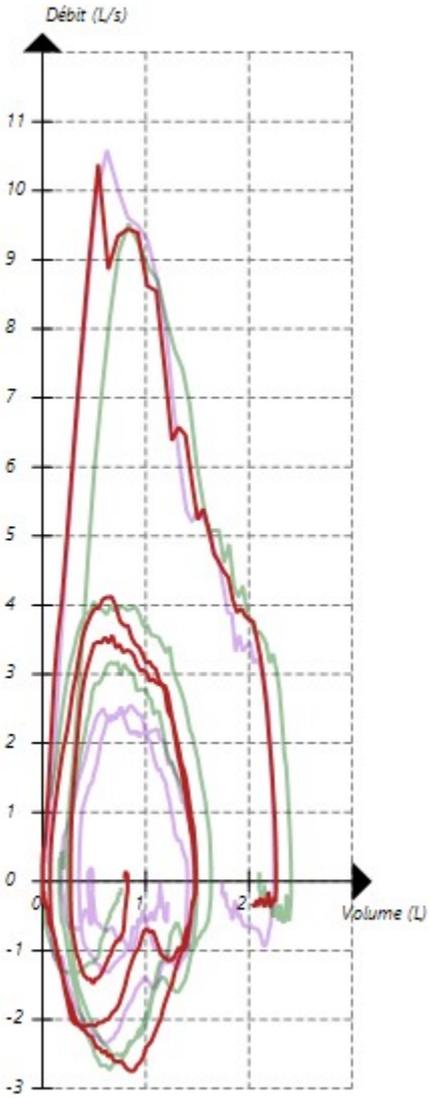

~ Courbe n°1  
~ Courbe n°2  
~ Courbe n°3 ★

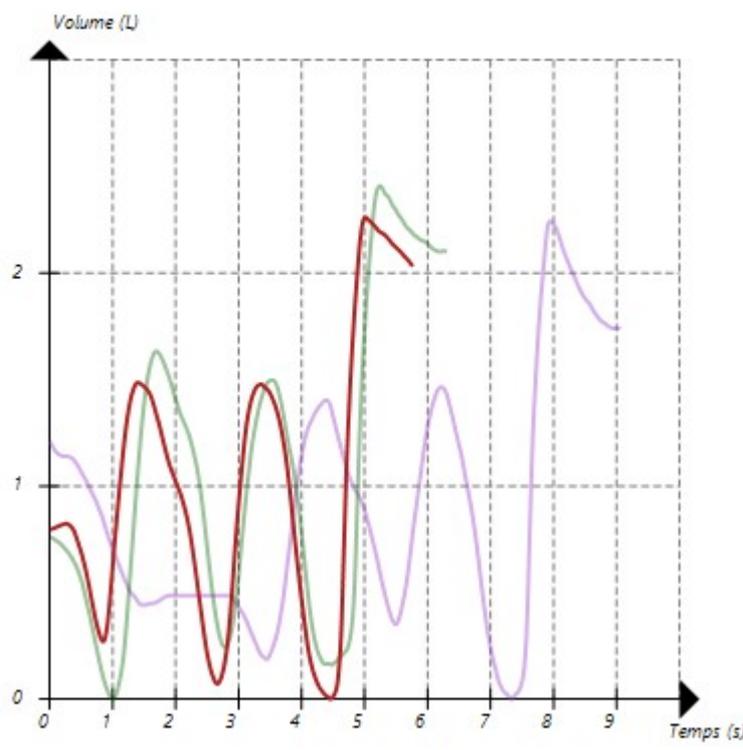

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,24 L	2,25 L	2,26 L	3,71 L	60,92 %
VEMS	2,24 L	2,25 L	2,26 L	3,16 L	71,52 %
DEP	10,69 L/s	9,63 L/s	11,02 L/s	8,26 L/s	133,41 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	84,12 %	118,88 %
Durée d'expiration	0,61 s	0,76 s	0,55 s	-	
DEMM	7,43 L/s	7,03 L/s	7,25 L/s	3,71 L/s	195,42 %
DEMM/ CVF	3,32 s-1	3,12 s-1	3,21 s-1	1,00 s-1	321,00 %
DE75	10,34 L/s	8,99 L/s	10,50 L/s	-	
DE50	8,61 L/s	7,34 L/s	8,21 L/s	-	
DE25	4,67 L/s	4,26 L/s	4,59 L/s	-	