

**Nom** TRORE  
**Prénom** SEKOU  
**Né** le 01/01/1982  
**Age** 43 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 14617  
**Taille** 167 cm  
**Poids** 65 kg  
**Valeurs prédictes** NHANES III  
**Opérateur** BARRY MARIAMA THIOUTO

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** MANOEUVRE  
**Entreprise** CR18  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years :** 0



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

### Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 30,1 °C

Numéro de série : 253565

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Humidité : 53 %

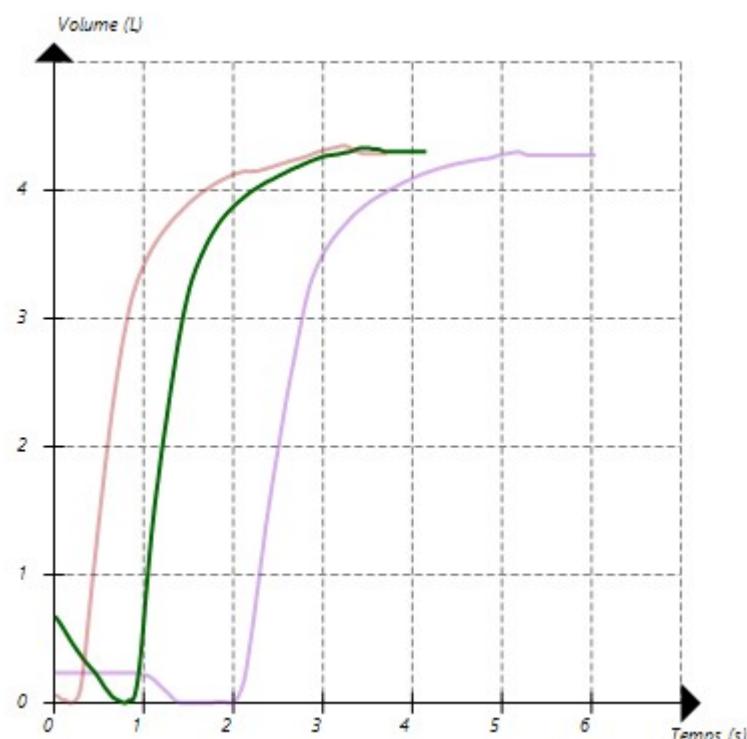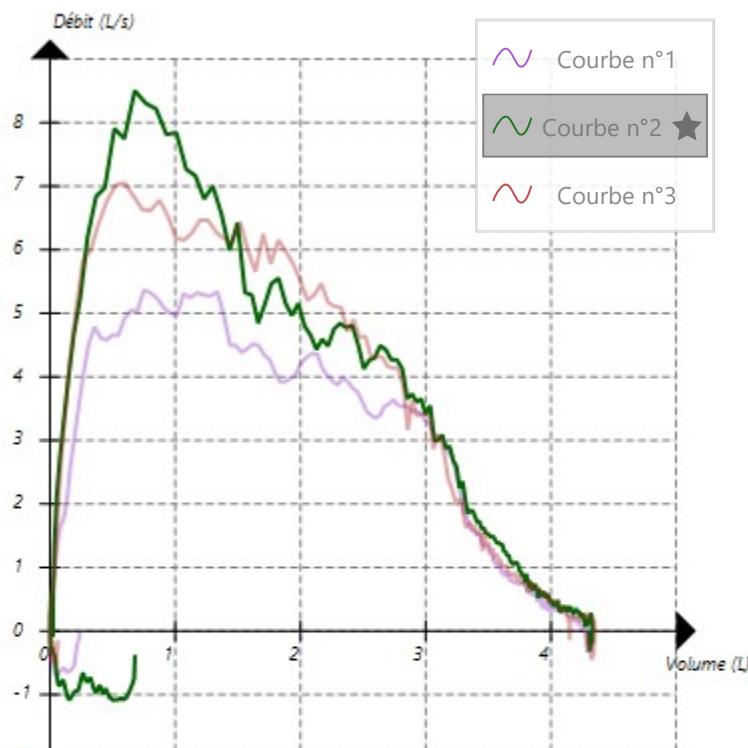

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	4,30 L	4,31 L	4,35 L	3,71 L	116,17 %
VEMS	3,62 L	3,79 L	3,74 L	3,03 L	125,08 %
DEP	5,42 L/s	8,75 L/s	7,24 L/s	8,09 L/s	108,16 %
VEMS/CVF	84,19 %	87,94 %	85,98 %	81,38 %	108,06 %
Durée d'expiration	3,21 s	2,57 s	3,05 s	-	
DEMM	4,03 L/s	4,67 L/s	4,68 L/s	3,24 L/s	144,14 %
DEMM/CVF	0,94 s <sup>-1</sup>	1,08 s <sup>-1</sup>	1,08 s <sup>-1</sup>	0,87 s <sup>-1</sup>	124,14 %
DE75	5,31 L/s	6,90 L/s	6,30 L/s	-	
DE50	4,28 L/s	4,66 L/s	5,55 L/s	-	
DE25	2,64 L/s	2,44 L/s	2,09 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: