

<b>Nom</b> HUANG	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> RENKE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 09/04/1986	<b>Profession</b> CARPENTER
<b>Age</b> 38 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 4673	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 168 cm	<b>Groupe ethnique</b> Chinois de Hong Kong
<b>Poids</b> 71 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BAH OUMOU SALAMATA	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 33,7 °C  
 Pression atmosphérique : 95 kPa  
 Humidité : 54 %

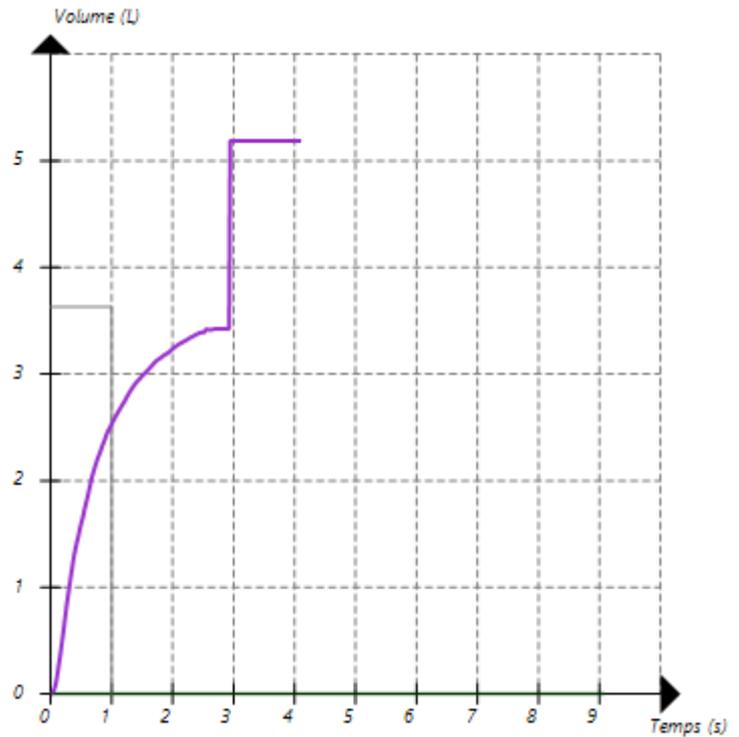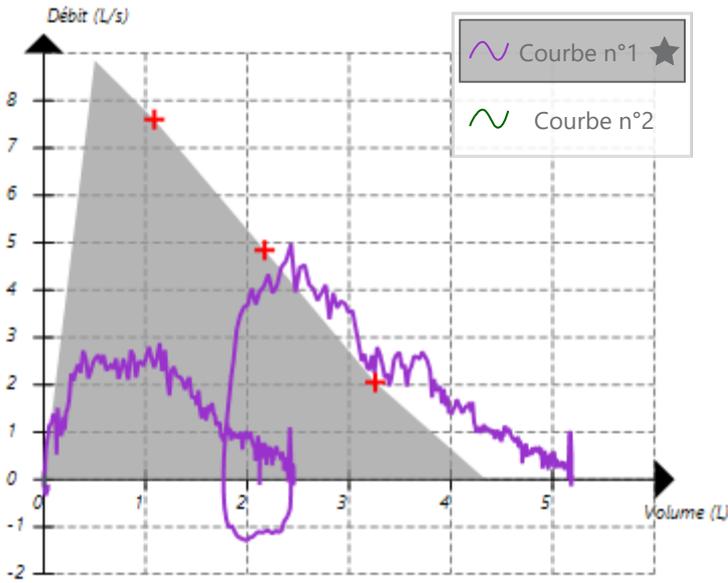

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,42 L	-	4,34 L	78,80 %
VEMS	2,61 L	-	3,63 L	71,90 %
DÉP	5,55 L/s	0,13 L/s	8,85 L/s	62,71 %
VEMS/ CVF	76,32 %	-	80,41 %	94,91 %
Durée d'expiration	2,70 s	0,60 s	-	
DEMM	2,24 L/s	0,12 L/s	4,33 L/s	51,73 %
DEMM/ CVF	0,65 s <sup>-1</sup>	-	1,00 s <sup>-1</sup>	65,00 %
DE75	4,18 L/s	0,11 L/s	7,60 L/s	55,00 %
DE50	2,68 L/s	0,12 L/s	4,84 L/s	55,37 %
DE25	0,96 L/s	0,08 L/s	2,05 L/s	46,83 %