

<b>Nom</b> KEITA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SOUMAILA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/07/1994	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 29 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1420	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 174 cm	<b>Groupe ethnique</b> Caucasien
<b>Poids</b> 67 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> LY MAMOUDOU	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 27,9 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 50 %

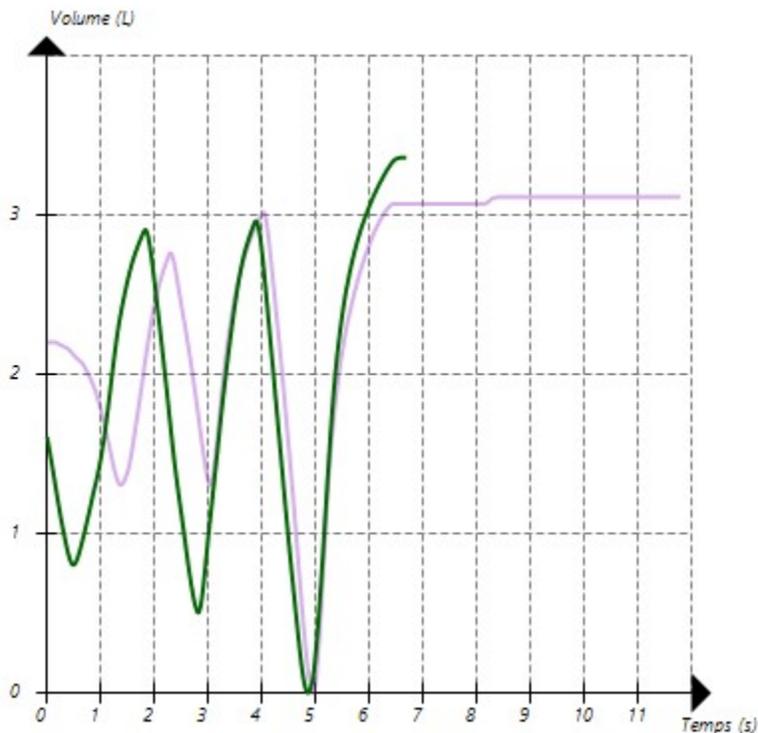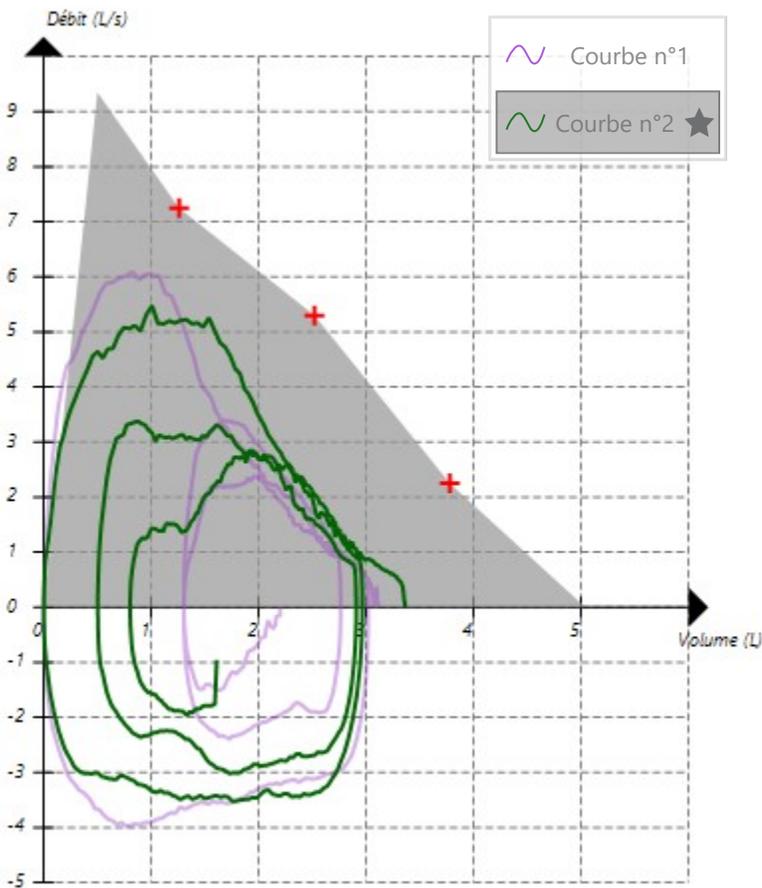

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,11 L	3,36 L	5,04 L	66,67 %
VEMS	2,83 L	3,03 L	4,21 L	71,97 %
DEP	6,22 L/s	5,65 L/s	9,35 L/s	60,43 %
VEMS/ CVF	91,00 %	90,18 %	83,66 %	107,79 %
Durée d'expiration	3,59 s	1,77 s	-	
DEMM	3,41 L/s	3,86 L/s	4,50 L/s	85,78 %
DEMM/ CVF	1,10 s-1	1,15 s-1	0,89 s-1	129,21 %
DE75	6,01 L/s	5,24 L/s	7,25 L/s	72,28 %
DE50	3,80 L/s	4,68 L/s	5,30 L/s	88,30 %
DE25	1,49 L/s	1,78 L/s	2,25 L/s	79,11 %