


MEDVIE


Date du test: 19/07/2025 12:05:13
Durée: 3mn 56s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DOUMBOUYA OUMAR	
Date de naissance	01/03/1984
Age	41
Société	CR18
ID	25071912002817423

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

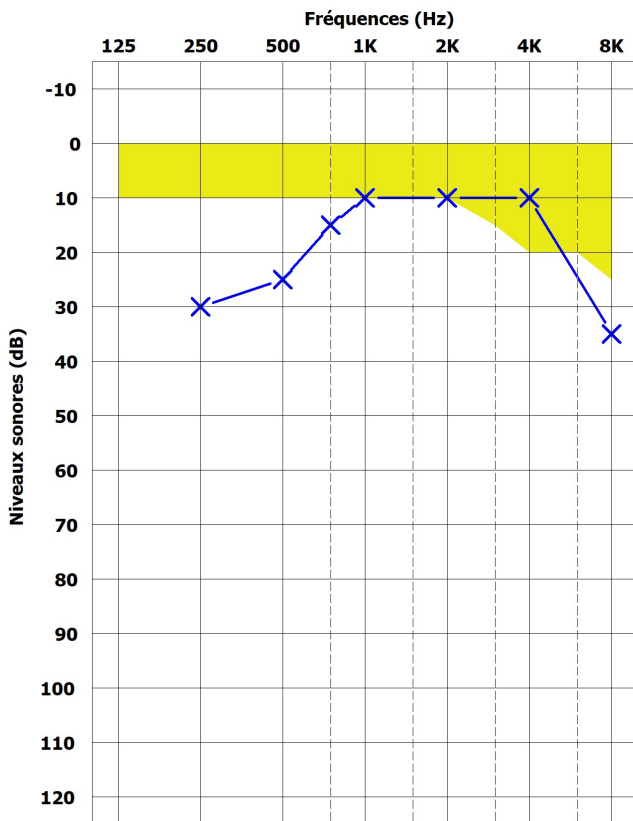

Oreille Gauche

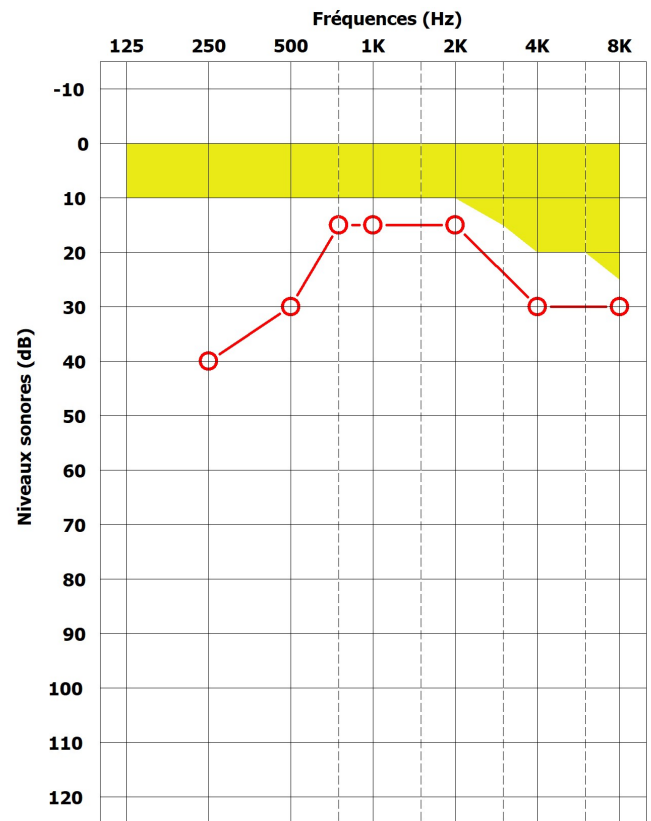

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	15	10		10		10		35
CA Droit		40	30	15	15		15		30		30

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes