


<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SEKOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1979	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 45 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 338	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 164 cm	<b>Groupe ethnique</b> Caucasien
<b>Poids</b> 49 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 1
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,6 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 697,6 mmHg  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 48 %

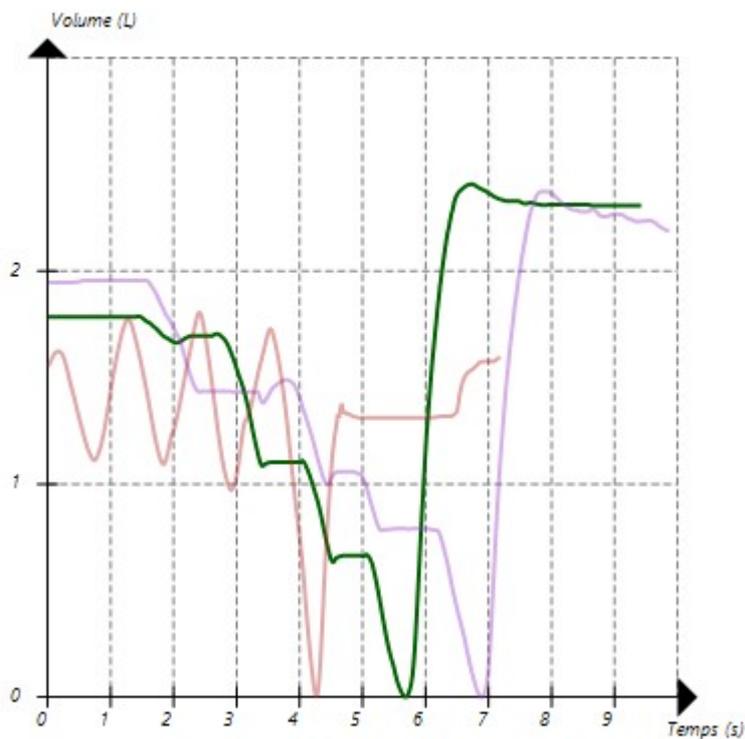

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,41 L	2,37 L	1,38 L	4,30 L	56,05 %
VEMS	2,41 L	2,37 L	1,38 L	3,41 L	70,67 %
DEP	5,91 L/s	5,93 L/s	6,38 L/s	8,85 L/s	66,78 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	78,77 %	126,95 %
Durée d'expiration	1,04 s	0,95 s	0,40 s	-	
DEMM	4,21 L/s	3,85 L/s	5,20 L/s	3,24 L/s	129,94 %
DEMM/ CVF	1,75 s-1	1,62 s-1	3,77 s-1	0,75 s-1	233,33 %
DE75	5,74 L/s	5,93 L/s	6,25 L/s	-	
DE50	4,57 L/s	3,59 L/s	5,14 L/s	-	
DE25	2,69 L/s	2,27 L/s	3,55 L/s	-	