

<b>Nom</b> SAGNO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MANDJOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1998	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 26 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 0503	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 172 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 67 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 30,1 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,2 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 53 %

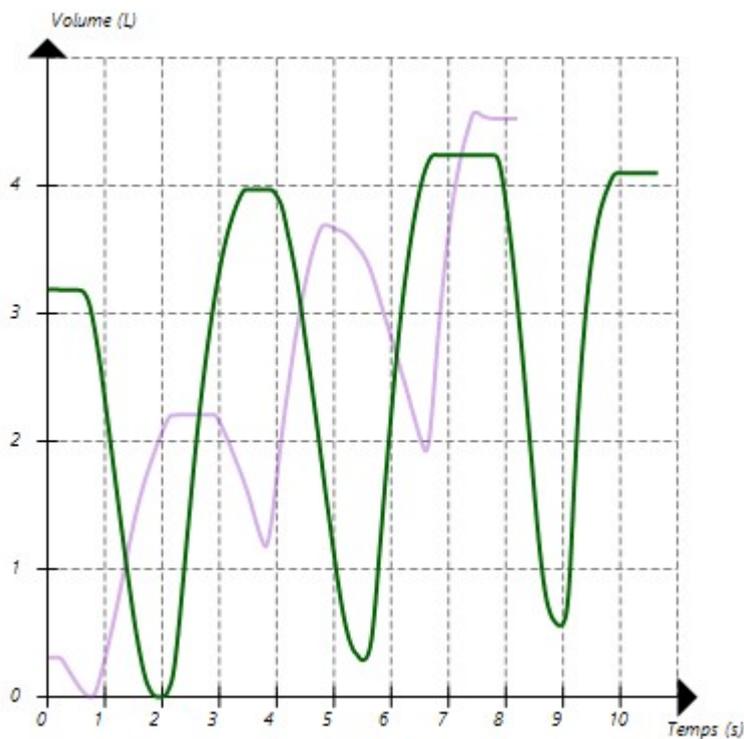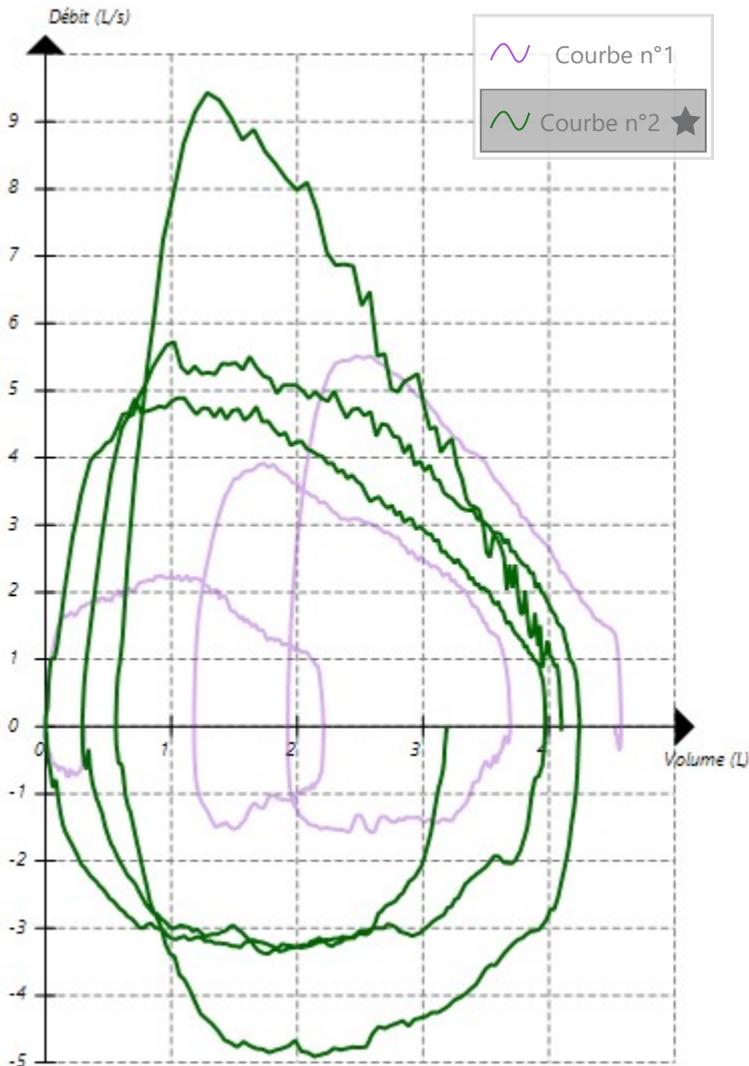

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,65 L	3,54 L	4,30 L	82,33 %
VEMS	2,65 L	3,54 L	3,64 L	97,25 %
DEP	5,58 L/s	9,69 L/s	9,25 L/s	104,76 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	84,49 %	118,36 %
Durée d'expiration	0,86 s	1,02 s	-	
DEMM	4,25 L/s	6,56 L/s	4,14 L/s	158,45 %
DEMM/ CVF	1,60 s-1	1,85 s-1	0,96 s-1	192,71 %
DE75	5,58 L/s	8,96 L/s	-	
DE50	4,28 L/s	6,57 L/s	-	
DE25	2,82 L/s	4,46 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: