



<b>Nom LIU</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom FAN</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 28/02/1988</b>	<b>Profession</b>
<b>Age 37 Ans</b>	<b>Entreprise</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 7270</b>	<b>Fumeur Fumeur</b>
<b>Taille 178 cm</b>	<b>Groupe ethnique Chinois de Hong Kong</b>
<b>Poids 65 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur BAH OUMOU SALAMATA</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,5 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 94,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 60 %

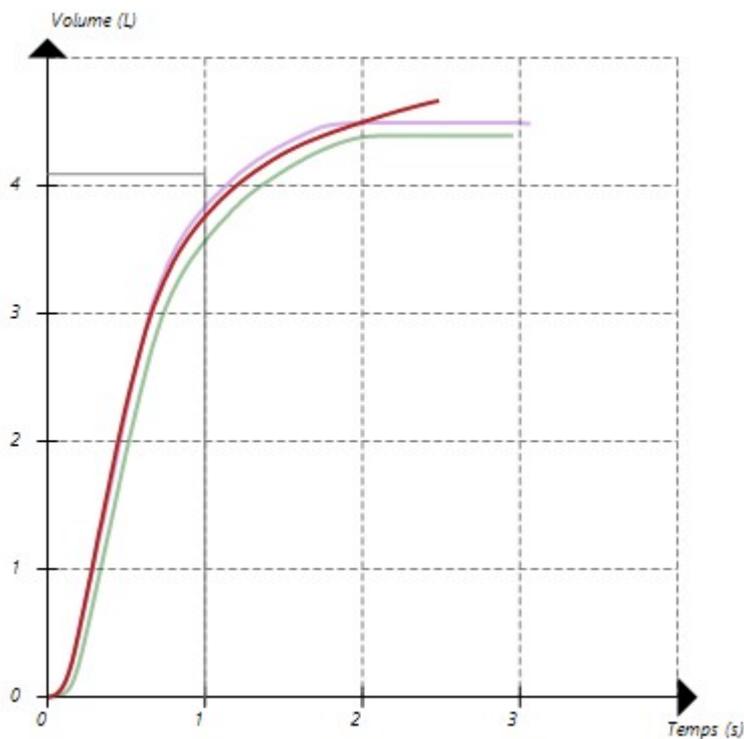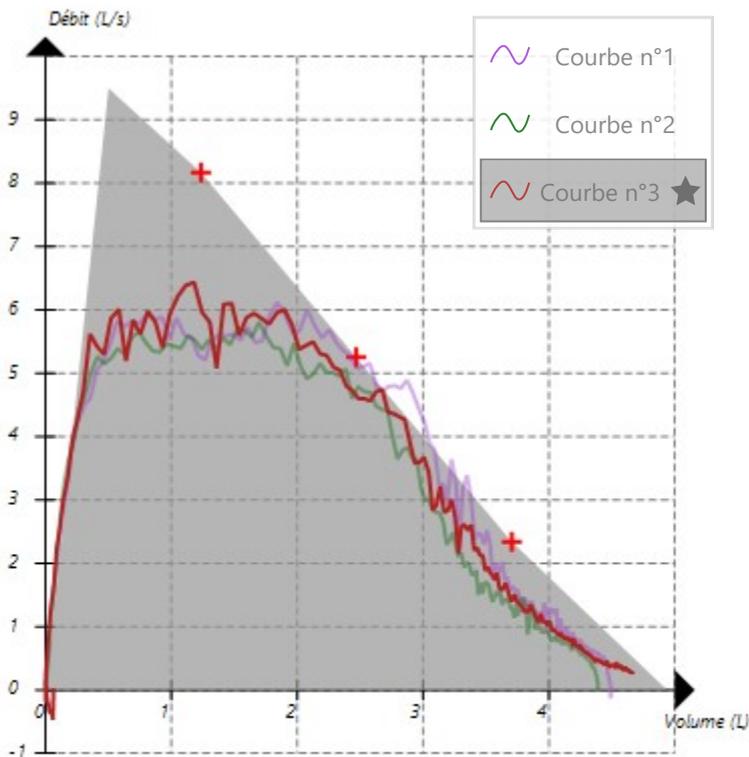

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,49 L	4,39 L	4,67 L	4,94 L	94,53 %
VEMS	3,98 L	3,80 L	3,91 L	4,09 L	95,60 %
DEP	6,34 L/s	5,93 L/s	6,68 L/s	9,50 L/s	70,32 %
VEMS/CVF	88,64 %	86,56 %	83,73 %	80,59 %	103,90 %
Durée d'expiration	2,78 s	2,45 s	2,50 s	-	
DEMM	4,97 L/s	4,46 L/s	4,36 L/s	4,57 L/s	95,40 %
DEMM/CVF	1,11 s-1	1,02 s-1	0,93 s-1	0,93 s-1	100,00 %
DE75	5,26 L/s	5,30 L/s	6,35 L/s	8,17 L/s	77,72 %
DE50	5,70 L/s	4,82 L/s	5,16 L/s	5,25 L/s	98,29 %
DE25	3,14 L/s	2,09 L/s	1,85 L/s	2,34 L/s	79,06 %