

<b>Nom</b> KOMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 07/03/2001	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 23 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b> MANOEUVRE
<b>ID</b> 1415	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 171 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> LY MAMOUDOU	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 29,1 °C  
 Pression atmosphérique : 93,8 kPa  
 Humidité : 51 %

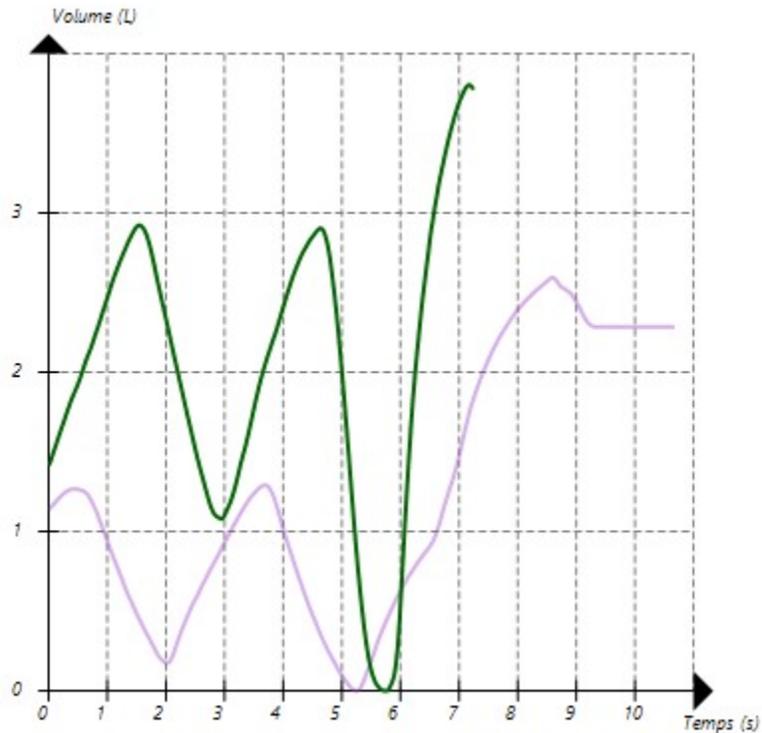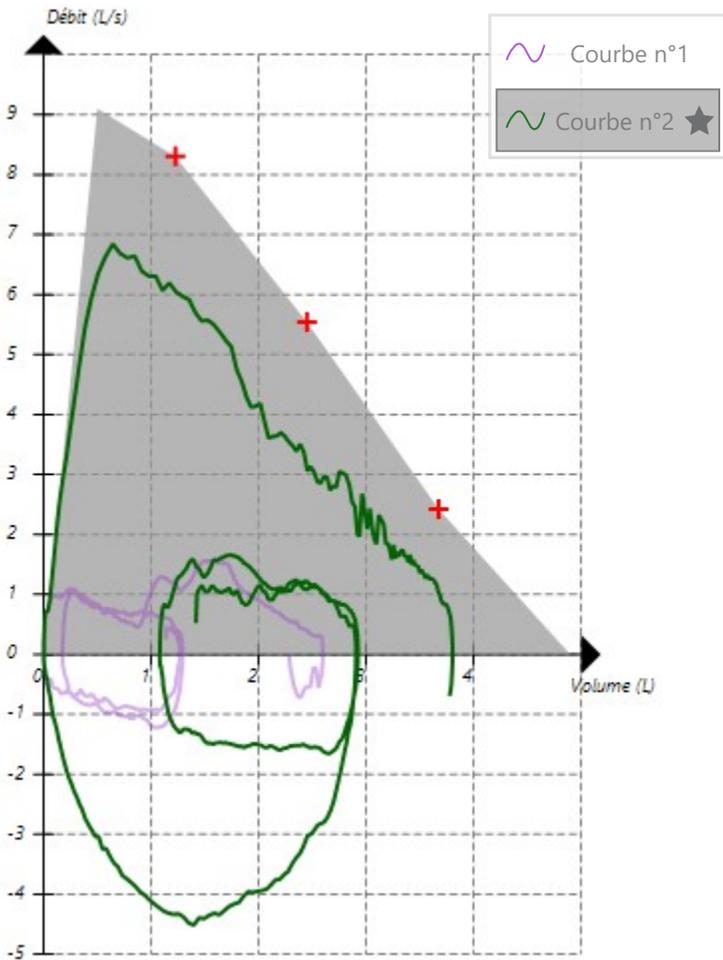

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,60 L	3,80 L	4,90 L	77,55 %
VEMS	1,59 L	3,60 L	4,22 L	85,31 %
DEP	1,59 L/s	6,91 L/s	9,10 L/s	75,93 %
VEMS/ CVF	61,15 %	94,74 %	84,28 %	112,41 %
Durée d'expiration	3,34 s	1,43 s	-	
DEMM	0,98 L/s	4,25 L/s	4,74 L/s	89,66 %
DEMM/ CVF	0,38 s-1	1,12 s-1	0,97 s-1	115,46 %
DE75	0,66 L/s	6,29 L/s	8,30 L/s	75,78 %
DE50	1,10 L/s	4,22 L/s	5,54 L/s	76,17 %
DE25	0,96 L/s	2,76 L/s	2,42 L/s	114,05 %