

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MORY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/2006	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 18 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 541	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 168 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 66 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 25,7 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,3 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 52 %

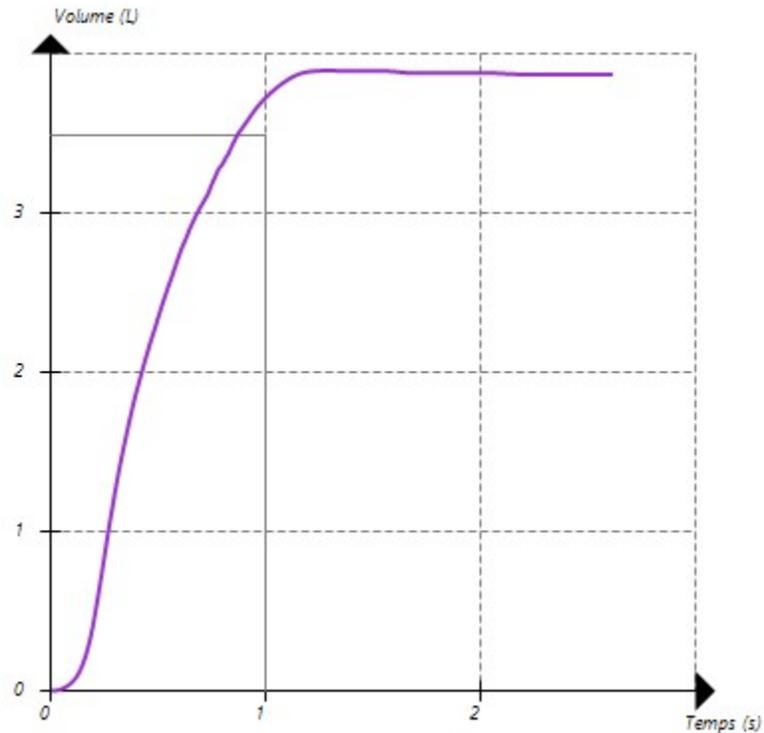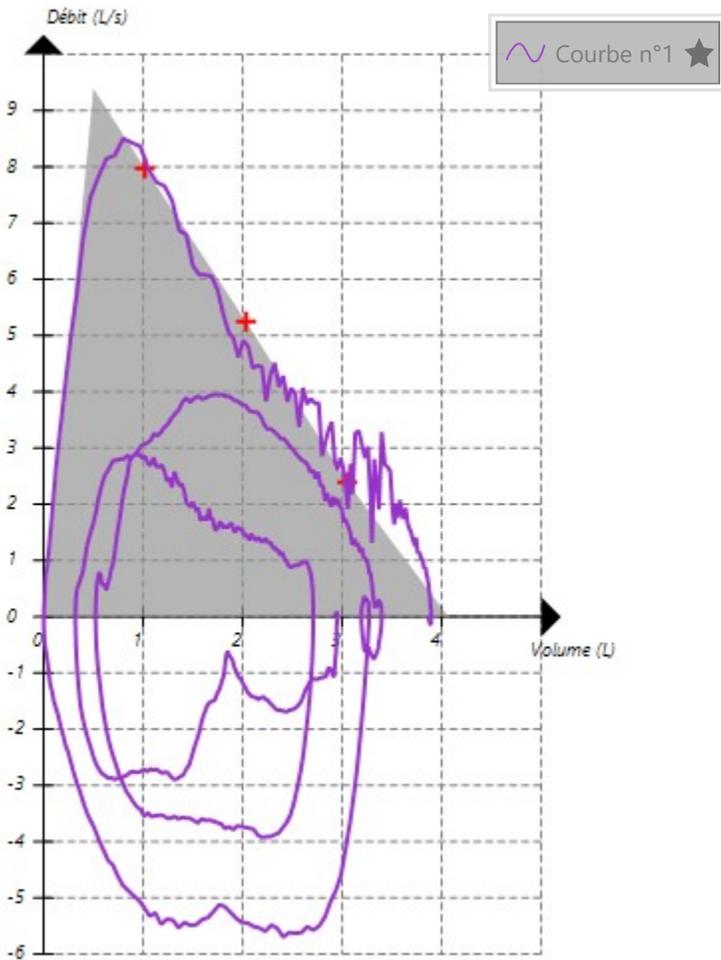

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,89 L	4,07 L	95,58 %
VEMS	3,87 L	3,49 L	110,89 %
DEP	8,67 L/s	9,40 L/s	92,23 %
VEMS/CVF	99,49 %	82,74 %	120,24 %
Durée d'expiration	1,28 s	-	
DEMM	5,01 L/s	4,89 L/s	102,45 %
DEMM/CVF	1,29 s-1	1,04 s-1	124,04 %
DE75	8,40 L/s	7,98 L/s	105,26 %
DE50	4,55 L/s	5,25 L/s	86,67 %
DE25	2,53 L/s	2,39 L/s	105,86 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: