

<b>Nom</b> YUE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> DEQUAN	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 09/02/1973	<b>Profession</b> MACON
<b>Age</b> 52 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 7259	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Groupe ethnique</b> Chinois de Hong Kong
<b>Poids</b> 72 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232707  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Température ambiante : 31,6 °C  
 Pression atmosphérique : 93,8 kPa  
 Humidité : 58 %

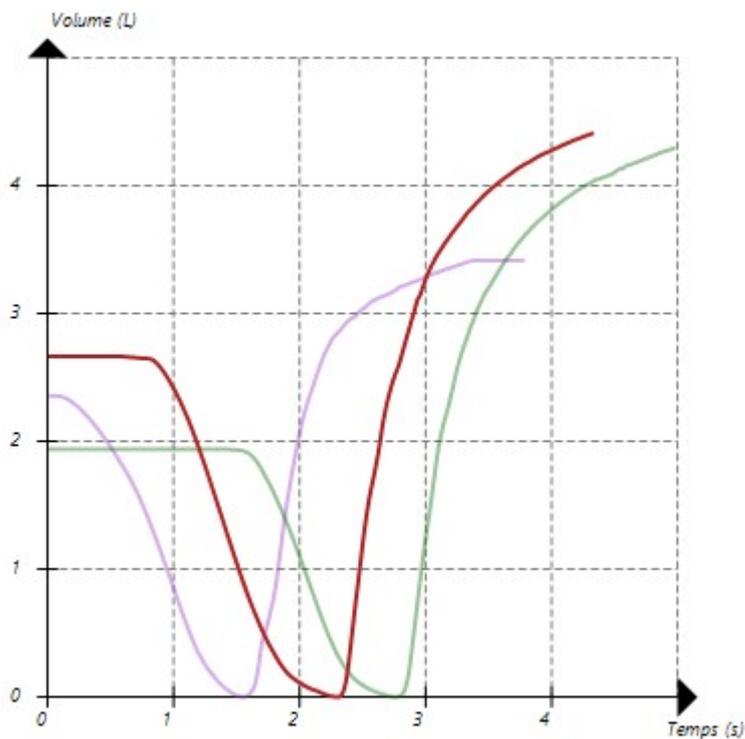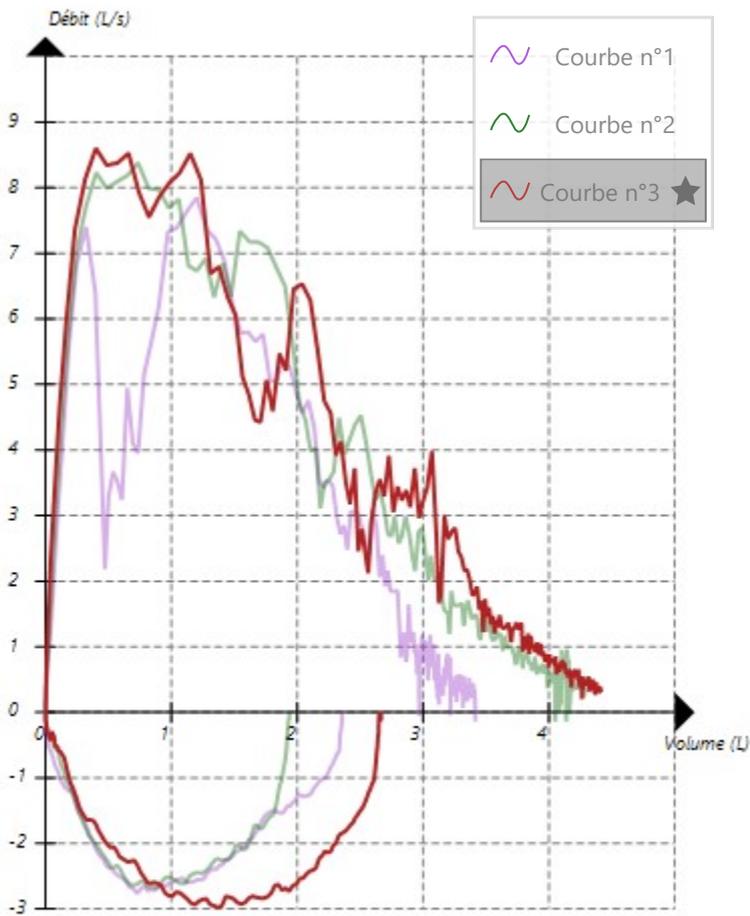

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,42 L	4,30 L	4,42 L	4,50 L	98,22 %
VEMS	3,15 L	3,68 L	3,81 L	3,49 L	109,17 %
DEP	8,14 L/s	8,66 L/s	9,17 L/s	9,05 L/s	101,33 %
VEMS/CVF	92,11 %	85,58 %	86,20 %	77,32 %	111,48 %
Durée d'expiration	1,87 s	2,24 s	2,04 s	-	
DEMM	4,98 L/s	3,98 L/s	4,18 L/s	3,09 L/s	135,28 %
DEMM/CVF	1,46 s-1	0,93 s-1	0,95 s-1	0,69 s-1	137,68 %
DE75	5,50 L/s	7,82 L/s	8,06 L/s	-	
DE50	5,93 L/s	3,74 L/s	4,36 L/s	-	
DE25	3,35 L/s	2,11 L/s	2,60 L/s	-	