



<b>Nom</b> TRAORE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADI	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 10/02/1978	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 47 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 9585	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 154 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 57 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 30,4 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,9 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 64 %

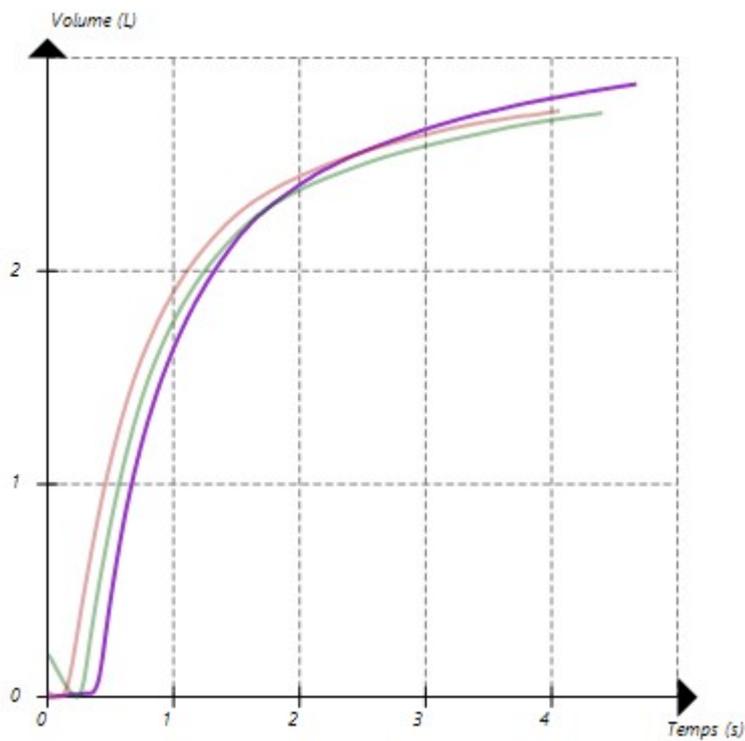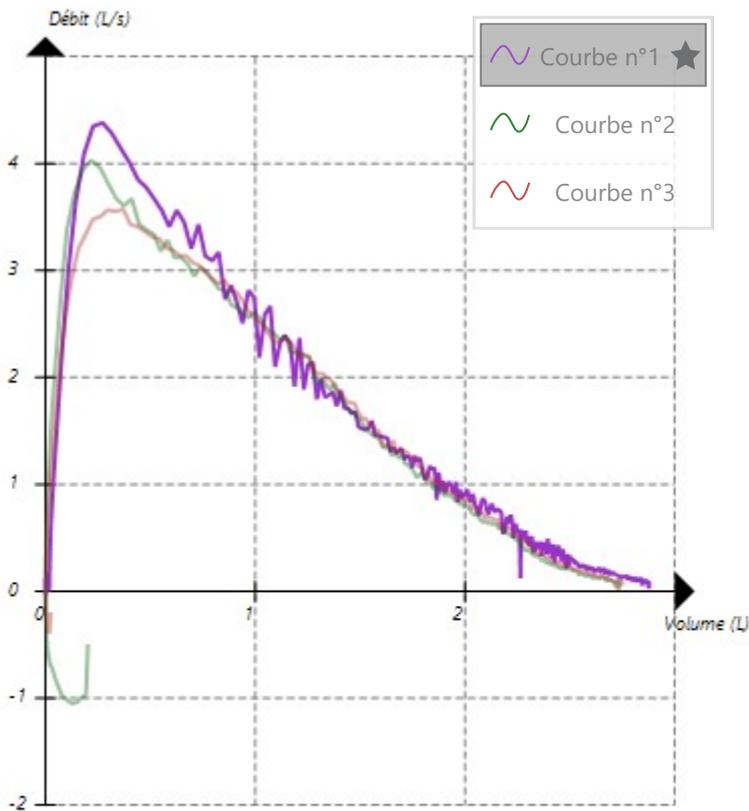

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,88 L	2,74 L	2,75 L	2,94 L	97,96 %
VEMS	2,06 L	2,01 L	2,04 L	2,38 L	86,55 %
DEP	4,49 L/s	4,10 L/s	3,60 L/s	6,79 L/s	66,13 %
VEMS/CVF	71,53 %	73,36 %	74,18 %	80,65 %	88,69 %
Durée d'expiration	4,67 s	4,19 s	4,00 s	-	
DEMM	1,53 L/s	1,59 L/s	1,65 L/s	2,64 L/s	57,95 %
DEMM/CVF	0,53 s-1	0,58 s-1	0,60 s-1	0,90 s-1	58,89 %
DE75	3,55 L/s	3,07 L/s	3,08 L/s	-	
DE50	1,63 L/s	2,00 L/s	1,90 L/s	-	
DE25	0,56 L/s	0,73 L/s	0,75 L/s	-	