

Nom CAMARA
Prénom BANGALY

Né le 25/12/1990

Age 33 Ans

Genre Masculin

ID 905

Taille 177 cm

Poids 59 kg

Valeurs prédites Knudson

Opérateur admin admin

Adresse

Exposition

Profession ELECTRICIEN

Entreprise CR18

Service

Fumeur Non fumeur

Prescripteur:

Smoking Pack Years : 0



Fim medical

51 rue Primat

+33 (0)4 72 34 89 89

+33(0)4 72 33 43 51

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Numéro de série : 232697

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 28,1 °C

Pression atmosphérique : 93,1 kPa

Humidité : 46 %

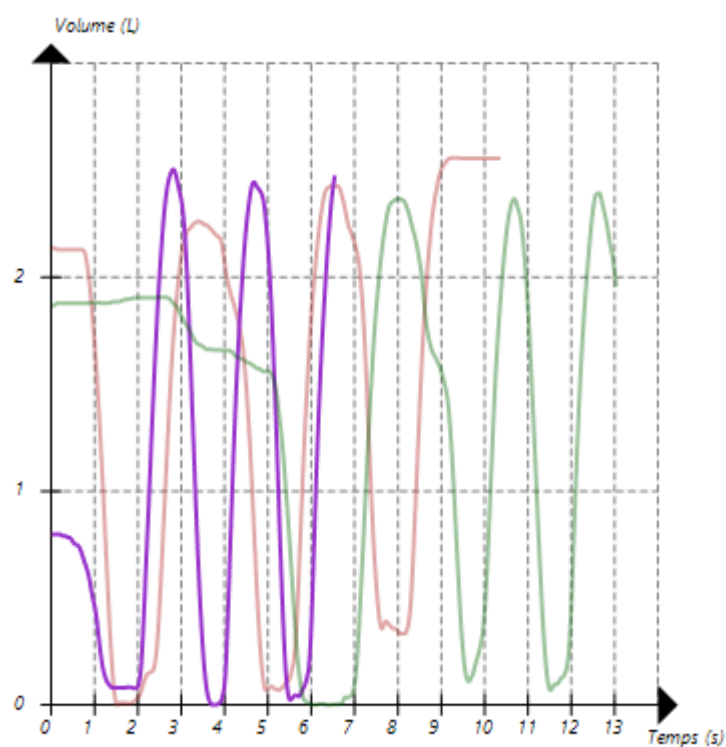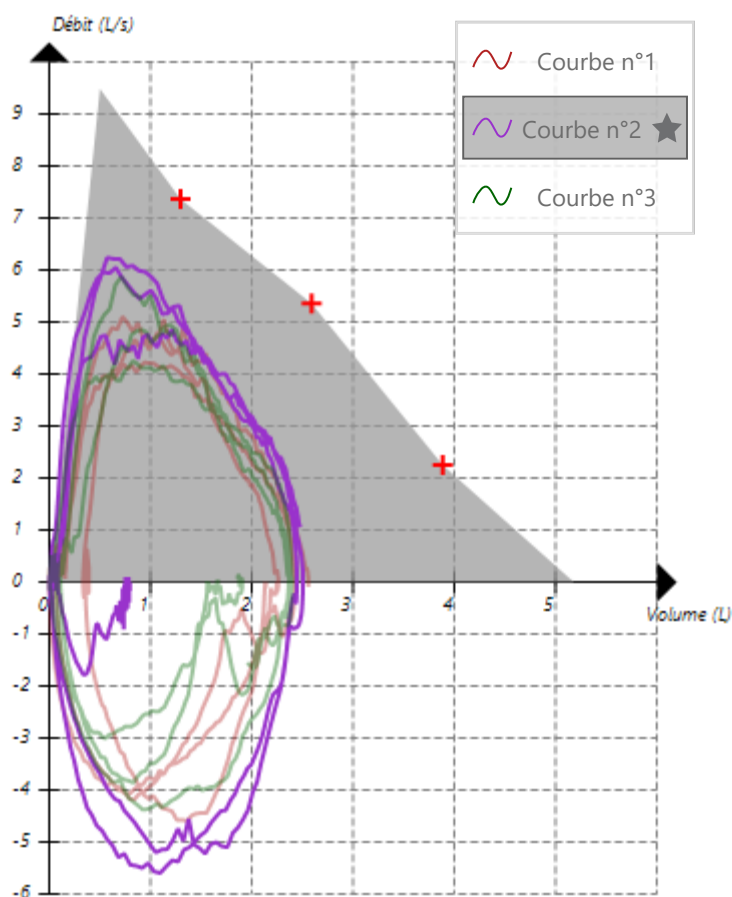

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,23 L	2,44 L	2,32 L	5,18 L	47,10 %
VEMS	2,23 L	2,44 L	2,32 L	4,30 L	56,74 %
DEP	5,24 L/s	6,32 L/s	5,94 L/s	9,49 L/s	66,60 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	83,24 %	120,13 %
Durée d'expiration	1,20 s	0,84 s	1,11 s	-	
DEMM	4,08 L/s	4,94 L/s	4,56 L/s	4,53 L/s	109,05 %
DEMM/CVF	1,83 s-1	2,02 s-1	1,97 s-1	0,87 s-1	232,18 %
DE75	4,49 L/s	6,27 L/s	5,89 L/s	7,37 L/s	85,07 %
DE50	4,27 L/s	5,38 L/s	4,83 L/s	5,36 L/s	100,37 %
DE25	2,79 L/s	3,40 L/s	2,92 L/s	2,25 L/s	151,11 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: