

<b>Nom</b> LI	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ZHONGWEN	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 12/11/1986	<b>Profession</b> EXCAVATEUR OPERATOR
<b>Age</b> 37 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 866	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 173 cm	<b>Groupe ethnique</b> Chinois de Hong Kong
<b>Poids</b> 61 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,3 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 58 %

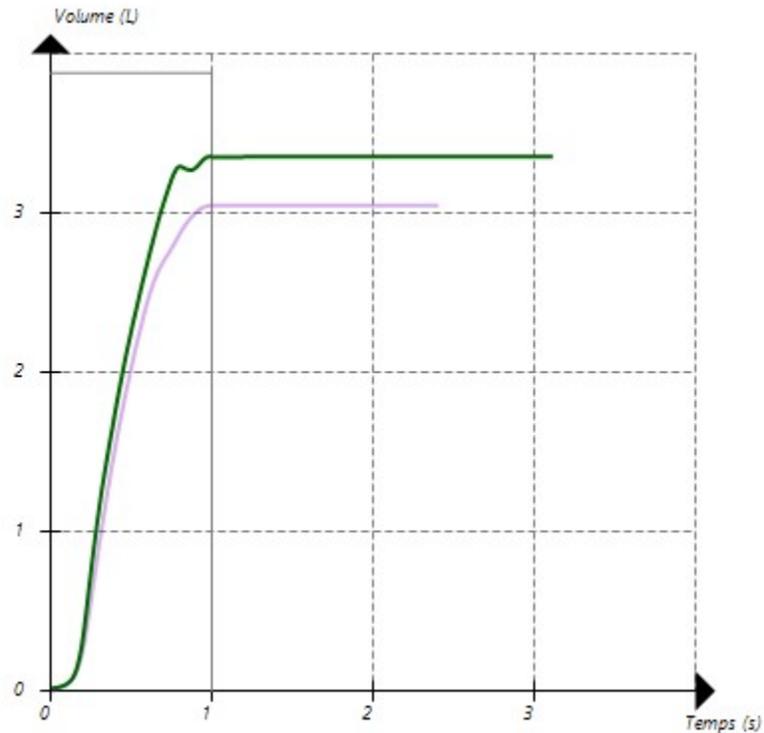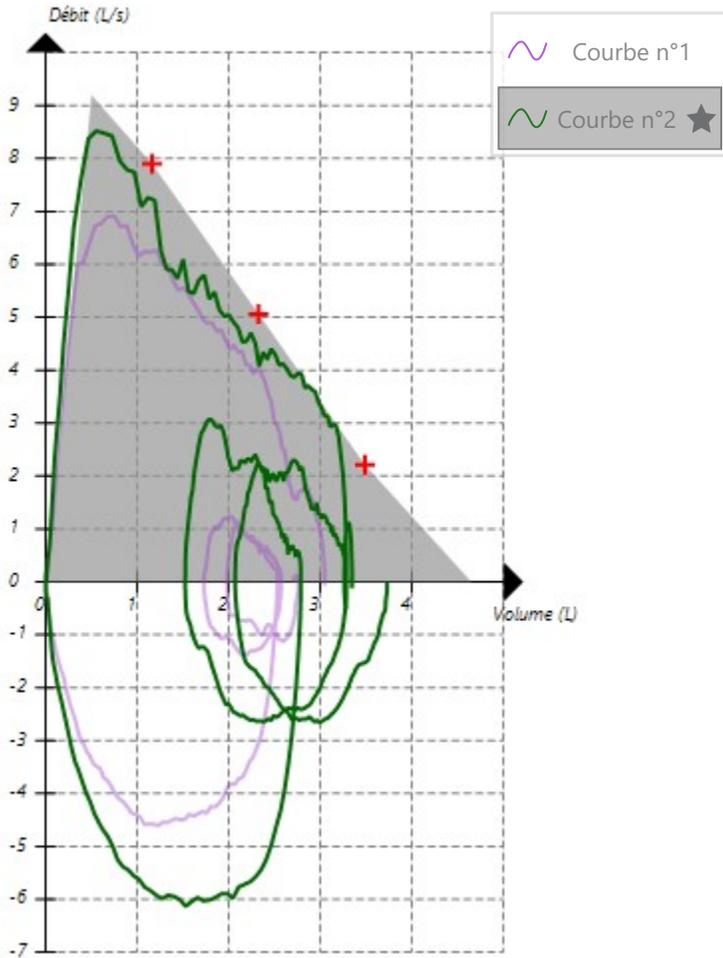

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,05 L	3,29 L	4,65 L	70,75 %
VEMS	3,05 L	3,29 L	3,88 L	84,79 %
DEP	7,12 L/s	8,62 L/s	9,20 L/s	93,70 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	80,59 %	124,08 %
Durée d'expiration	1,06 s	0,90 s	-	
DEMM	5,41 L/s	5,70 L/s	4,47 L/s	127,52 %
DEMM/ CVF	1,77 s-1	1,73 s-1	0,96 s-1	180,21 %
DE75	6,93 L/s	7,94 L/s	7,90 L/s	100,51 %
DE50	5,72 L/s	5,52 L/s	5,06 L/s	109,09 %
DE25	3,98 L/s	4,47 L/s	2,21 L/s	202,26 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: