

<b>Nom</b> KEITA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOUSSA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1990	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 34 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1493	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 168 cm	<b>Groupe ethnique</b> Indien du sud
<b>Poids</b> 93 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 31,6 °C  
 Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Humidité : 58 %

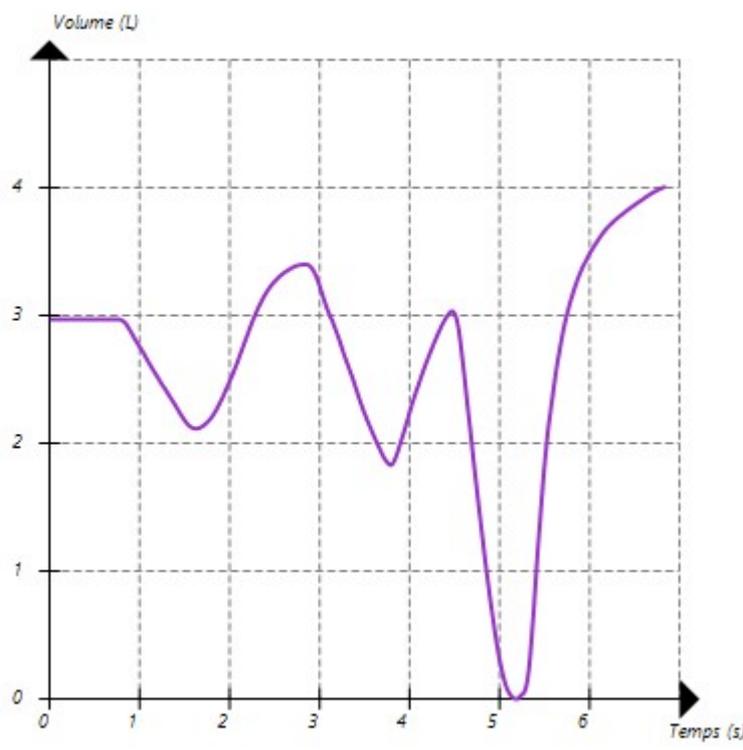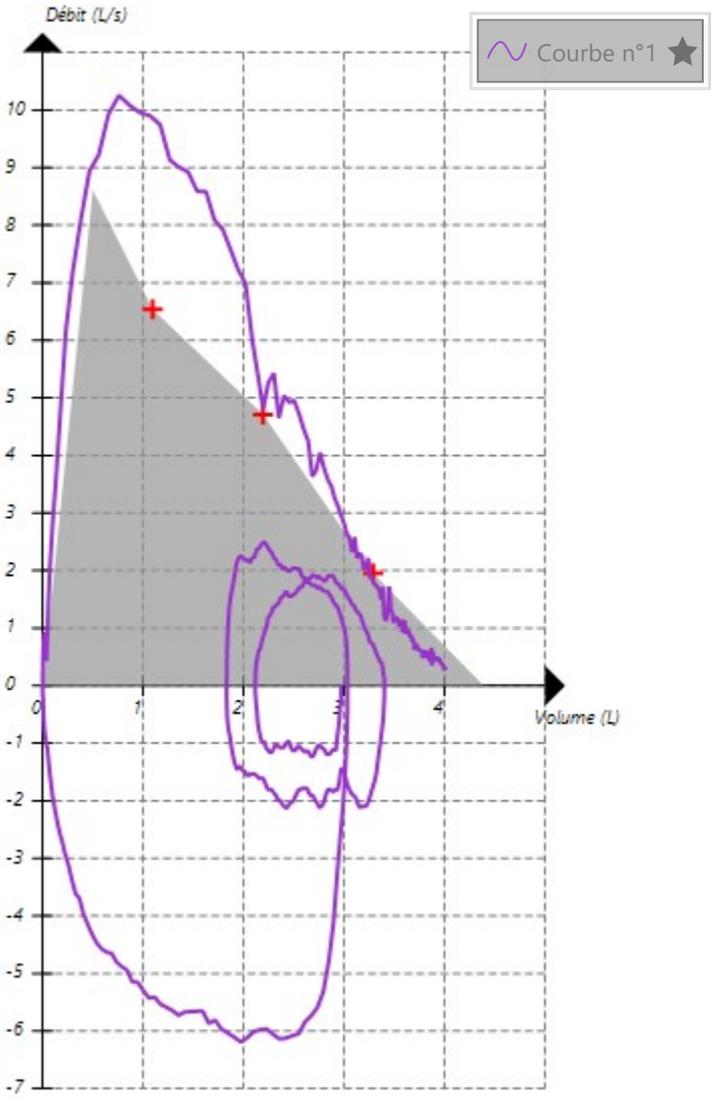

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,01 L	4,39 L	91,34 %
VEMS	3,76 L	3,67 L	102,45 %
DEP	10,59 L/s	8,61 L/s	123,00 %
VEMS/ CVF	93,77 %	83,13 %	112,80 %
Durée d'expiration	1,67 s	-	
DEMM	5,90 L/s	3,97 L/s	148,61 %
DEMM/ CVF	1,47 s-1	0,90 s-1	163,33 %
DE75	10,04 L/s	6,54 L/s	153,52 %
DE50	7,23 L/s	4,71 L/s	153,50 %
DE25	2,58 L/s	1,95 L/s	132,31 %