



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ADAMA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/2003	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 21 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1022	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 168 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 59 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,1 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 94,2 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 62 %

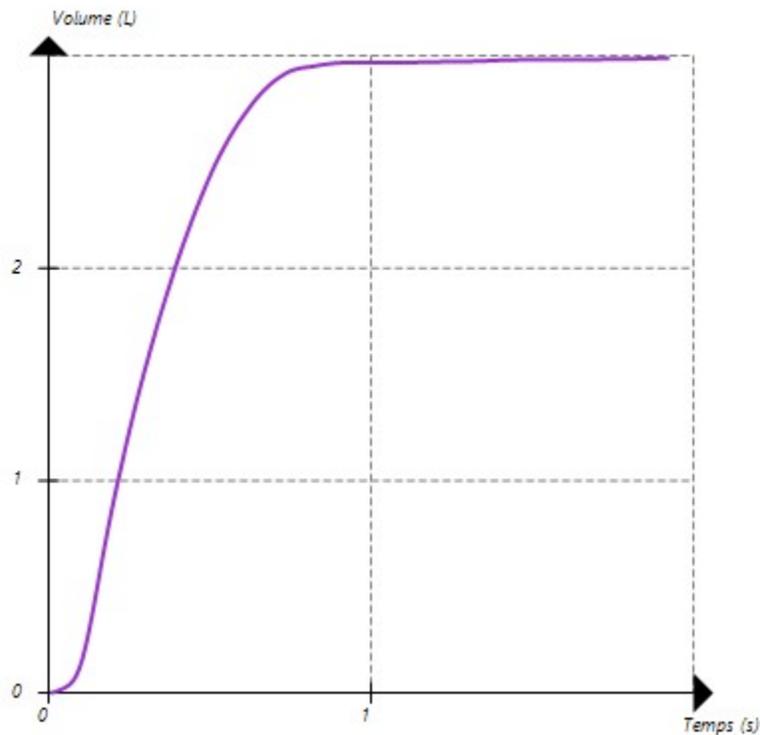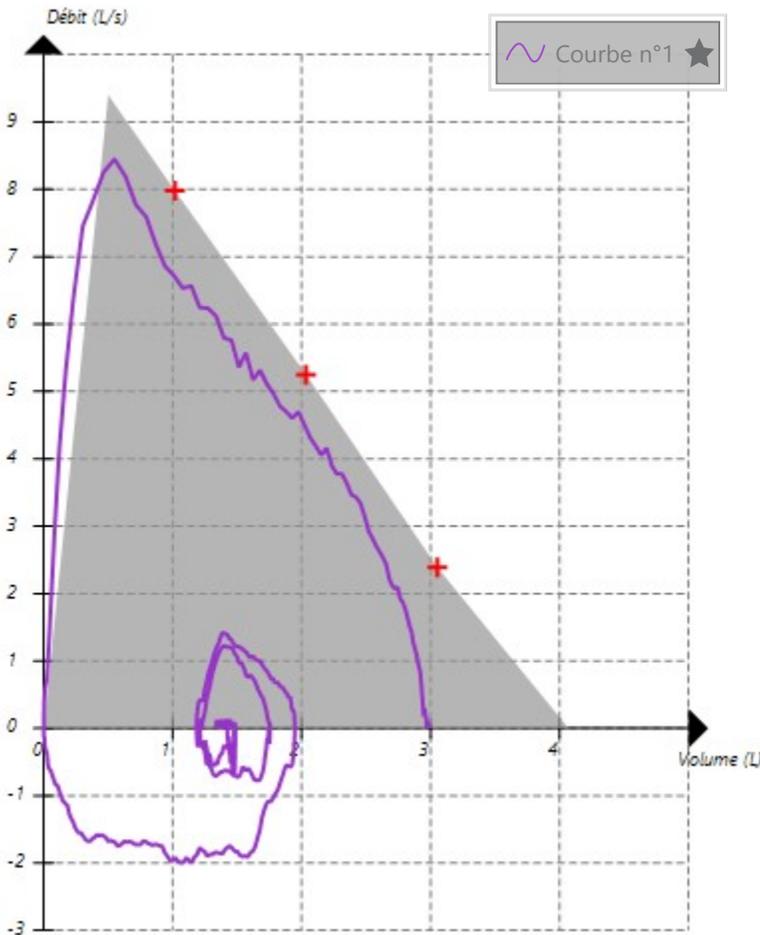

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,99 L	4,07 L	73,46 %
VEMS	2,97 L	3,49 L	85,10 %
DEP	8,67 L/s	9,40 L/s	92,23 %
VEMS/ CVF	99,33 %	82,74 %	120,05 %
Durée d'expiration	1,94 s	-	
DEMM	5,58 L/s	4,89 L/s	114,11 %
DEMM/ CVF	1,87 s-1	1,04 s-1	179,81 %
DE75	7,91 L/s	7,98 L/s	99,12 %
DE50	5,43 L/s	5,25 L/s	103,43 %
DE25	3,86 L/s	2,39 L/s	161,51 %