



<b>Nom</b> SANTOS	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 14/06/1992	<b>Profession</b> ROLLER OPERATOR
<b>Age</b> 32 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 4451	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 168 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 70 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BAH OUMOU SALAMATA	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 34,7 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 94,8 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 49 %

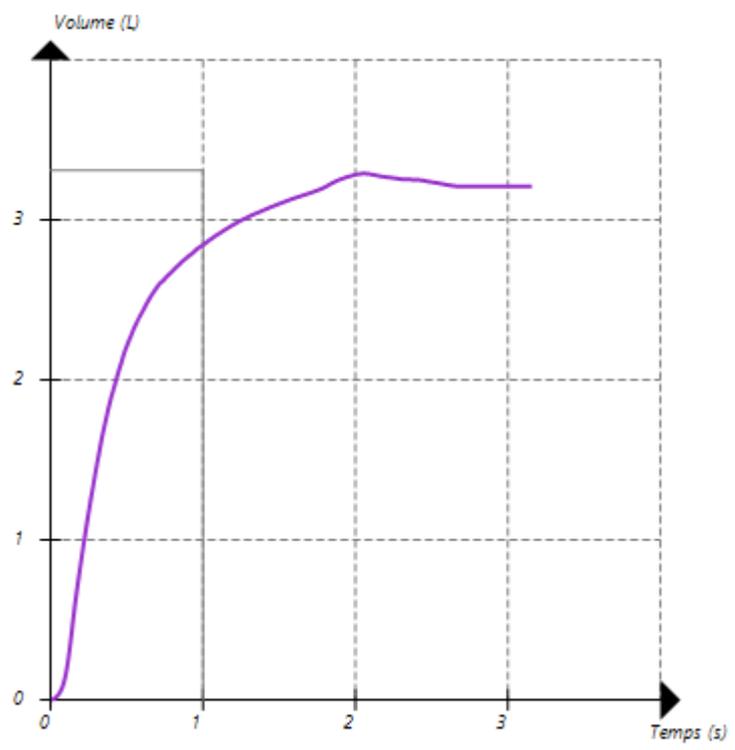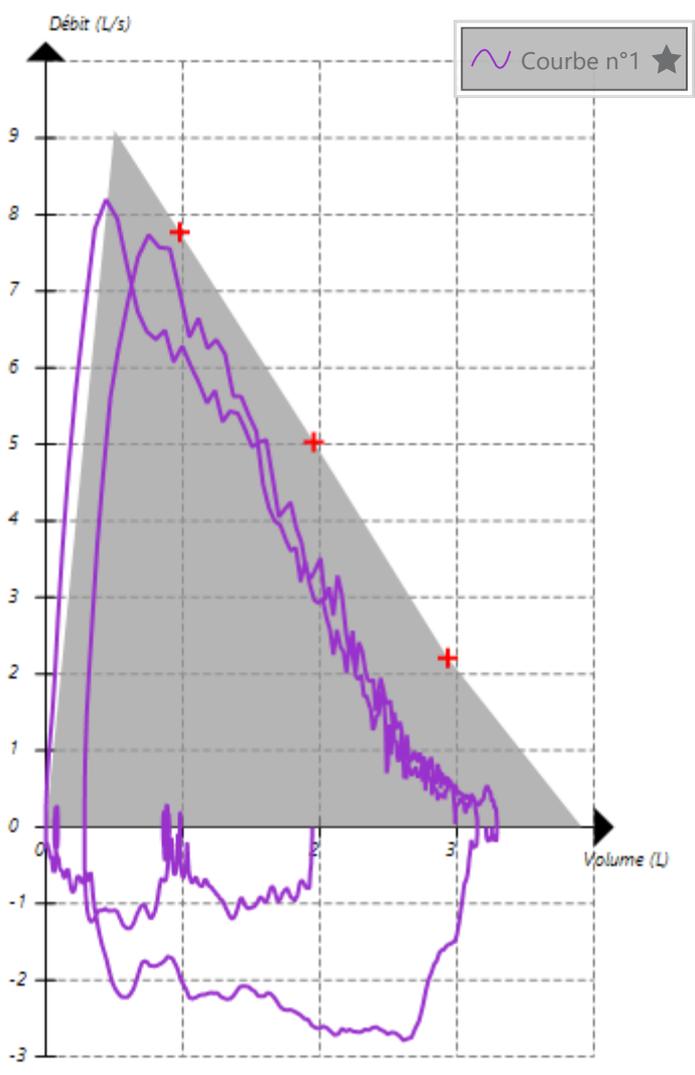

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,29 L	3,91 L	84,14 %
VEMS	2,90 L	3,31 L	87,61 %
DÉP	8,41 L/s	9,10 L/s	92,42 %
VEMS/CVF	88,15 %	81,48 %	108,19 %
Durée d'expiration	2,05 s	-	
DEMM	3,82 L/s	4,59 L/s	83,22 %
DEMM/CVF	1,16 s <sup>-1</sup>	1,02 s <sup>-1</sup>	113,73 %
DE75	6,39 L/s	7,77 L/s	82,24 %
DE50	4,71 L/s	5,03 L/s	93,64 %
DE25	1,80 L/s	2,21 L/s	81,45 %