

<b>Nom CISSE</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom LASSO</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 01/01/1985</b>	<b>Profession MANOEUVRE</b>
<b>Age 39 Ans</b>	<b>Entreprise CR18</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 584</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 168 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids 64 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 30 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 52 %

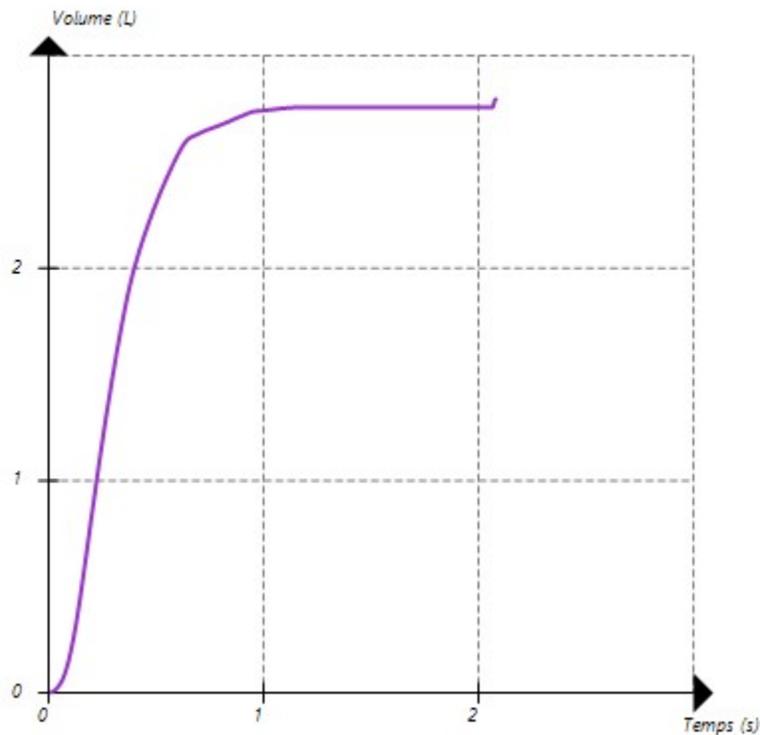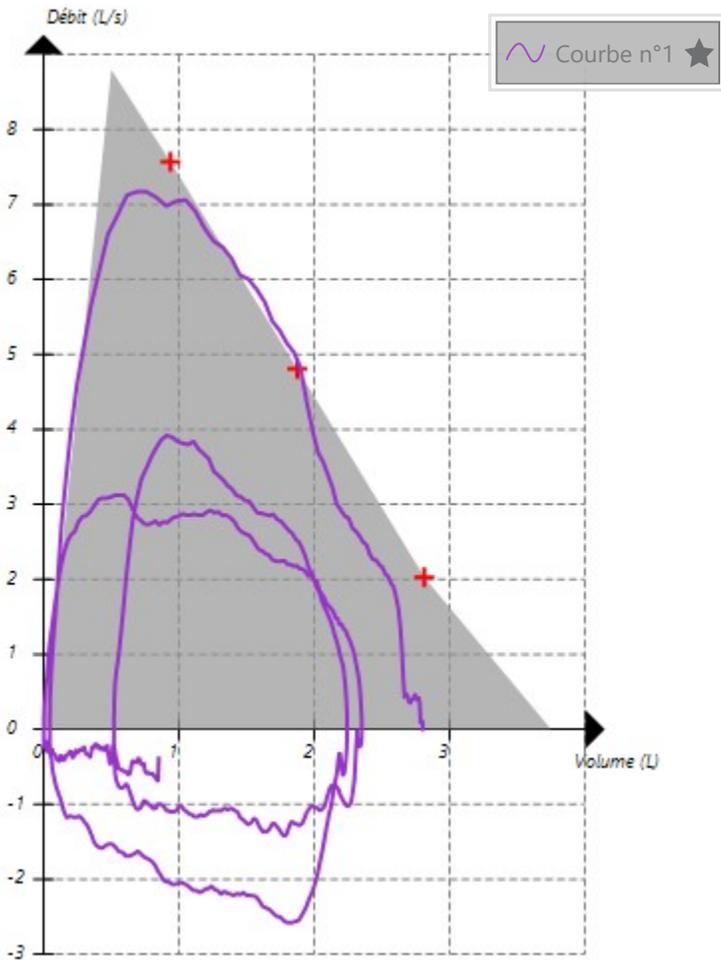

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,76 L	3,75 L	73,60 %
VEMS	2,75 L	3,13 L	87,86 %
DEP	7,25 L/s	8,80 L/s	82,39 %
VEMS/CVF	99,64 %	80,23 %	124,19 %
Durée d'expiration	1,14 s	-	
DEMM	5,79 L/s	4,29 L/s	134,97 %
DEMM/CVF	2,10 s-1	1,00 s-1	210,00 %
DE75	7,25 L/s	7,57 L/s	95,77 %
DE50	6,20 L/s	4,81 L/s	128,90 %
DE25	3,29 L/s	2,03 L/s	162,07 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: