



<b>Nom</b> TRAORE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> KARAMO	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 03/09/1995	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 28 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 332	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 168 cm	<b>Groupe ethnique</b> Caucasien
<b>Poids</b> 60 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,6 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 698,3 mmHg  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 51 %

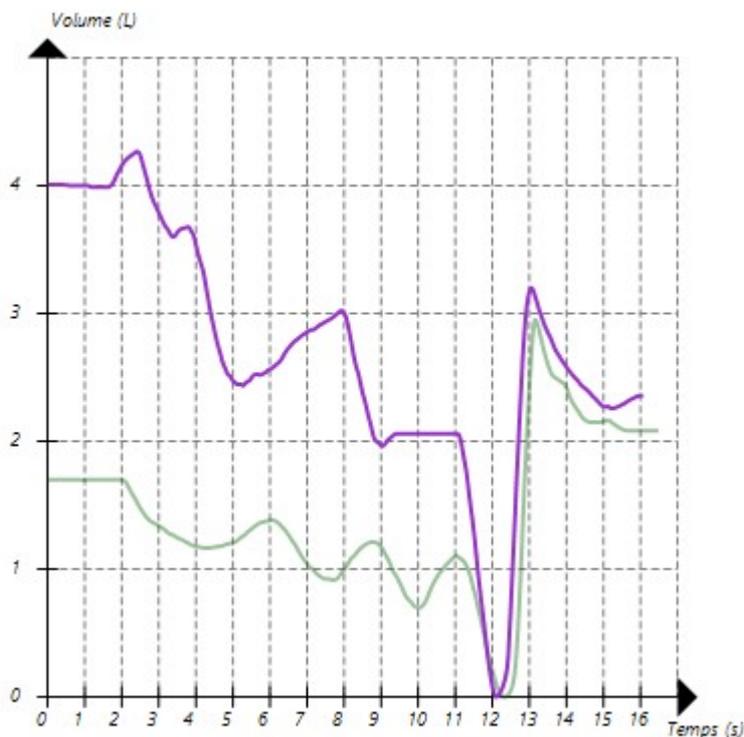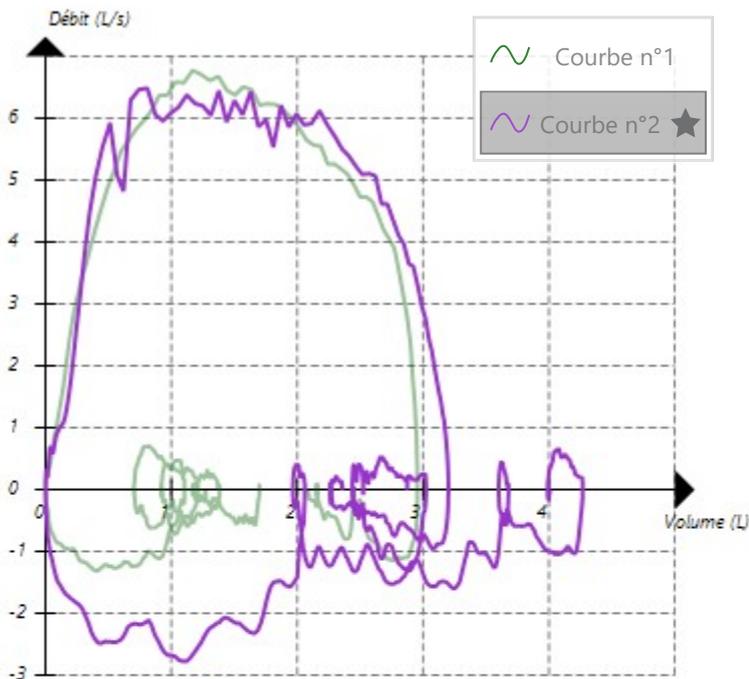

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,95 L	3,20 L	4,88 L	65,57 %
VEMS	2,95 L	3,20 L	4,03 L	79,40 %
DEP	6,87 L/s	6,82 L/s	9,39 L/s	72,63 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	82,28 %	121,54 %
Durée d'expiration	0,84 s	0,95 s	-	
DEMM	6,40 L/s	6,18 L/s	4,22 L/s	146,45 %
DEMM/ CVF	2,17 s-1	1,93 s-1	0,86 s-1	224,42 %
DE75	5,84 L/s	6,51 L/s	-	
DE50	6,43 L/s	6,43 L/s	-	
DE25	5,32 L/s	5,30 L/s	-	