



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> LAYE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 02/03/1986	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 39 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 7009	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 166 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 75 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27,9 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,8 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 65 %

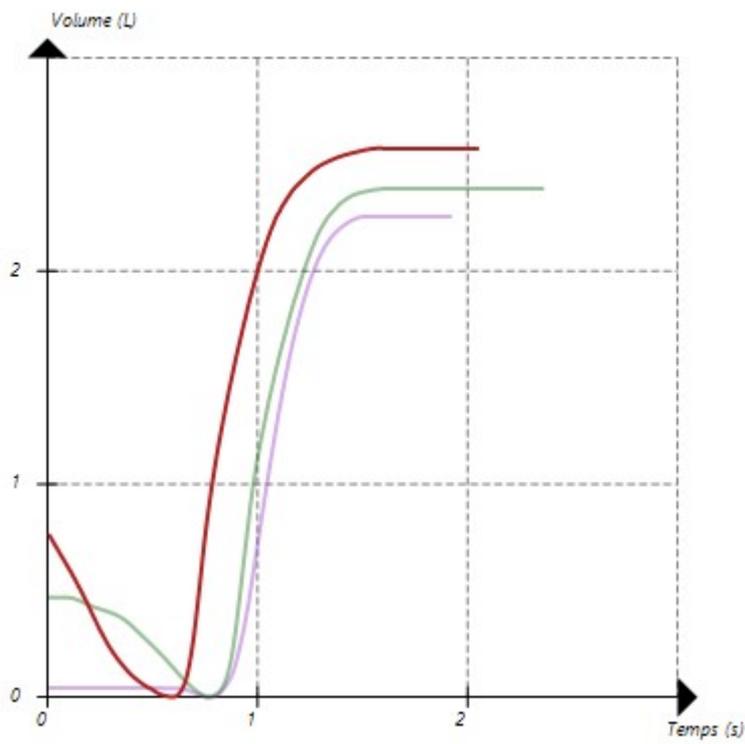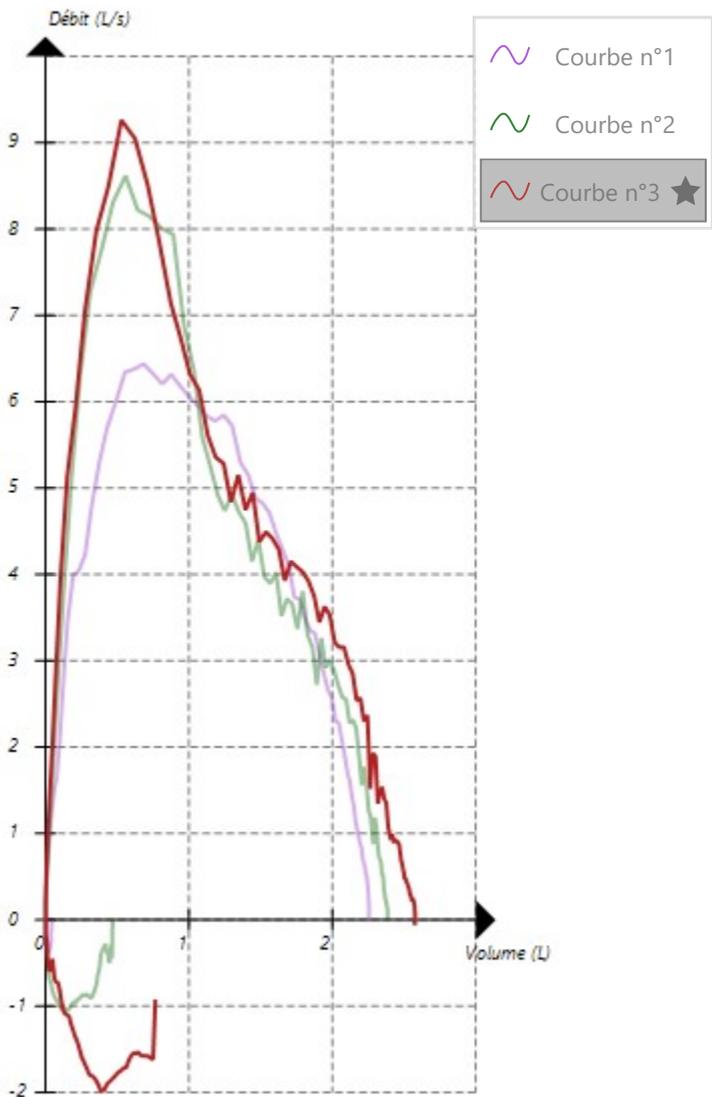

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,26 L	2,39 L	2,58 L	3,72 L	69,35 %
VEMS	2,26 L	2,39 L	2,58 L	3,08 L	83,77 %
DEP	6,61 L/s	8,76 L/s	9,59 L/s	8,17 L/s	117,38 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	82,11 %	121,79 %
Durée d'expiration	0,76 s	0,84 s	0,97 s	-	
DEMM	5,73 L/s	5,33 L/s	5,28 L/s	3,38 L/s	156,21 %
DEMM/ CVF	2,54 s-1	2,23 s-1	2,05 s-1	0,91 s-1	225,27 %
DE75	6,47 L/s	8,48 L/s	8,68 L/s	-	
DE50	5,91 L/s	4,77 L/s	4,72 L/s	-	
DE25	4,05 L/s	4,25 L/s	3,78 L/s	-	