

<b>Nom</b> MA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ZHONGQING	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 19/11/1975	<b>Profession</b> CHEF
<b>Age</b> 49 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 6976	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 169 cm	<b>Groupe ethnique</b> Chinois de Hong Kong
<b>Poids</b> 82 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BAH OUMOU SALAMATA	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale


Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 24,4 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,1 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 74 %

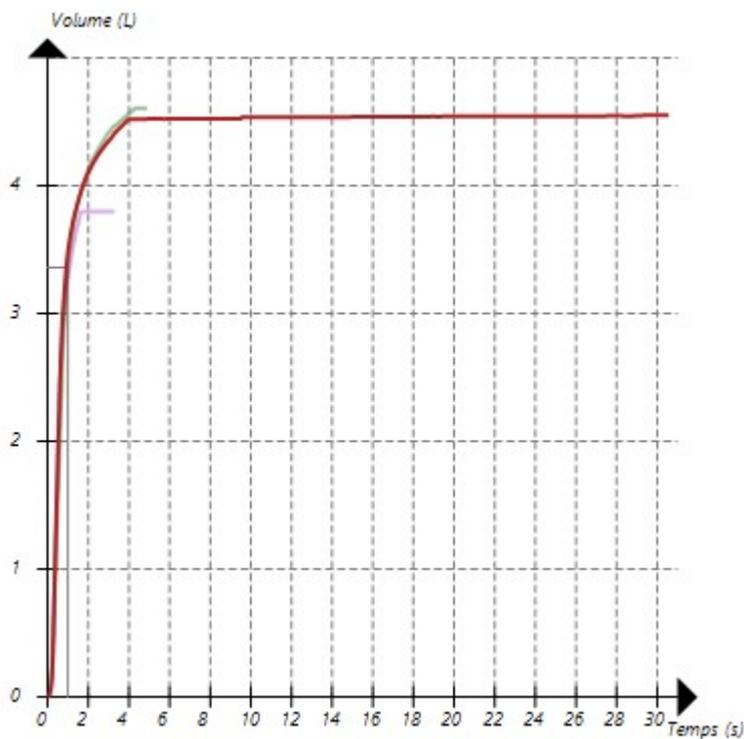

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,80 L	4,59 L	4,55 L	4,11 L	110,71 %
VEMS	3,49 L	3,64 L	3,69 L	3,36 L	109,82 %
DEP	7,23 L/s	5,85 L/s	6,93 L/s	8,43 L/s	82,21 %
VEMS/CVF	91,84 %	79,30 %	81,10 %	78,44 %	103,39 %
Durée d'expiration	2,65 s	9,31 s	30,10 s	-	
DEMM	4,92 L/s	3,63 L/s	4,01 L/s	3,88 L/s	103,35 %
DEMM/CVF	1,29 s-1	0,79 s-1	0,88 s-1	0,94 s-1	93,62 %
DE75	6,66 L/s	4,41 L/s	5,70 L/s	7,33 L/s	77,76 %
DE50	5,43 L/s	5,11 L/s	5,39 L/s	4,54 L/s	118,72 %
DE25	2,12 L/s	2,03 L/s	1,49 L/s	1,79 L/s	83,24 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: