



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> LAMINE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/03/2004	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 20 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b> SOUDEUR
<b>ID</b> 1687	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 172 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 61 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 71 %

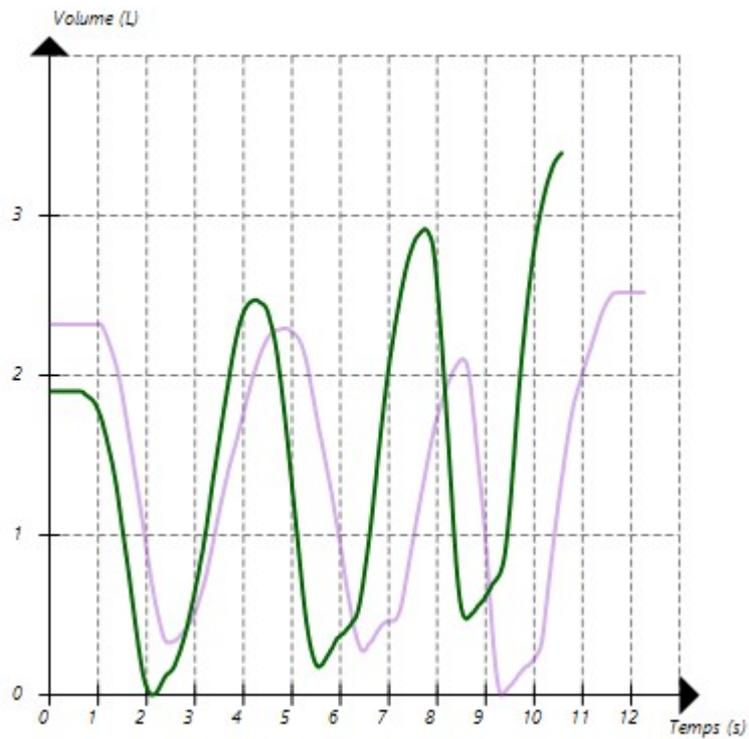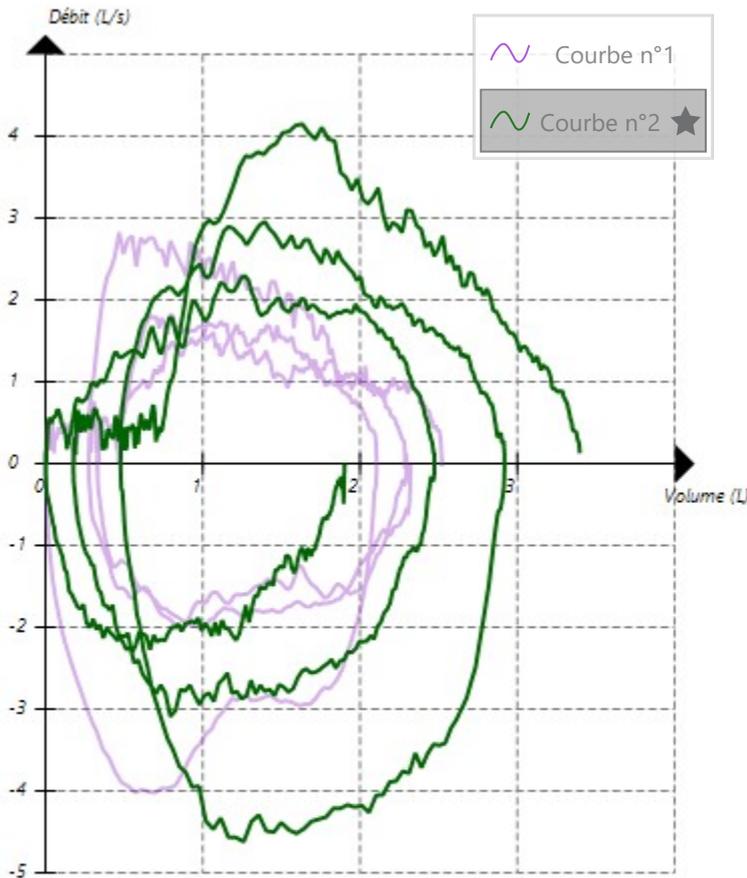

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,52 L	2,92 L	4,41 L	66,21 %
VEMS	2,03 L	2,78 L	3,78 L	73,54 %
DEP	2,94 L/s	4,32 L/s	9,50 L/s	45,47 %
VEMS/ CVF	80,56 %	95,21 %	85,58 %	111,25 %
Durée d'expiration	2,58 s	2,01 s	-	
DEMM	2,09 L/s	3,36 L/s	4,39 L/s	76,54 %
DEMM/ CVF	0,83 s-1	1,15 s-1	1,00 s-1	115,00 %
DE75	2,81 L/s	3,48 L/s	-	
DE50	2,34 L/s	3,25 L/s	-	
DE25	0,89 L/s	2,20 L/s	-	