



<b>Nom</b> SIDIBE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAKORIKA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 30/07/1986	<b>Profession</b> SECURITY ASSISTANT
<b>Age</b> 37 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Féminin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 244	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 89 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	

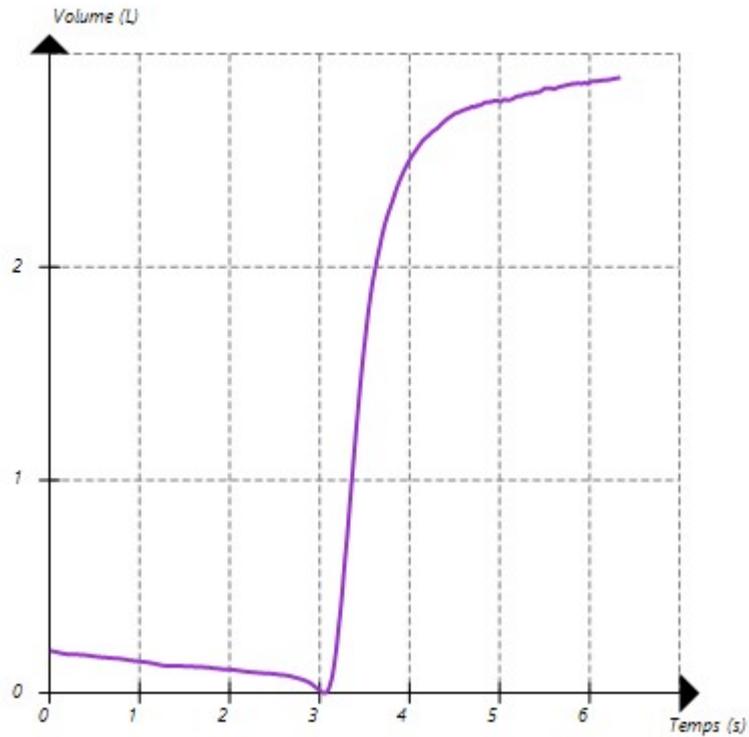

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27,9 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,1 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 53 %

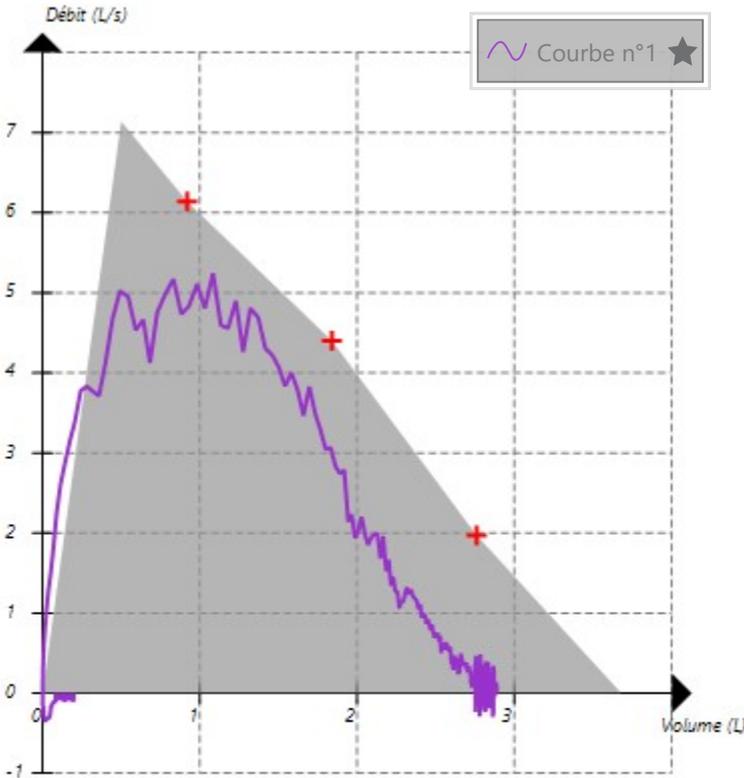

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,89 L	3,68 L	78,53 %
VEMS	2,60 L	3,19 L	81,50 %
DEP	5,64 L/s	7,14 L/s	78,99 %
VEMS/ CVF	89,97 %	82,00 %	109,72 %
Durée d'expiration	3,29 s	-	
DEMM	3,59 L/s	3,79 L/s	94,72 %
DEMM/ CVF	1,24 s-1	1,03 s-1	120,39 %
DE75	4,55 L/s	6,14 L/s	74,10 %
DE50	4,21 L/s	4,40 L/s	95,68 %
DE25	2,33 L/s	1,97 L/s	118,27 %