

<b>Nom</b> SANOH	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> AYOUBA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/2000	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 24 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1112	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 164 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 64 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 31,2 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,9 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 60 %

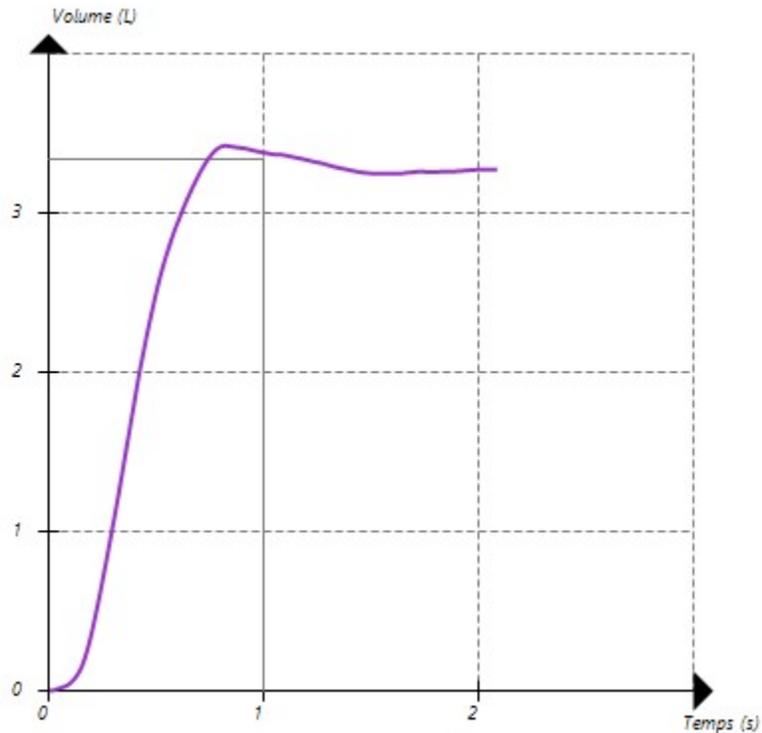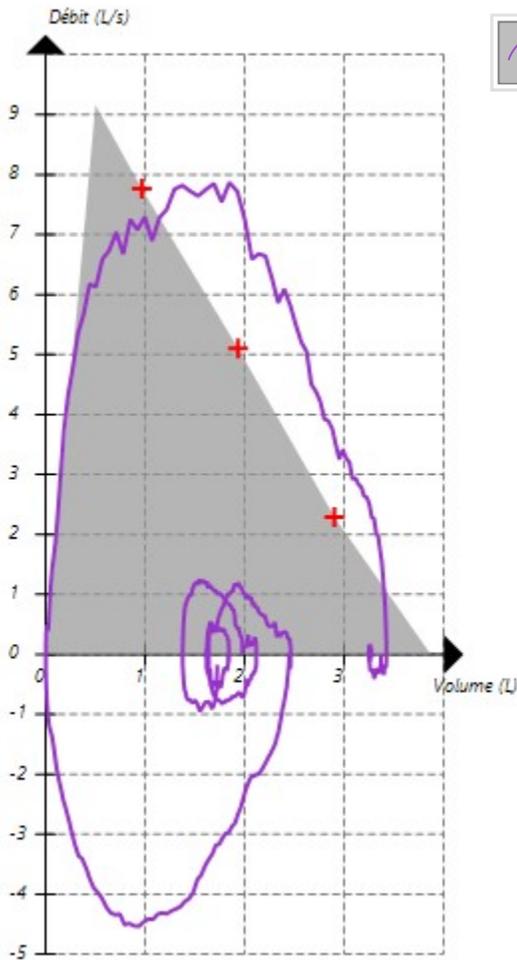

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,42 L	3,87 L	88,37 %
VEMS	3,42 L	3,34 L	102,40 %
DEP	8,08 L/s	9,16 L/s	88,21 %
VEMS/ CVF	100,00 %	82,74 %	120,86 %
Durée d'expiration	0,85 s	-	
DEMM	7,16 L/s	4,81 L/s	148,86 %
DEMM/ CVF	2,09 s-1	1,08 s-1	193,52 %
DE75	7,25 L/s	7,76 L/s	93,43 %
DE50	7,84 L/s	5,10 L/s	153,73 %
DE25	5,20 L/s	2,29 L/s	227,07 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: