

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MORY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 07/01/1981	<b>Profession</b> DAILY WORKER
<b>Age</b> 43 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 252	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 158 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 74 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:** SYNDROME RESTRICTIF LEGER



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 27,6 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,1 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 54 %

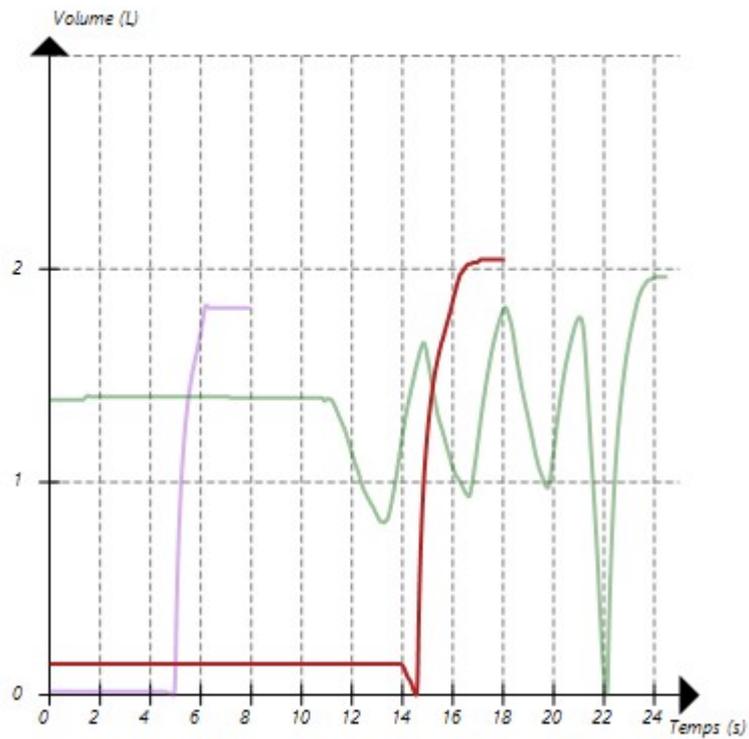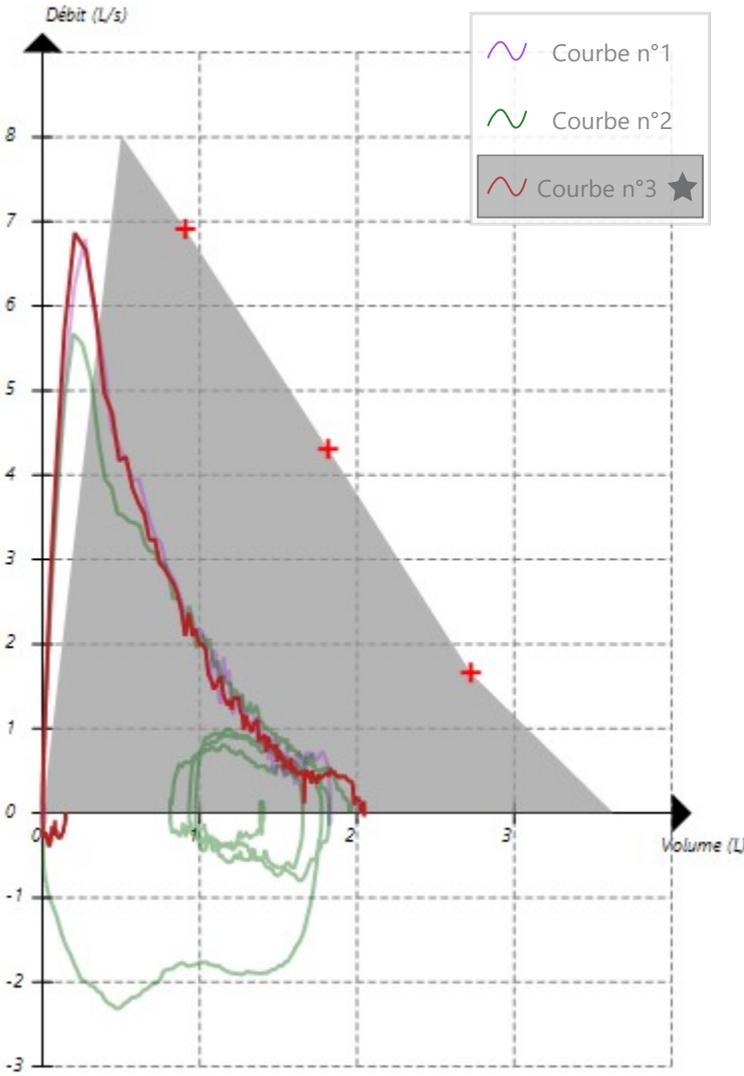

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	1,83 L	1,96 L	2,05 L	3,63 L	56,47 %
VEMS	1,68 L	1,73 L	1,66 L	3,06 L	54,25 %
DEP	6,92 L/s	5,77 L/s	7,11 L/s	8,02 L/s	88,65 %
VEMS/ CVF	91,80 %	88,27 %	80,98 %	79,51 %	101,85 %
Durée d'expiration	1,30 s	1,97 s	2,76 s	-	
DEMM	2,10 L/s	1,91 L/s	1,59 L/s	3,92 L/s	40,56 %
DEMM/ CVF	1,15 s-1	0,97 s-1	0,78 s-1	1,08 s-1	72,22 %
DE75	4,29 L/s	3,52 L/s	4,23 L/s	6,91 L/s	61,22 %
DE50	2,19 L/s	2,14 L/s	2,13 L/s	4,31 L/s	49,42 %
DE25	1,21 L/s	0,93 L/s	0,47 L/s	1,66 L/s	28,31 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: