



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> VALY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1984	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 40 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 326	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 180 cm	<b>Groupe ethnique</b> Caucasien
<b>Poids</b> 62 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 30,2 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 698,3 mmHg  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 49 %

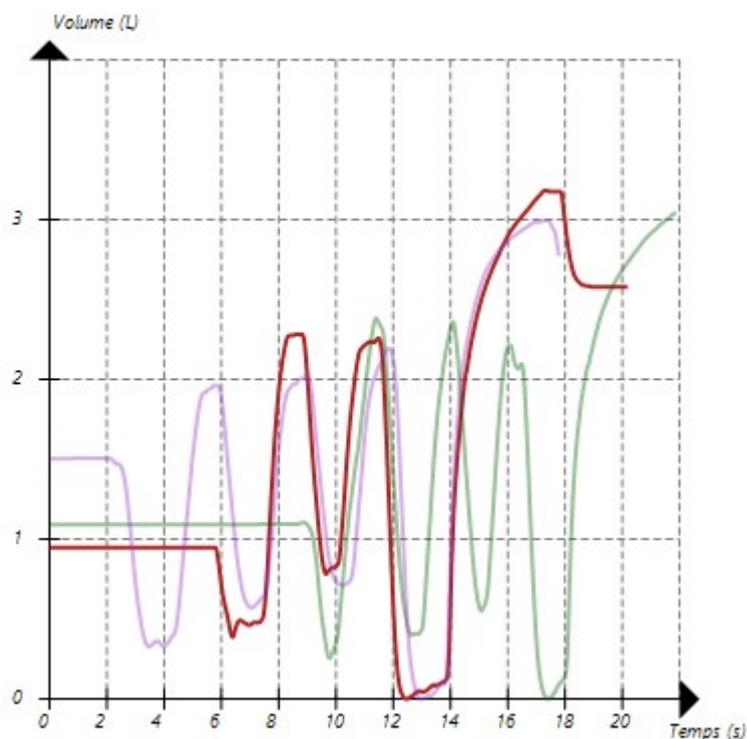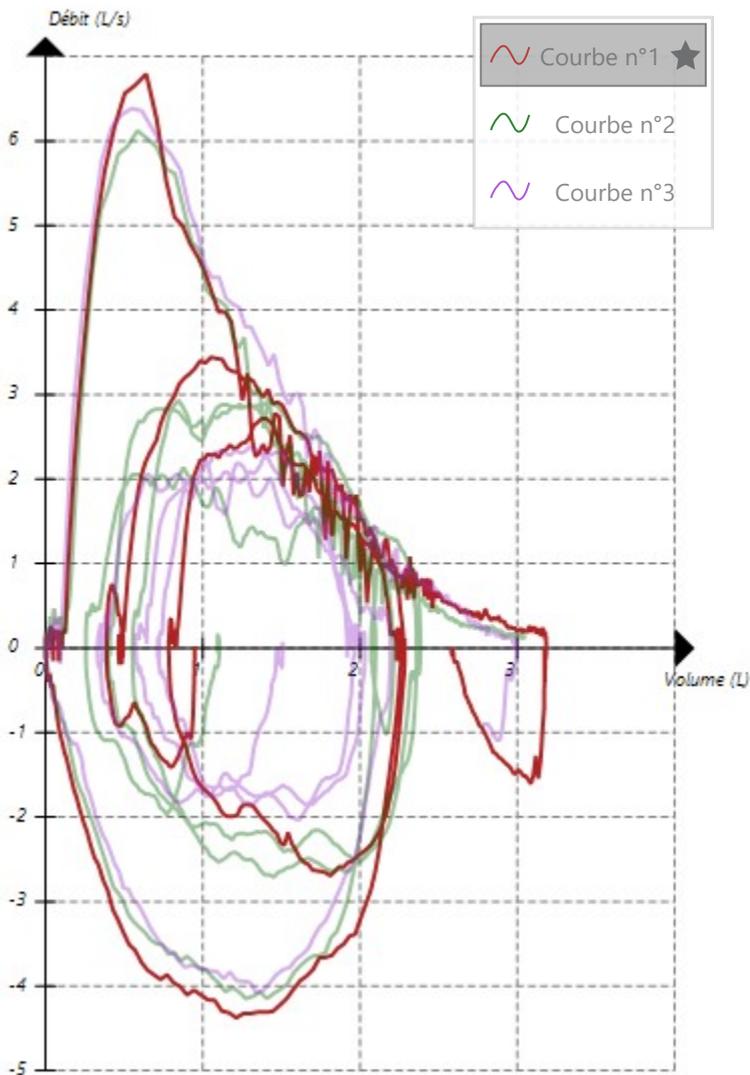

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,10 L	3,05 L	2,90 L	5,44 L	56,99 %
VEMS	2,31 L	2,26 L	2,40 L	4,32 L	53,47 %
DEP	6,91 L/s	6,17 L/s	6,47 L/s	10,37 L/s	66,63 %
VEMS/ CVF	74,52 %	74,10 %	82,76 %	79,80 %	93,38 %
Durée d'expiration	3,82 s	4,50 s	3,48 s	-	
DEMM	1,73 L/s	1,67 L/s	2,35 L/s	4,05 L/s	42,72 %
DEMM/ CVF	0,56 s-1	0,55 s-1	0,81 s-1	0,74 s-1	75,68 %
DE75	5,12 L/s	5,66 L/s	5,80 L/s	-	
DE50	2,35 L/s	2,42 L/s	2,85 L/s	-	
DE25	0,50 L/s	0,71 L/s	0,84 L/s	-	