

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> NOUHAN	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1991	<b>Profession</b> CONDUCTEUR GRADER
<b>Age</b> 33 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1464	<b>Fumeur</b> Ancien fumeur
<b>Taille</b> 171 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 63 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> ITS (Crapo)	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> LY MAMOUDOU	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Les prédicts sélectionnés ne permettent pas de réaliser ce type d'interprétation.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 24,8 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 60 %

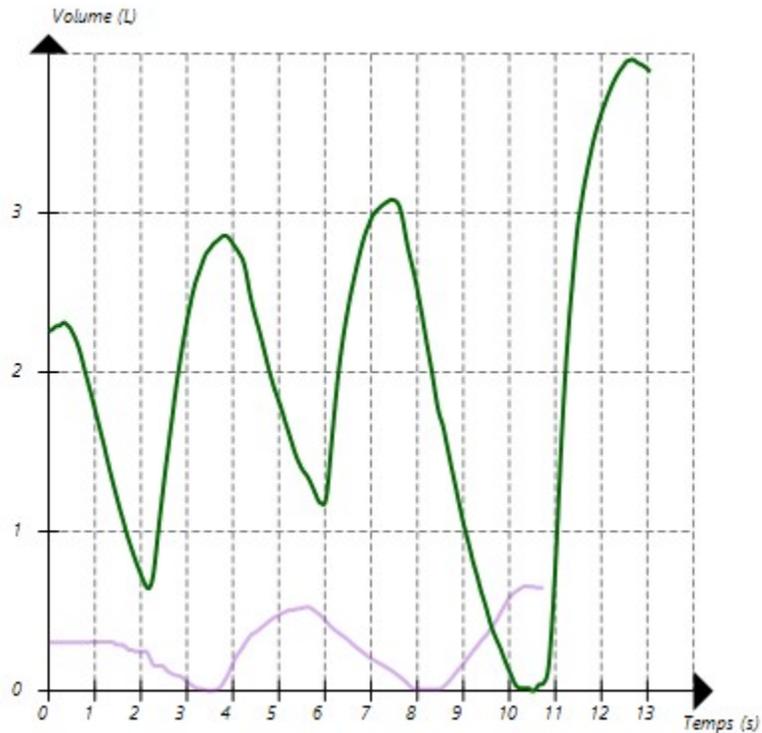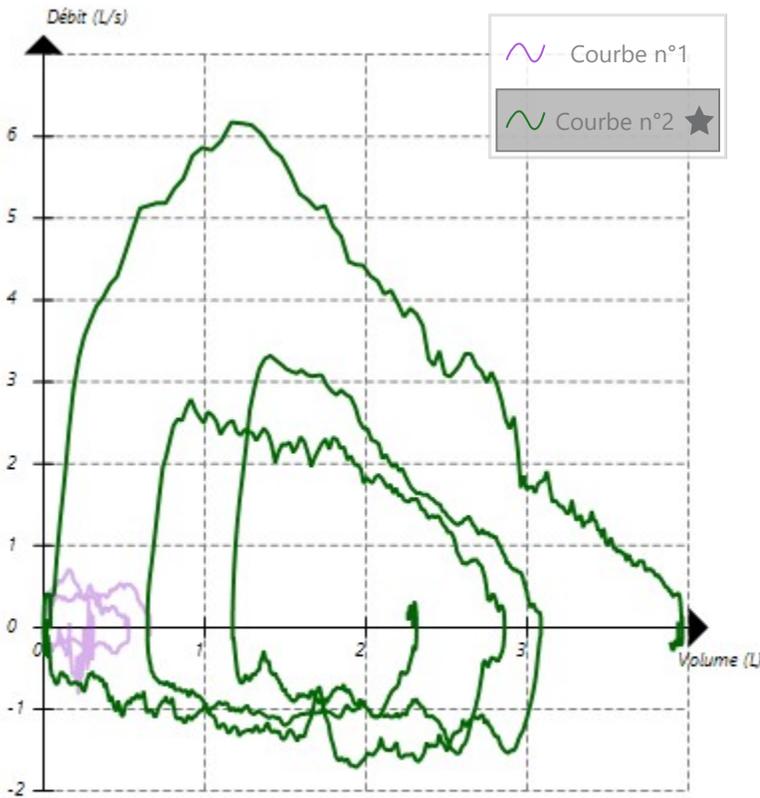

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	-	3,92 L	4,90 L	80,00 %
VEMS	-	3,47 L	4,08 L	85,05 %
DEP	0,97 L/s	6,29 L/s	-	-
VEMS/CVF	-	88,52 %	83,24 %	106,34 %
Durée d'expiration	0,01 s	1,96 s	-	-
DEMM	1,08 L/s	4,12 L/s	4,37 L/s	94,28 %
DEMM/CVF	-	1,05 s-1	0,89 s-1	117,98 %
DE75	0,86 L/s	5,80 L/s	-	-
DE50	0,97 L/s	4,43 L/s	-	-
DE25	0,88 L/s	1,88 L/s	-	-