

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ANSOUMANE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 02/04/1989	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 35 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 494	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 183 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 72 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	





**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232697  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 28 °C  
 Pression atmosphérique : 93,3 kPa  
 Humidité : 45 %

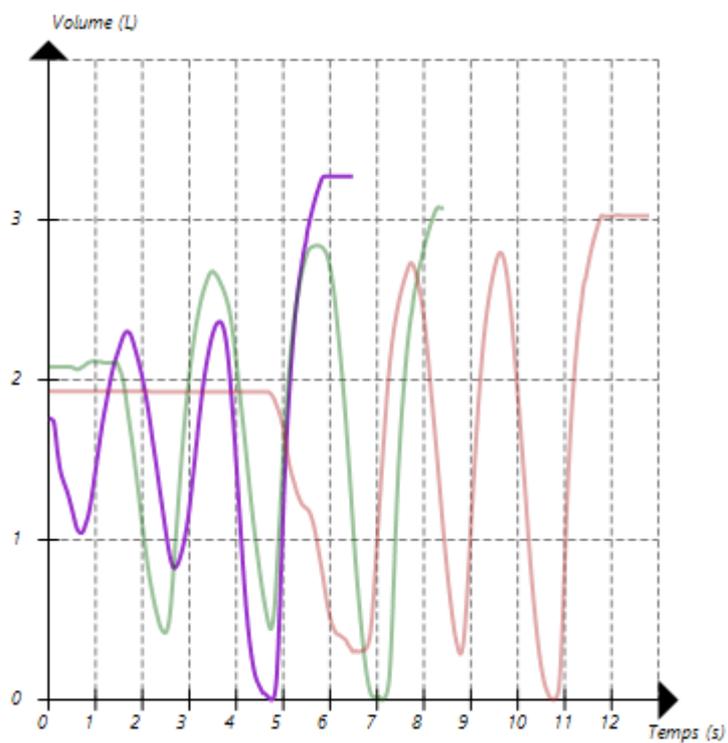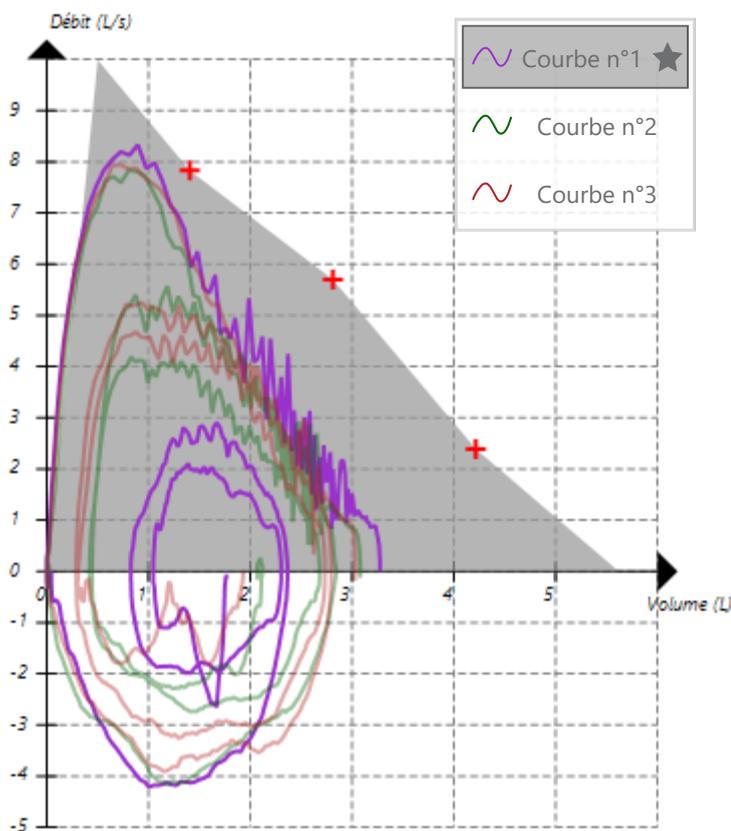

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,27 L	3,08 L	3,03 L	5,62 L	58,19 %
VEMS	3,27 L	3,07 L	3,03 L	4,64 L	70,47 %
DÉP	8,43 L/s	8,00 L/s	8,02 L/s	9,99 L/s	84,38 %
VEMS/ CVF	100,00 %	99,68 %	100,00 %	83,02 %	120,45 %
Durée d'expiration	1,12 s	1,20 s	1,03 s	-	
DEMM	5,16 L/s	4,74 L/s	5,35 L/s	4,81 L/s	107,28 %
DEMM/ CVF	1,58 s-1	1,54 s-1	1,77 s-1	0,86 s-1	183,72 %
DE75	8,09 L/s	7,77 L/s	7,83 L/s	7,83 L/s	103,32 %
DE50	5,76 L/s	4,88 L/s	5,75 L/s	5,70 L/s	101,05 %
DE25	2,01 L/s	1,87 L/s	3,19 L/s	2,39 L/s	84,10 %