



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> LANCINE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1984	<b>Profession</b> PICK UP DRIVER
<b>Age</b> 40 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1601	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 174 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 73 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,4 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 59 %

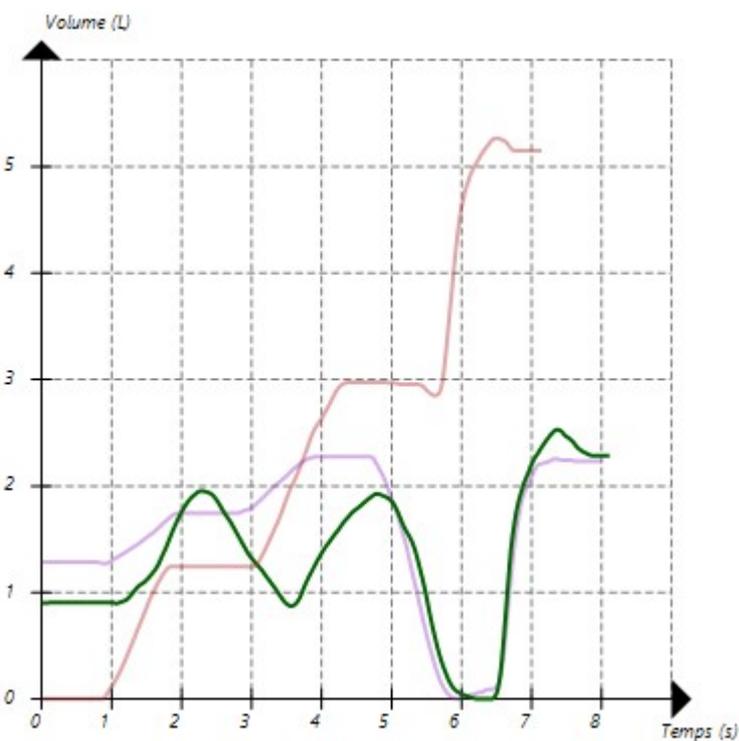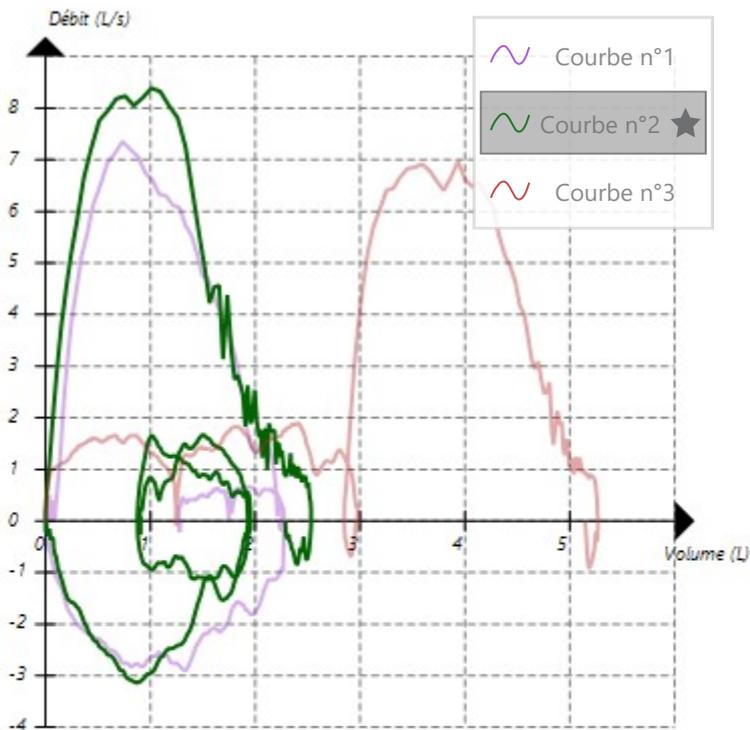

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,26 L	2,53 L	2,42 L	4,16 L	60,82 %
VEMS	2,26 L	2,53 L	2,42 L	3,41 L	74,19 %
DEP	7,73 L/s	8,53 L/s	7,10 L/s	8,87 L/s	96,17 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	81,93 %	122,06 %
Durée d'expiration	1,40 s	1,14 s	0,89 s	-	
DEMM	6,06 L/s	5,73 L/s	5,79 L/s	3,62 L/s	158,29 %
DEMM/CVF	2,68 s-1	2,26 s-1	2,39 s-1	0,87 s-1	259,77 %
DE75	7,07 L/s	8,33 L/s	6,71 L/s	-	
DE50	6,57 L/s	7,90 L/s	6,49 L/s	-	
DE25	4,03 L/s	2,20 L/s	2,74 L/s	-	