



<b>Nom</b> DIAKITE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MORY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1994	<b>Profession</b> DUMP TRUCK DRIVER
<b>Age</b> 30 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 97	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 174 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 98 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,2 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 93,2 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 42 %

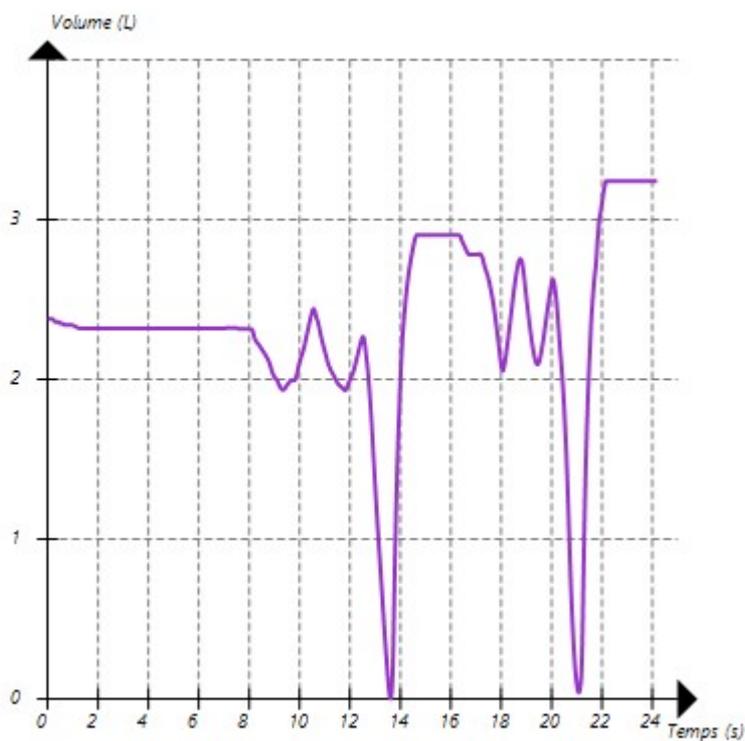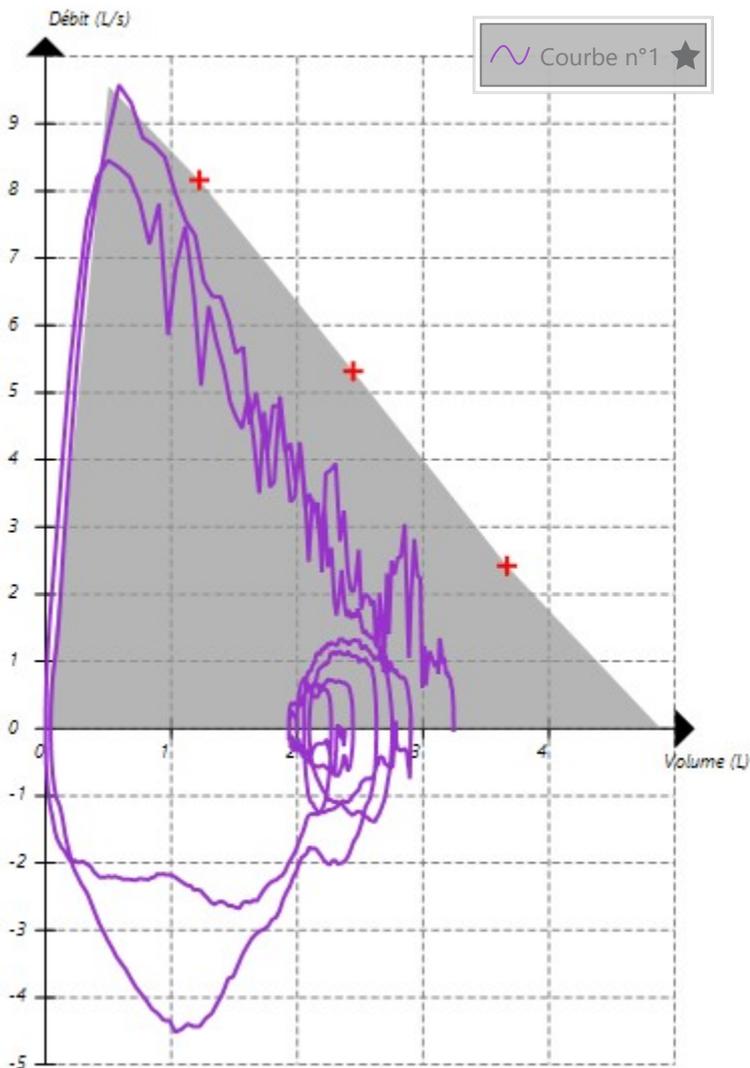

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,20 L	4,89 L	65,44 %
VEMS	3,20 L	4,12 L	77,67 %
DEP	9,76 L/s	9,56 L/s	102,09 %
VEMS/ CVF	100,00 %	81,84 %	122,19 %
Durée d'expiration	1,18 s	-	
DEMM	4,85 L/s	4,79 L/s	101,25 %
DEMM/ CVF	1,52 s-1	0,98 s-1	155,10 %
DE75	8,51 L/s	8,16 L/s	104,29 %
DE50	5,56 L/s	5,32 L/s	104,51 %
DE25	3,35 L/s	2,42 L/s	138,43 %