

**Nom** TRAORE  
**Prénom** KEMO  
**Né le** 01/01/1987  
**Age** 37 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 1348  
**Taille** 173 cm  
**Poids** 62 kg  
**Valeurs prédites** Knudson  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** MANOEUVRE  
**Entreprise** CR18  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Numéro de série : 232697

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 28,8 °C

Pression atmosphérique : 93,3 kPa

Humidité : 50 %

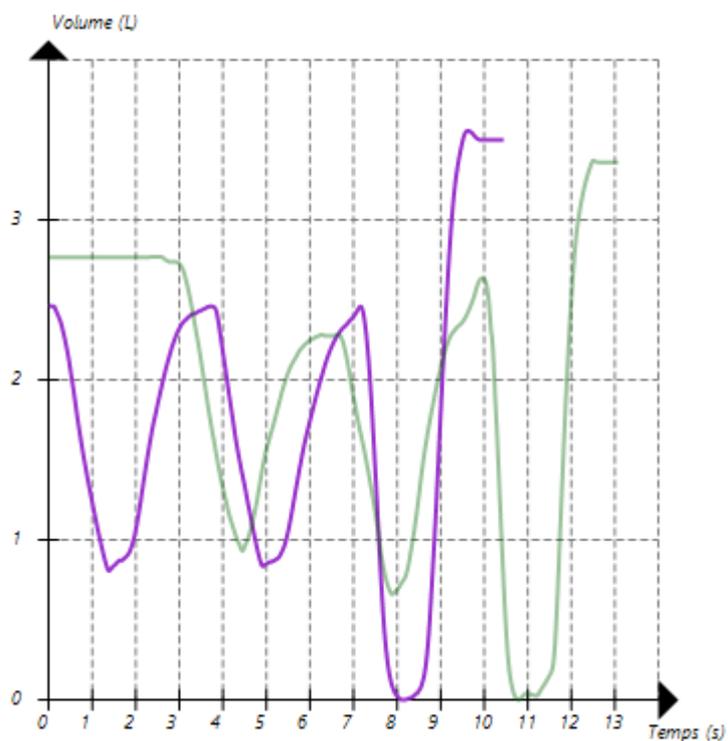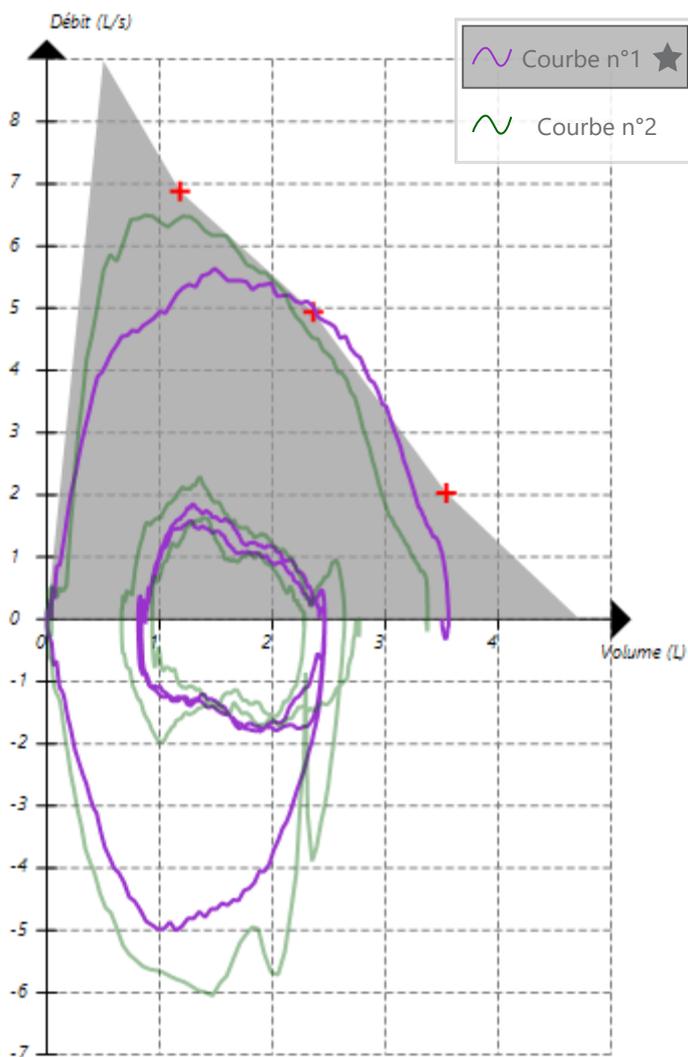

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,56 L	3,35 L	4,72 L	75,42 %
VEMS	3,56 L	3,35 L	3,91 L	91,05 %
DÉP	5,66 L/s	6,65 L/s	8,98 L/s	63,03 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	82,82 %	120,74 %
Durée d'expiration	1,47 s	1,32 s	-	
DEMM	5,28 L/s	5,71 L/s	4,15 L/s	127,23 %
DEMM/ CVF	1,48 s <sup>-1</sup>	1,70 s <sup>-1</sup>	0,88 s <sup>-1</sup>	168,18 %
DE75	4,71 L/s	6,47 L/s	6,88 L/s	68,46 %
DE50	5,45 L/s	5,93 L/s	4,94 L/s	110,32 %
DE25	4,48 L/s	4,27 L/s	2,03 L/s	220,69 %