

<b>Nom</b> TRAORE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADY MAMI	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1986	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 38 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 556	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 175 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 65 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale


Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,1 °C


Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 64 %

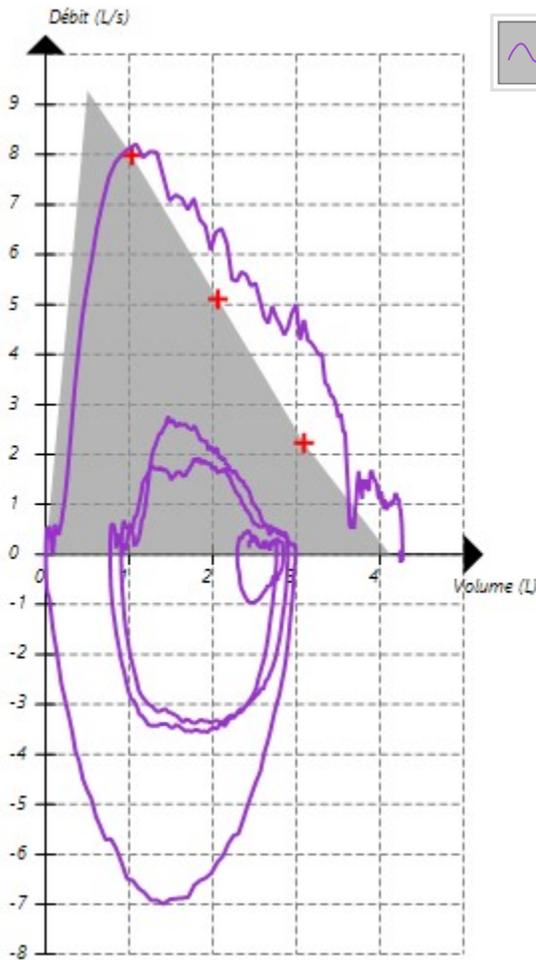

Courbe n°1 ★

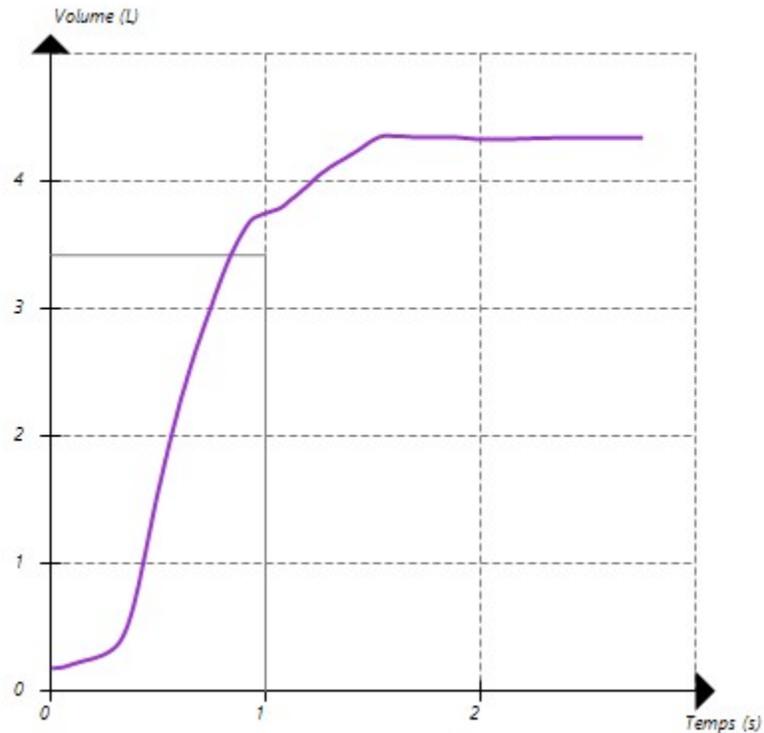

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,27 L	4,12 L	103,64 %
VEMS	4,04 L	3,42 L	118,13 %
DEP	8,29 L/s	9,28 L/s	89,33 %
VEMS/CVF	94,61 %	80,41 %	117,66 %
Durée d'expiration	1,92 s	-	
DEMM	5,98 L/s	4,47 L/s	133,78 %
DEMM/CVF	1,40 s-1	0,94 s-1	148,94 %
DE75	8,27 L/s	7,98 L/s	103,63 %
DE50	6,77 L/s	5,11 L/s	132,49 %
DE25	4,26 L/s	2,23 L/s	191,03 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: