



<b>Nom</b> FOFANA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> NFALY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1962	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 63 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 5901	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 171 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 65 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,6 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 60 %

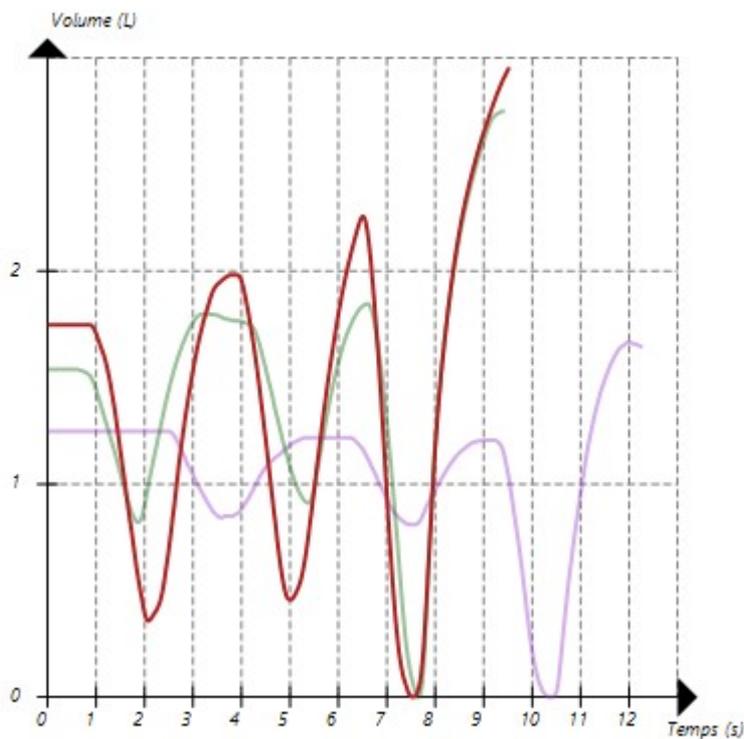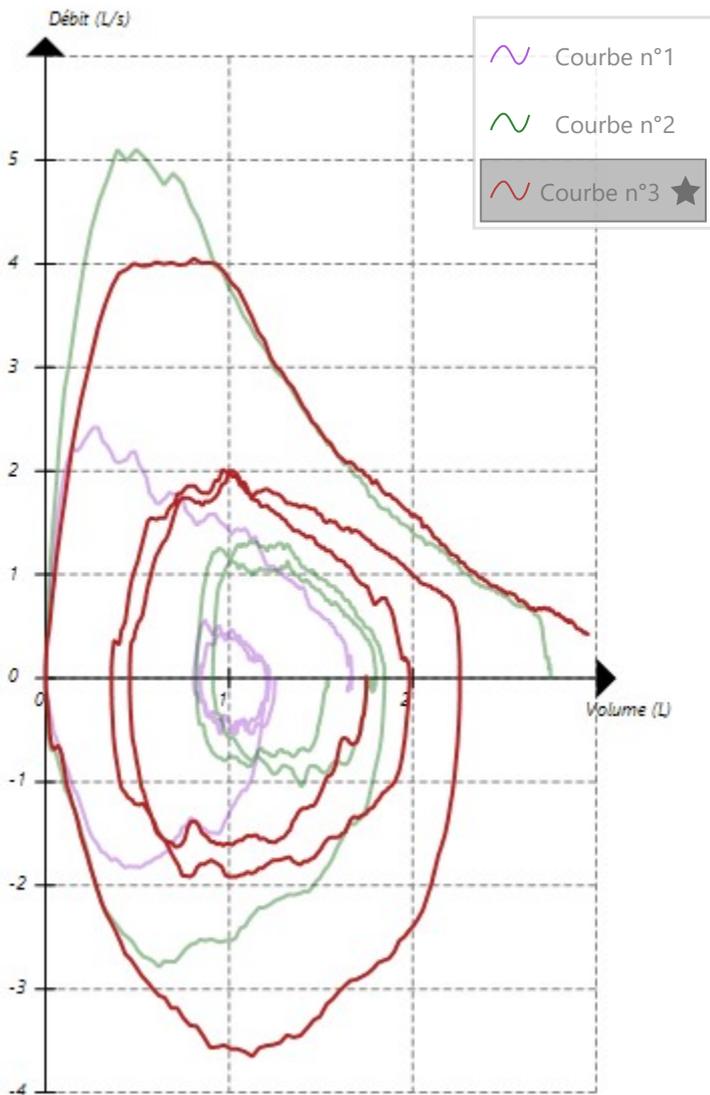

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	1,67 L	2,75 L	2,96 L	3,57 L	82,91 %
VEMS	1,50 L	2,40 L	2,41 L	2,74 L	87,96 %
DEP	2,45 L/s	5,14 L/s	4,08 L/s	7,65 L/s	53,33 %
VEMS/ CVF	89,82 %	87,27 %	81,42 %	77,72 %	104,76 %
Durée d'expiration	1,62 s	1,72 s	1,99 s	-	
DEMM	1,59 L/s	2,49 L/s	2,32 L/s	2,54 L/s	91,34 %
DEMM/ CVF	0,95 s-1	0,91 s-1	0,78 s-1	0,71 s-1	109,86 %
DE75	2,11 L/s	4,92 L/s	3,97 L/s	-	
DE50	1,51 L/s	2,68 L/s	2,42 L/s	-	
DE25	1,06 L/s	1,32 L/s	1,19 L/s	-	