

**Nom** SAGNO  
**Prénom** KABINET  
**Né** le 02/01/2000  
**Age** 25 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 14612  
**Taille** 167 cm  
**Poids** 59 kg  
**Valeurs prédictes** NHANES III  
**Opérateur** BARRY MARIAMA THIOUTO

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** MANOEUVRE  
**Entreprise** CR18  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years :** 0



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

### Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 30,1 °C

Numéro de série : 253565

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Humidité : 54 %

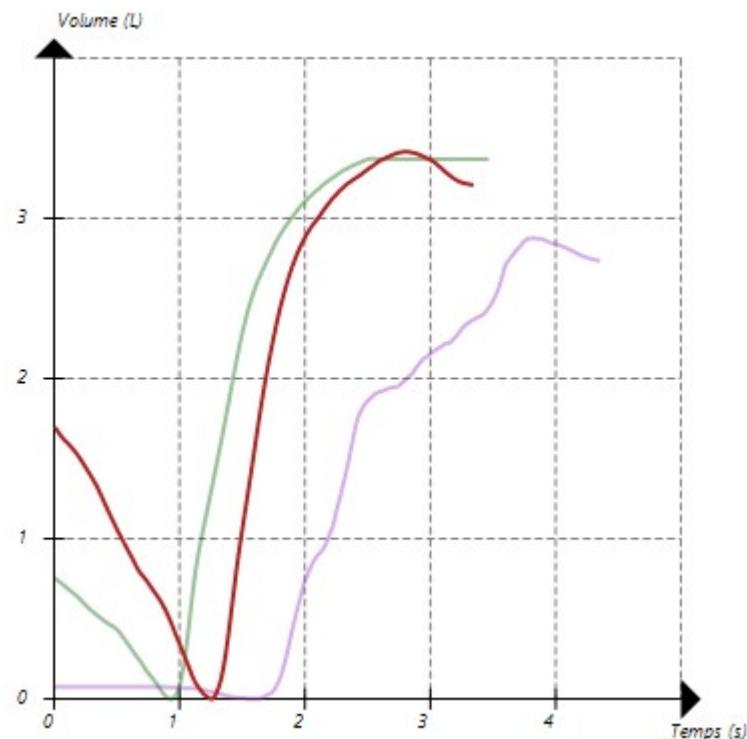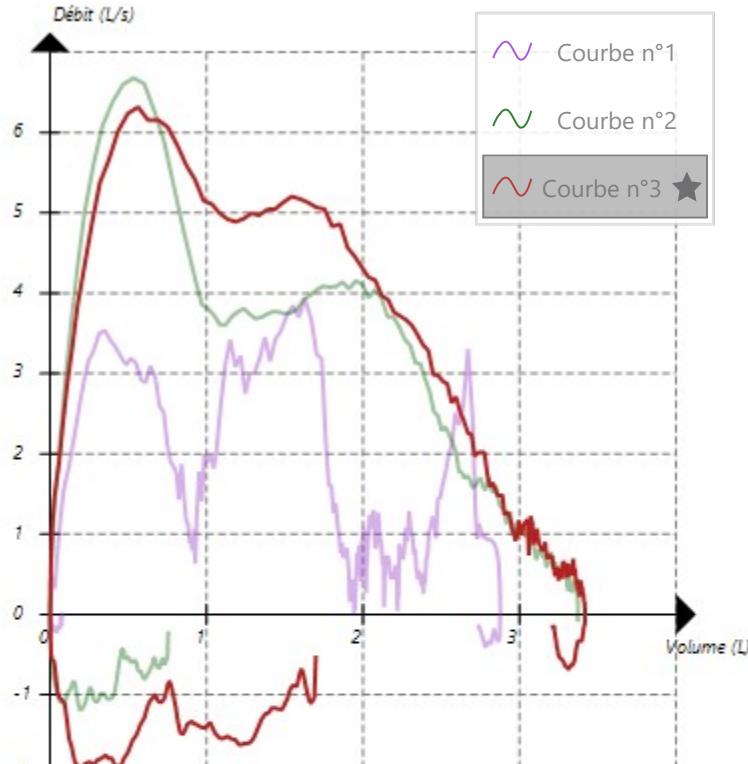

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,88 L	3,37 L	3,42 L	4,03 L	84,86 %
VEMS	2,11 L	3,11 L	3,21 L	3,44 L	93,31 %
DEP	4,12 L/s	6,71 L/s	6,34 L/s	8,83 L/s	71,80 %
VEMS/CVF	73,26 %	92,28 %	93,86 %	84,67 %	110,85 %
Durée d'expiration	2,24 s	1,60 s	1,54 s	-	
DEMM	1,42 L/s	3,74 L/s	4,47 L/s	4,01 L/s	111,47 %
DEMM/CVF	0,49 s <sup>-1</sup>	1,11 s <sup>-1</sup>	1,31 s <sup>-1</sup>	1,00 s <sup>-1</sup>	131,00 %
DE75	2,63 L/s	4,76 L/s	5,63 L/s	-	
DE50	3,52 L/s	3,98 L/s	5,07 L/s	-	
DE25	0,80 L/s	2,30 L/s	2,60 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: