

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ALHASSANE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 05/03/1988	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 36 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1303	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 160 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 58 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 27,7 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,9 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 59 %

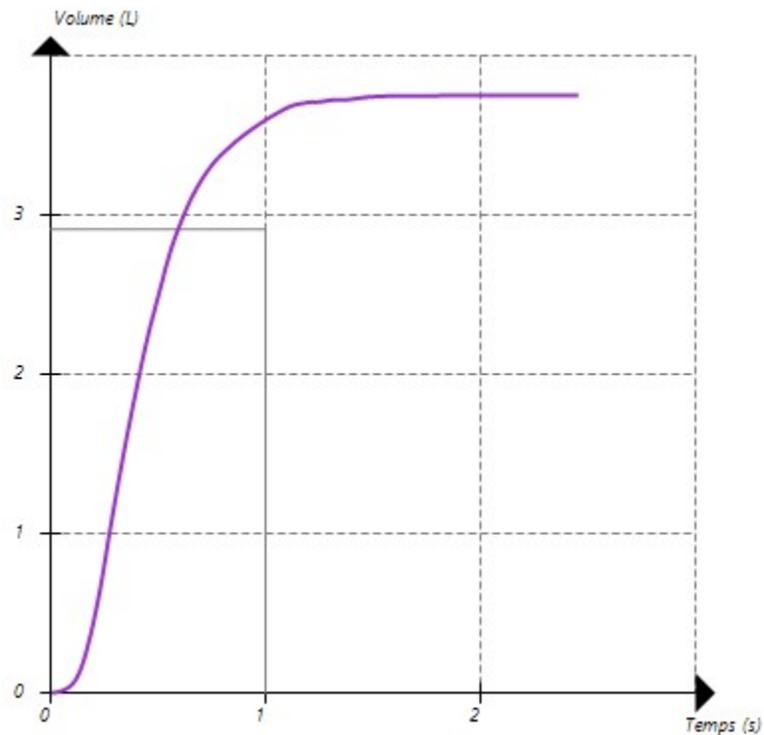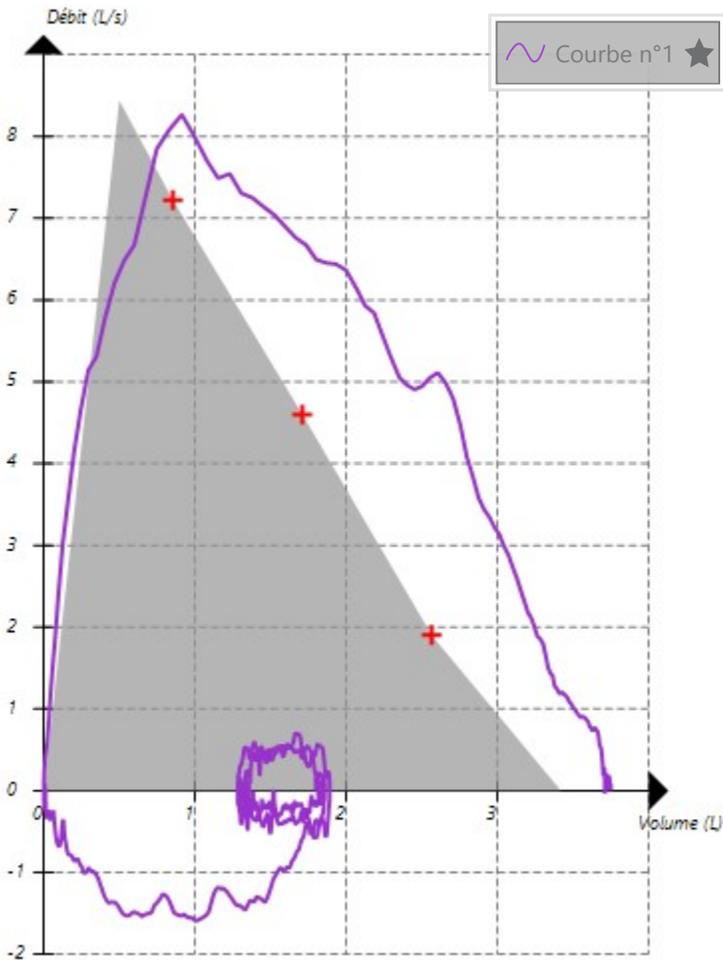

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,75 L	3,42 L	109,65 %
VEMS	3,70 L	2,91 L	127,15 %
DEP	8,35 L/s	8,44 L/s	98,93 %
VEMS/CVF	98,67 %	80,77 %	122,16 %
Durée d'expiration	2,44 s	-	
DEMM	6,23 L/s	4,26 L/s	146,24 %
DEMM/CVF	1,66 s-1	1,08 s-1	153,70 %
DE75	8,25 L/s	7,22 L/s	114,27 %
DE50	6,46 L/s	4,60 L/s	140,43 %
DE25	3,91 L/s	1,90 L/s	205,79 %