

<b>Nom</b> WANG	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> LILONG	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 13/05/1969	<b>Profession</b> CARPENTER
<b>Age</b> 55 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 5394	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 171 cm	<b>Groupe ethnique</b> Chinois de Hong Kong
<b>Poids</b> 67 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecce/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BAH OUMOU SALAMATA	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 30,9 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 95,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Humidité : 59 %

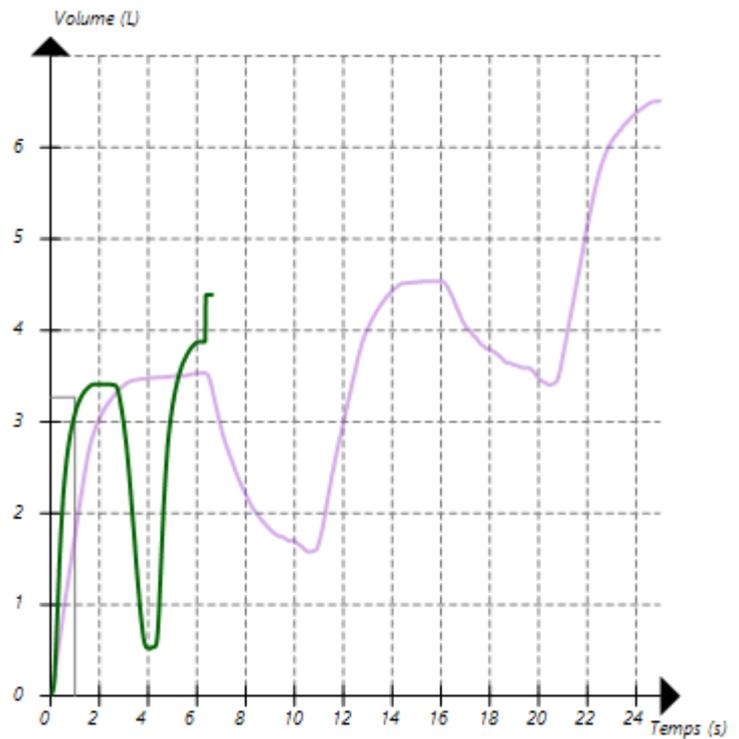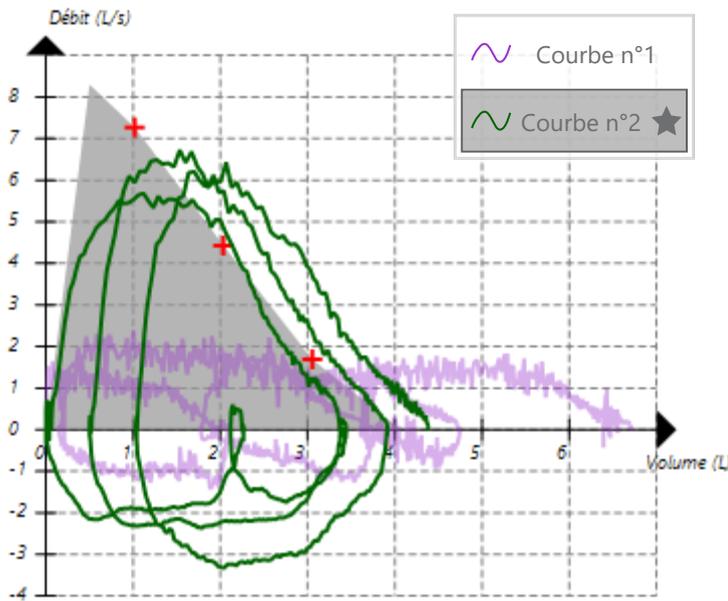

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,53 L	3,40 L	4,07 L	83,54 %
VEMS	1,85 L	3,20 L	3,27 L	97,86 %
DÉP	2,87 L/s	6,95 L/s	8,30 L/s	83,73 %
VEMS/ CVF	52,41 %	94,12 %	77,36 %	121,66 %
Durée d'expiration	6,25 s	1,93 s	-	
DEMM	1,71 L/s	4,54 L/s	3,66 L/s	124,04 %
DEMM/ CVF	0,48 s-1	1,34 s-1	0,90 s-1	148,89 %
DE75	2,22 L/s	6,24 L/s	7,27 L/s	85,83 %
DE50	1,86 L/s	5,03 L/s	4,43 L/s	113,54 %
DE25	1,34 L/s	2,37 L/s	1,69 L/s	140,24 %