

<b>Nom</b> TRAORE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SIDIKI	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1979	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 45 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1070	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 162 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 49 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.


Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 32,4 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,1 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 60 %

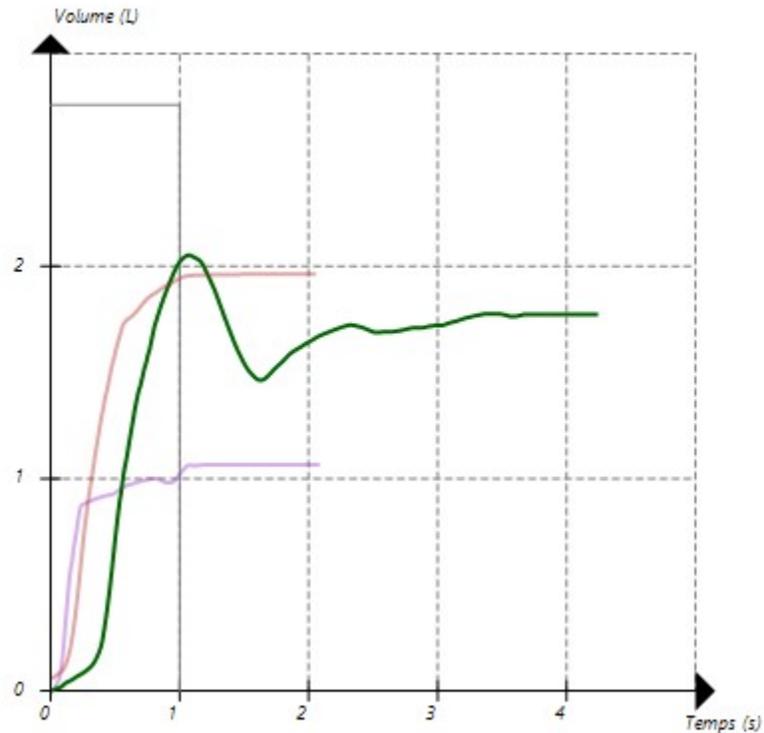

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	1,00 L	2,05 L	1,93 L	3,31 L	61,93 %
VEMS	1,00 L	2,05 L	1,93 L	2,76 L	74,28 %
DEP	7,69 L/s	5,85 L/s	6,07 L/s	8,18 L/s	71,52 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	79,16 %	126,33 %
Durée d'expiration	0,79 s	1,08 s	1,80 s	-	
DEMM	5,32 L/s	3,76 L/s	4,06 L/s	3,91 L/s	96,16 %
DEMM/CVF	5,32 s-1	1,83 s-1	2,10 s-1	1,03 s-1	177,67 %
DE75	7,32 L/s	5,25 L/s	5,68 L/s	7,07 L/s	74,26 %
DE50	7,12 L/s	3,84 L/s	3,56 L/s	4,40 L/s	87,27 %
DE25	3,42 L/s	3,27 L/s	2,60 L/s	1,71 L/s	191,23 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: