

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> FRESSOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 08/05/1984	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 41 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 8977	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 159 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 55 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232707  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Température ambiante : 27,2 °C  
 Pression atmosphérique : 94 kPa  
 Humidité : 57 %

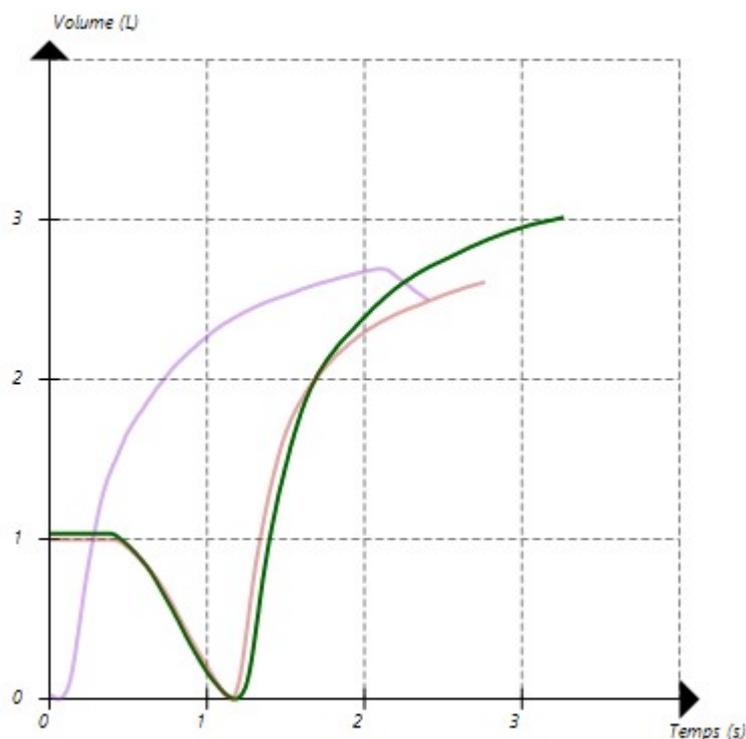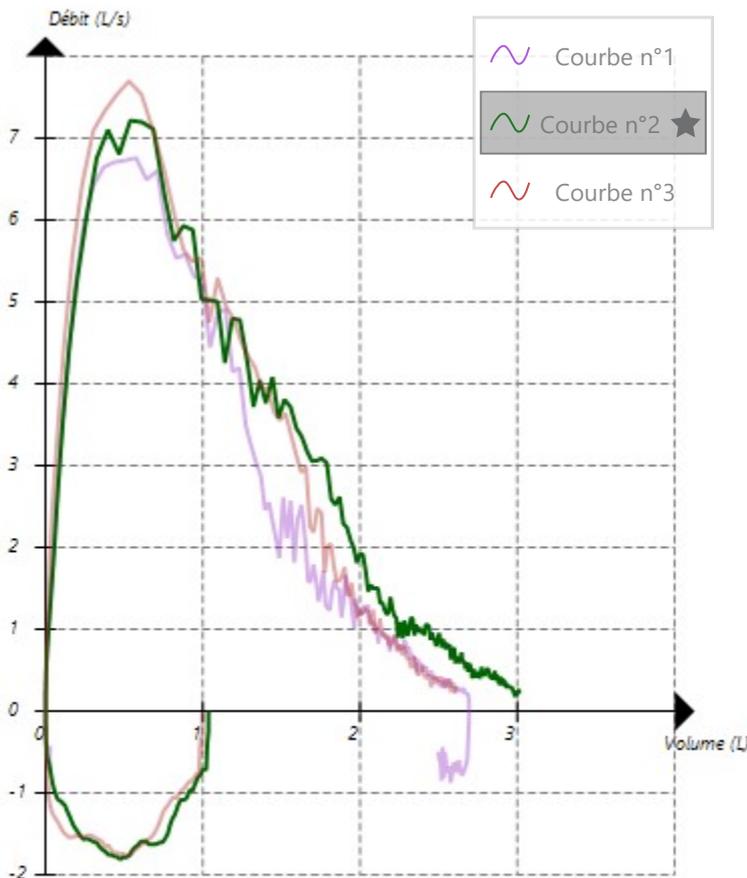

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,69 L	3,02 L	2,61 L	3,31 L	91,24 %
VEMS	2,35 L	2,61 L	2,41 L	2,73 L	95,60 %
DEP	7,15 L/s	7,68 L/s	7,86 L/s	7,46 L/s	102,95 %
VEMS/CVF	87,36 %	86,42 %	92,34 %	81,74 %	105,73 %
Durée d'expiration	2,03 s	2,10 s	1,63 s	-	
DEMM	2,58 L/s	2,89 L/s	3,50 L/s	3,05 L/s	94,75 %
DEMM/CVF	0,96 s-1	0,96 s-1	1,34 s-1	0,92 s-1	104,35 %
DE75	6,46 L/s	6,39 L/s	6,96 L/s	-	
DE50	2,92 L/s	3,75 L/s	4,00 L/s	-	
DE25	1,30 L/s	1,18 L/s	1,42 L/s	-	