

<b>Nom</b> XIAOLIANG	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ZHU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 07/05/1986	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 39 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 6920	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 168 cm	<b>Groupe ethnique</b> Chinois de Hong Kong
<b>Poids</b> 70 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BAH OUMOU SALAMATA	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 27,2 °C  
 Pression atmosphérique : 94,2 kPa  
 Humidité : 71 %

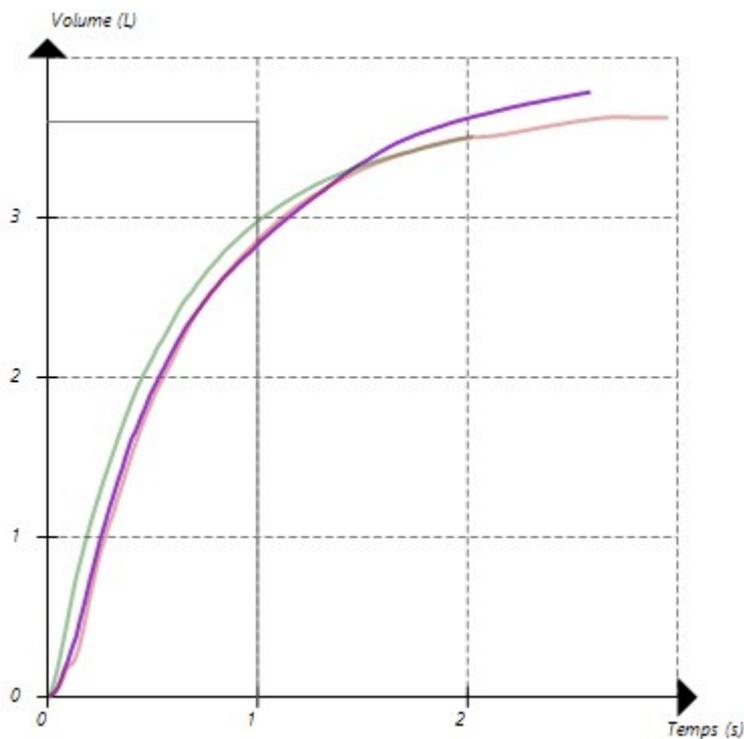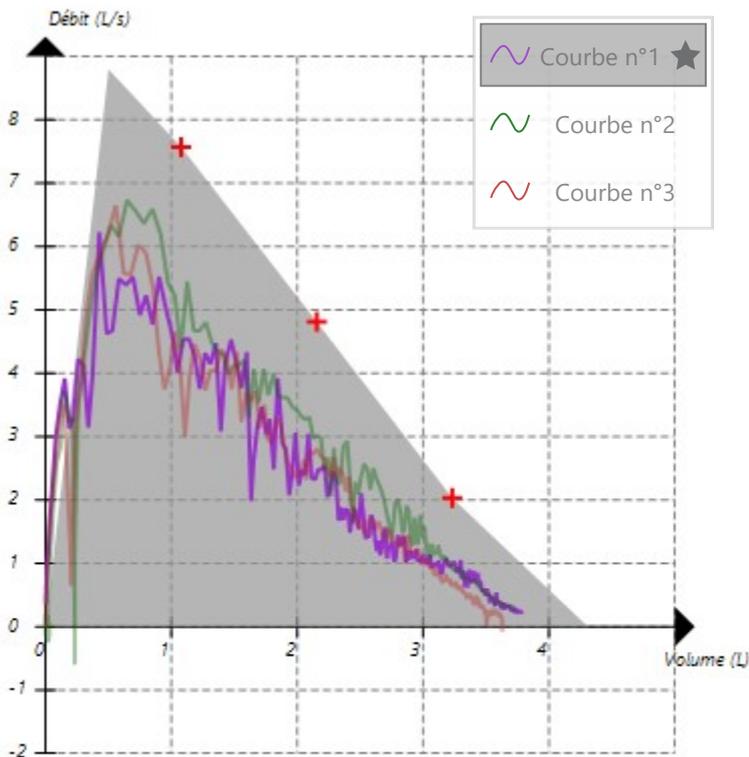

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,79 L	3,51 L	3,63 L	4,31 L	87,94 %
VEMS	2,89 L	3,00 L	2,98 L	3,60 L	80,28 %
DEP	7,02 L/s	7,35 L/s	6,85 L/s	8,80 L/s	79,77 %
VEMS/CVF	76,25 %	85,47 %	82,09 %	80,23 %	95,04 %
Durée d'expiration	2,59 s	2,03 s	2,72 s	-	
DEMM	2,48 L/s	3,03 L/s	2,80 L/s	4,29 L/s	57,81 %
DEMM/CVF	0,65 s-1	0,86 s-1	0,77 s-1	1,00 s-1	65,00 %
DE75	4,85 L/s	5,08 L/s	4,16 L/s	7,57 L/s	64,07 %
DE50	2,42 L/s	3,98 L/s	3,30 L/s	4,81 L/s	50,31 %
DE25	1,38 L/s	1,86 L/s	1,52 L/s	2,03 L/s	67,98 %