

<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOHAMED	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1991	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 33 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 666	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 182 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 75 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 4
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 31,3 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,9 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 57 %

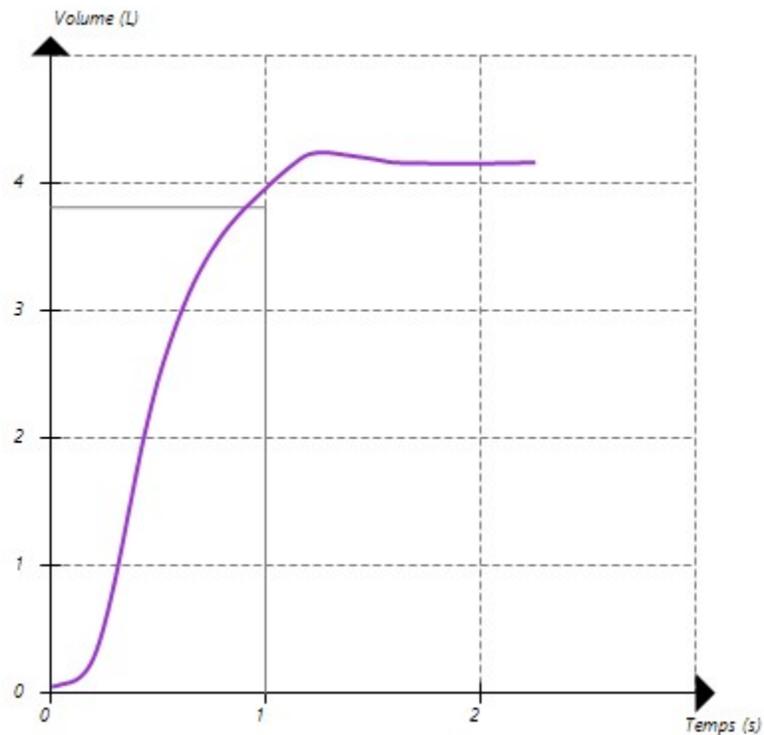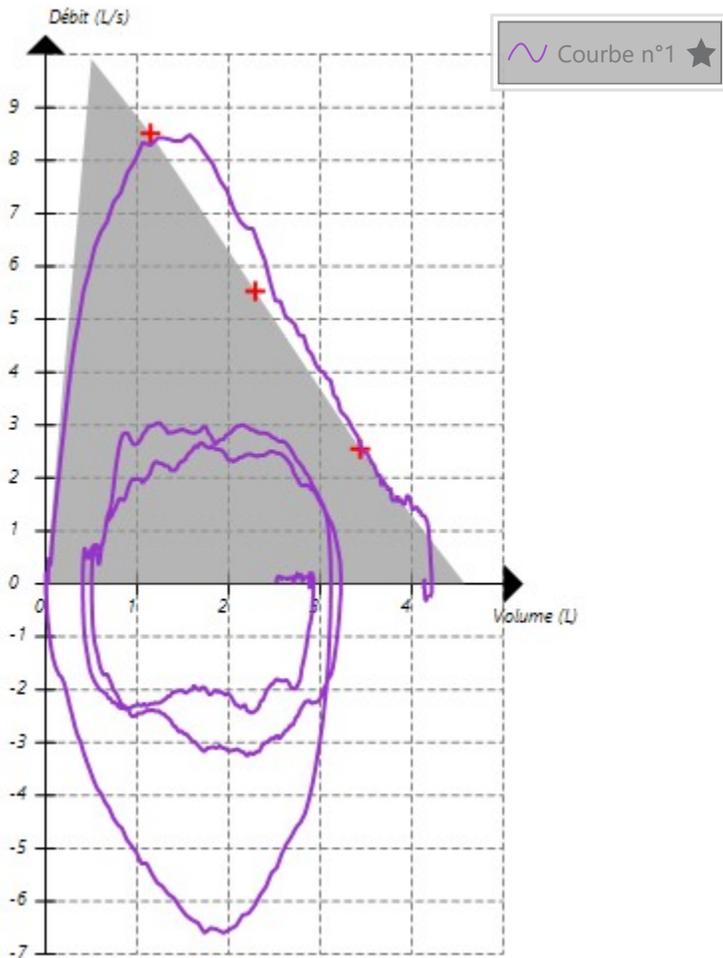

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,22 L	4,58 L	92,14 %
VEMS	4,20 L	3,81 L	110,24 %
DEP	8,56 L/s	9,92 L/s	86,29 %
VEMS/CVF	99,53 %	81,30 %	122,42 %
Durée d'expiration	1,54 s	-	
DEMM	6,31 L/s	4,82 L/s	130,91 %
DEMM/CVF	1,50 s-1	0,91 s-1	164,84 %
DE75	8,43 L/s	8,51 L/s	99,06 %
DE50	6,80 L/s	5,53 L/s	122,97 %
DE25	3,53 L/s	2,55 L/s	138,43 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: