

<b>Nom CISSE</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom MORY</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 01/01/1990</b>	<b>Profession MANOEUVRE</b>
<b>Age 35 Ans</b>	<b>Entreprise CR18</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 4398</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 169 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids 77 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecce/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur BAH OUMOU SALAMATA</b>	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 31,6 °C  
 Pression atmosphérique : 95,2 kPa  
 Humidité : 51 %

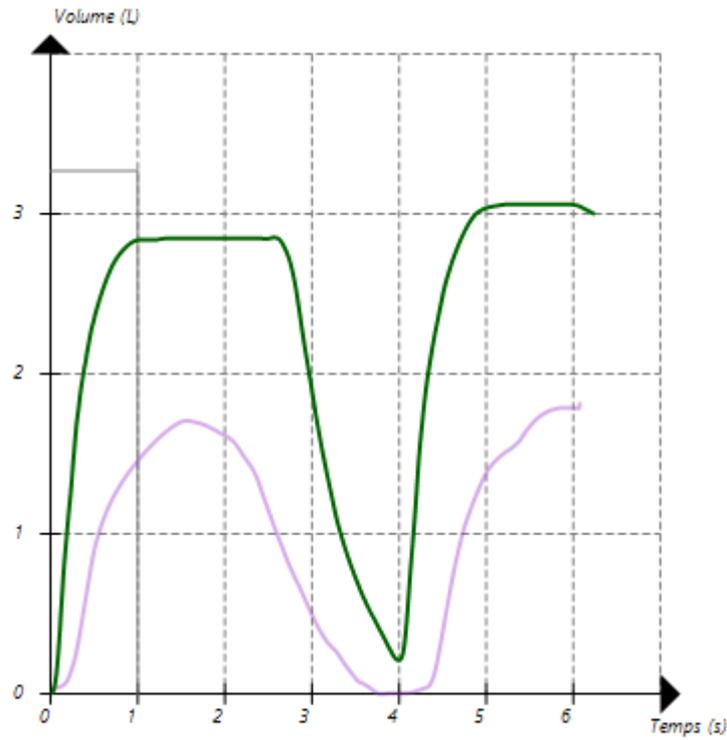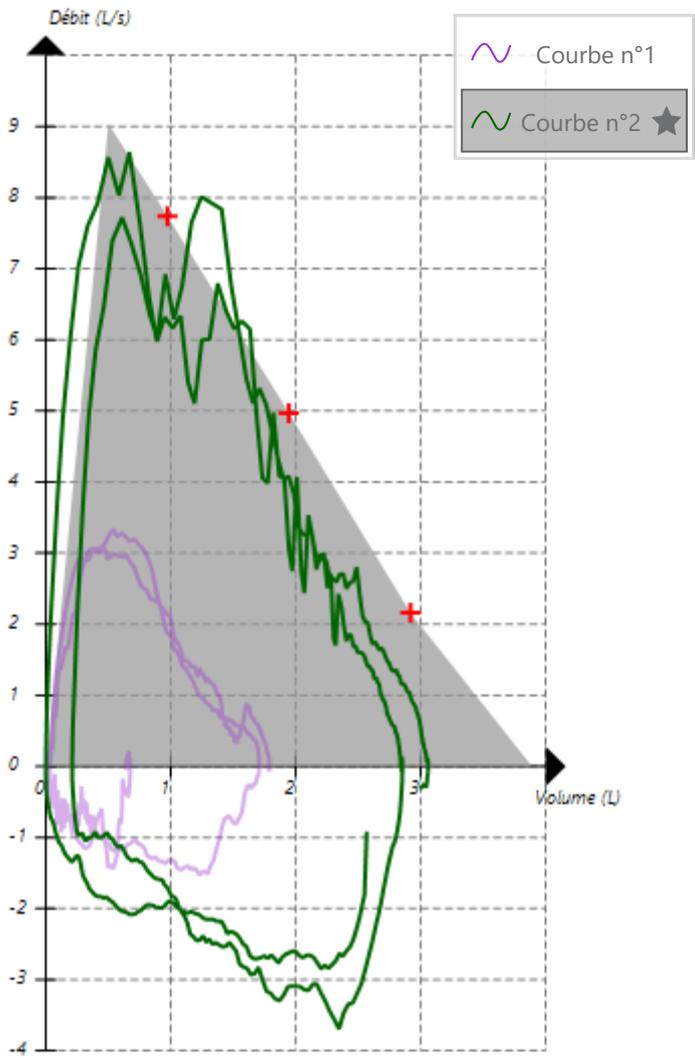

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	1,68 L	2,85 L	3,89 L	73,26 %
VEMS	1,56 L	2,84 L	3,27 L	86,85 %
DÉP	3,39 L/s	8,99 L/s	9,04 L/s	99,45 %
VEMS/CVF	92,86 %	99,65 %	80,94 %	123,12 %
Durée d'expiration	2,05 s	2,56 s	-	
DEMM	2,00 L/s	5,17 L/s	4,48 L/s	115,40 %
DEMM/CVF	1,19 s <sup>-1</sup>	1,81 s <sup>-1</sup>	1,00 s <sup>-1</sup>	181,00 %
DE75	3,03 L/s	8,36 L/s	7,74 L/s	108,01 %
DE50	2,58 L/s	6,54 L/s	4,97 L/s	131,59 %
DE25	0,88 L/s	3,39 L/s	2,16 L/s	156,94 %