



<b>Nom CONDE</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom ADAMA</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 01/01/1987</b>	<b>Profession PICK UP DRIVER</b>
<b>Age 38 Ans</b>	<b>Entreprise CR18</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 4413</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 183 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids 109 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur BAH OUMOU SALAMATA</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,8 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 95,2 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 54 %

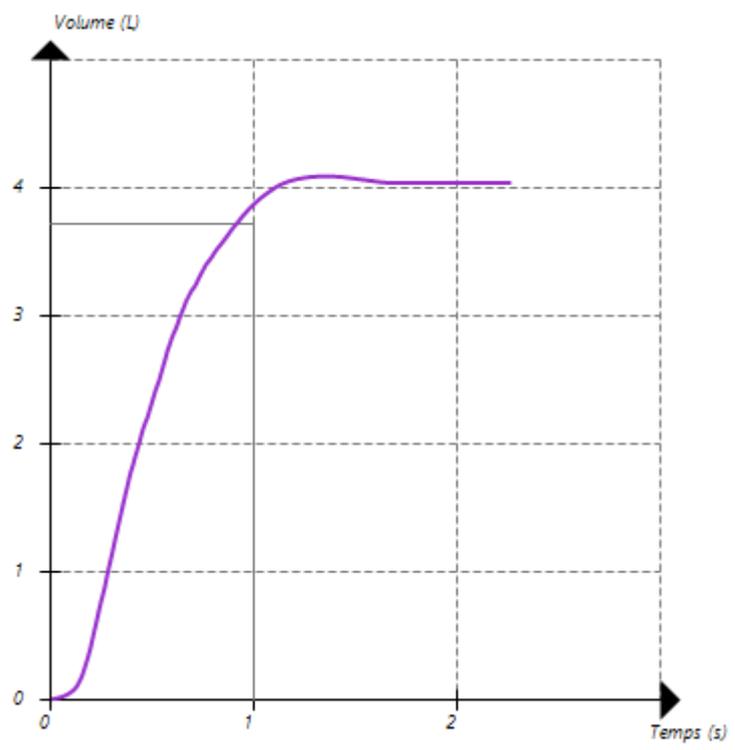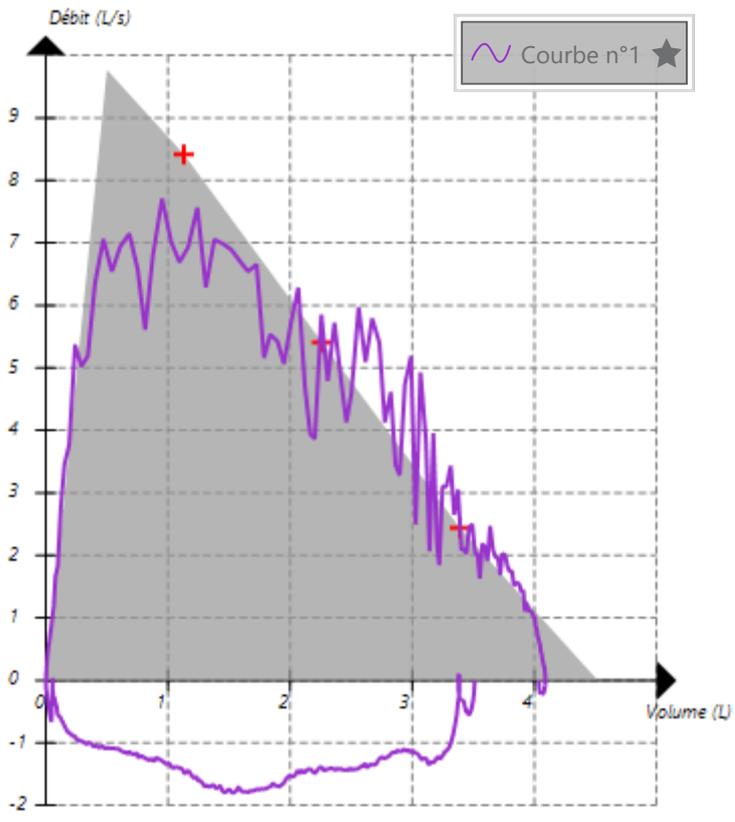

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,09 L	4,52 L	90,49 %
VEMS	4,03 L	3,72 L	108,33 %
DÉP	8,05 L/s	9,77 L/s	82,40 %
VEMS/CVF	98,53 %	80,41 %	122,53 %
Durée d'expiration	1,39 s	-	
DEMM	5,51 L/s	4,62 L/s	119,26 %
DEMM/CVF	1,35 s <sup>-1</sup>	0,89 s <sup>-1</sup>	151,69 %
DE75	7,15 L/s	8,42 L/s	84,92 %
DE50	6,61 L/s	5,41 L/s	122,18 %
DE25	4,80 L/s	2,44 L/s	196,72 %