

<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> DJIBA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1994	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 30 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 690	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 169 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 58 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 30 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 58 %

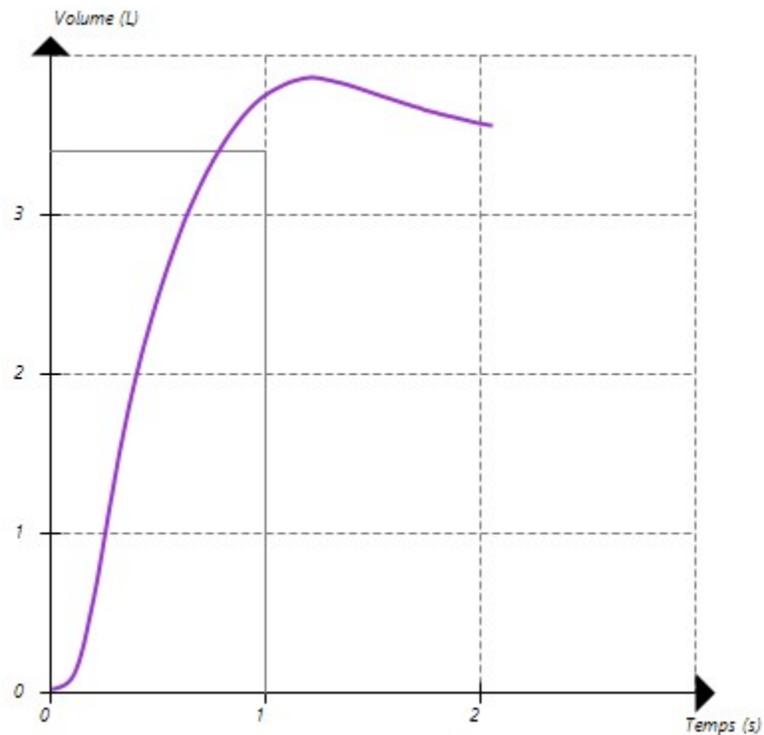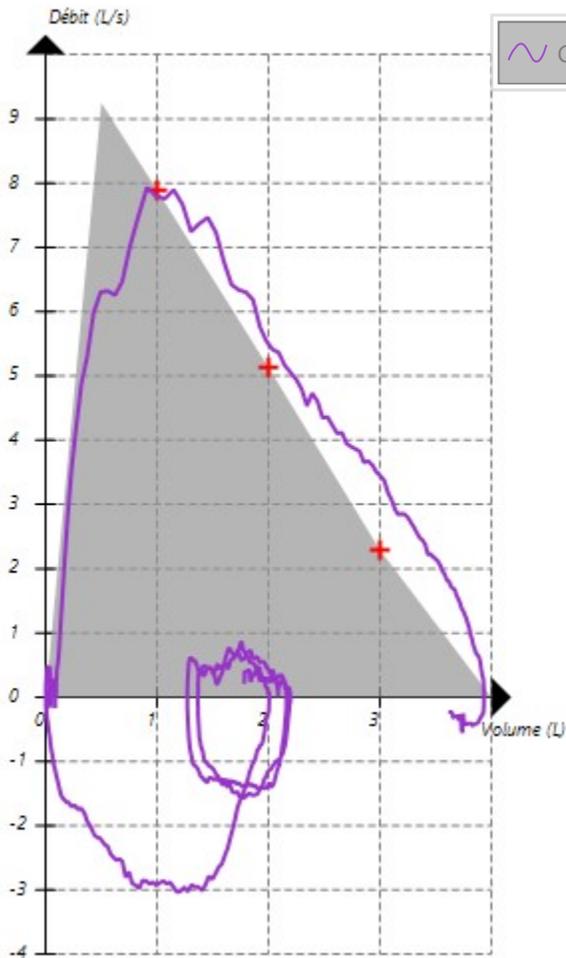

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,85 L	4,00 L	96,25 %
VEMS	3,83 L	3,40 L	112,65 %
DEP	8,01 L/s	9,25 L/s	86,59 %
VEMS/CVF	99,48 %	81,84 %	121,55 %
Durée d'expiration	1,30 s	-	
DEMM	5,44 L/s	4,69 L/s	115,99 %
DEMM/CVF	1,41 s-1	1,02 s-1	138,24 %
DE75	7,91 L/s	7,89 L/s	100,25 %
DE50	5,38 L/s	5,13 L/s	104,87 %
DE25	3,49 L/s	2,29 L/s	152,40 %