

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> N'VASSE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/07/1993	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 30 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 11419	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 172 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 67 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> LY MAMOUDOU	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 30,4 °C  
 Pression atmosphérique : 93,7 kPa  
 Humidité : 53 %

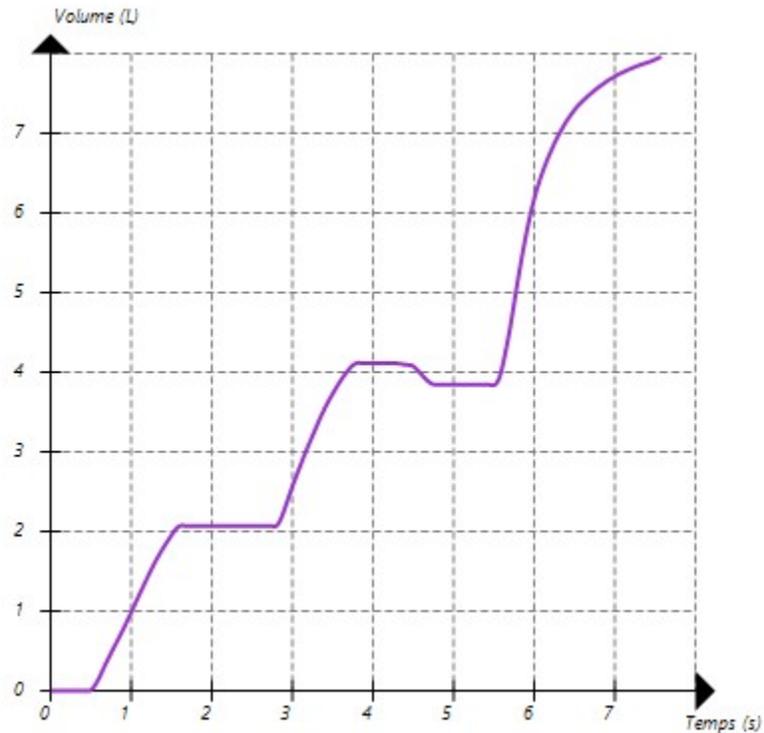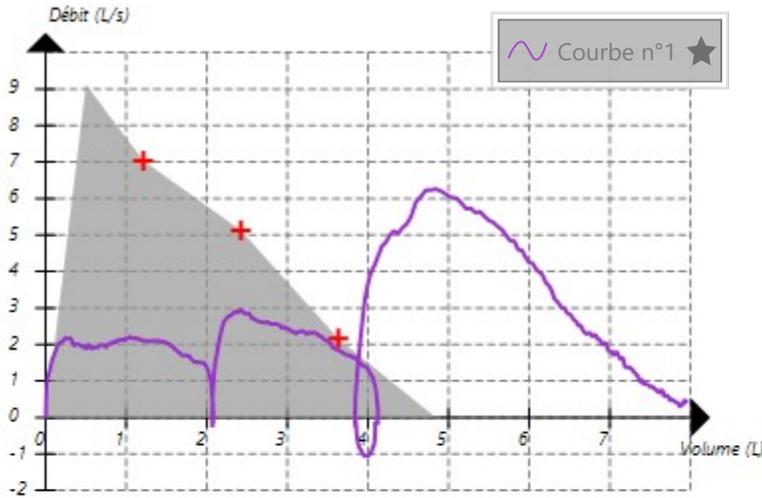

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,13 L	4,84 L	85,33 %
VEMS	3,56 L	4,05 L	87,90 %
DEP	6,31 L/s	9,13 L/s	69,11 %
VEMS/ CVF	86,20 %	83,55 %	103,17 %
Durée d'expiration	2,10 s	-	
DEMM	3,91 L/s	4,35 L/s	89,89 %
DEMM/ CVF	0,95 s-1	0,90 s-1	105,56 %
DE75	6,24 L/s	7,04 L/s	88,64 %
DE50	4,61 L/s	5,13 L/s	89,86 %
DE25	1,99 L/s	2,16 L/s	92,13 %